

CHM[®]

CHARFIX *system*

CHARFIX *system 2*

Charfix Femoral Nail
ChFN *system*











Charfix Femoral Nail
ChFN *system 2*










INTRAMEDULLARY NAILS GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE



www.chm.eu

| | | | |
|--|----|---|----|
| HOW TO READ CATALOGUE JAK CZYTAĆ KATALOG | 5 | LOCKING ELEMENTS ELEMENTY BLOKUJĄCE | 32 |
| CHARFIX2 ANATOMICAL FEMORAL NAIL SHORT CHARFIX2 GWÓŹDŹ UDOWY ANATOMICZNY KRÓTKI | 7 | CHARFIX FEMORAL NAIL CHARFIX GWÓŹDŹ UDOWY | 33 |
| CHARFIX2 ANATOMICAL FEMORAL NAIL CHARFIX2 GWÓŹDŹ UDOWY ANATOMICZNY | 8 | LOCKING ELEMENTS ELEMENTY BLOKUJĄCE | 34 |
| LOCKING ELEMENTS ELEMENTY BLOKUJĄCE | 9 | ChFN TROCHANTERIC NAIL ChFN GWÓŹDŹ KRĘTARZOWY | 35 |
| CHARFIX2 FN NAIL - FEMUR CHARFIX2 FN GWÓŹDŹ - UDO | 10 | LOCKING ELEMENTS ELEMENTY BLOKUJĄCE | 37 |
| CHARFIX2 FN NAIL - TIBIA CHARFIX2 FN GWÓŹDŹ - PISZCZEL | 11 | CHARFIX TIBIAL NAIL CHARFIX GWÓŹDŹ PISZCZELOWY | 38 |
| CHARFIX2 FN DISTANCE CHARFIX2 FN DISTANCE | | LOCKING ELEMENTS ELEMENTY BLOKUJĄCE | 39 |
| CHARFIX2 FN DYSTANS CHARFIX2 FN DISTANCE 20x21 CHARFIX2 FN DYSTANS 20x21 | 13 | CHARFIX RETROGRADE TIBIAL NAIL CHARFIX GWÓŹDŹ PISZCZELOWY WSTECZNY | 40 |
| LOCKING ELEMENTS ELEMENTY BLOKUJĄCE | 13 | LOCKING ELEMENTS ELEMENTY BLOKUJĄCE | 41 |
| ChFN2 TROCHANTERIC NAIL ChFN2 GWÓŹDŹ KRĘTARZOWY | 14 | CHARFIX COMPRESSION HUMERAL NAIL LOCKING ELEMENTS ELEMENTY BLOKUJĄCE | 43 |
| LOCKING ELEMENTS ELEMENTY BLOKUJĄCE | 16 | CHARFIX RECONSTRUCTION HUMERAL NAIL CHARFIX GWÓŹDŹ RAMIENNY REKONSTRUKCYJNY | 44 |
| CHARFIX2 CONDYLAR RETROGRADE FEMORAL NAIL CHARFIX2 GWÓŹDŹ UDOWY WSTECZNY KONDYLARNY | 17 | CHARFIX RECONSTRUCTION HUMERAL NAIL CHARFIX GWÓŹDŹ RAMIENNY REKONSTRUKCYJNY | 45 |
| CHARFIX2 TIBIAL NAIL CHARFIX2 GWÓŹDŹ PISZCZELOWY | 19 | LOCKING ELEMENTS ELEMENTY BLOKUJĄCE | 46 |
| LOCKING ELEMENTS ELEMENTY BLOKUJĄCE | 20 | CHARFIX FOREARM AND FIBULA NAIL CHARFIX GWÓŹDŹ KOŚCI PRZEDRAMIENIA I STRZAŁKOWEJ | 47 |
| CHARFIX2 RETROGRADE TIBIAL NAIL CHARFIX2 GWÓŹDŹ PISZCZELOWY WSTECZNY | 21 | CHARFIX FOREARM AND FIBULA NAIL CHARFIX GWÓŹDŹ KOŚCI PRZEDRAMIENIA I STRZAŁKOWEJ | 48 |
| LOCKING ELEMENTS ELEMENTY BLOKUJĄCE | 22 | LOCKING ELEMENTS ELEMENTY BLOKUJĄCE | 49 |
| CHARFIX2 CALCANEAL NAIL CHARFIX2 GWÓŹDŹ PIĘTOWY | 23 | TELESCOPIC FEMORAL NAIL GWÓŹDŹ TELESKOPOWY UDOWY | 50 |
| LOCKING ELEMENTS ELEMENTY BLOKUJĄCE | 24 | TELESCOPIC FEMORAL NAIL - SLEEVE GWÓŹDŹ TELESKOPOWY UDOWY – TULEJA | 51 |
| CHARFIX2 HUMERAL NAIL CHARFIX2 GWÓŹDŹ RAMIENNY | 25 | TELESCOPIC TIBIAL NAIL GWÓŹDŹ TELESKOPOWY PISZCZELOWY | 52 |
| LOCKING ELEMENTS ELEMENTY BLOKUJĄCE | 27 | TELESCOPIC TIBIAL NAIL-SLEEVE GWÓŹDŹ TELESKOPOWY PISZCZELOWY – TULEJA | 53 |
| CHARFIX2 RADIAL NAIL L-50 CHARFIX2 GWÓŹDŹ PROMIENIOWY L-50 | 28 | LOCKING ELEMENTS ELEMENTY BLOKUJĄCE | 54 |
| CHARFIX2 RADIAL NAIL L-61 CHARFIX2 GWÓŹDŹ PROMIENIOWY L-61 | 28 | INTRAMEDULLARY REAMERS ROZWIERTAKI ŚRÓDSZPIKOWE | 55 |
| CHARFIX2 RADIAL NAIL L-68 CHARFIX2 GWÓŹDŹ PROMIENIOWY L-68 | 28 | MODULAR INTRAMEDULLARY REAMER ROZWIERTAK ŚRÓDSZPIKOWY MODUŁOWY | 58 |
| CHARFIX2 RADIAL NAIL L-79 CHARFIX2 GWÓŹDŹ PROMIENIOWY L-79 | 29 | EXTRACTOR EKSTRAKTOR | 59 |
| CHARFIX2 RADIAL NAIL L-68 CHARFIX2 GWÓŹDŹ PROMIENIOWY L-68 | 29 | INDEX INDEKS | 60 |
| CHARFIX2 RADIAL NAIL L-86 CHARFIX2 GWÓŹDŹ PROMIENIOWY L-86 | 30 | | |
| CHARFIX2 RADIAL NAIL L-85 CHARFIX2 GWÓŹDŹ PROMIENIOWY L-85 | 30 | | |
| CHARFIX2 RADIAL NAIL L-96 CHARFIX2 GWÓŹDŹ PROMIENIOWY L-96 | 31 | | |
| CHARFIX2 RADIAL NAIL L-103 CHARFIX2 GWÓŹDŹ PROMIENIOWY L-103 | 31 | | |

| | |
|---|--|
|  | Pure titanium Czysty tytan |
|  | Titanium alloy Stop tytanu |
|  | Cobalt alloy Stop kobaltu |
|  | Steel Stal |
|  | Left Lewy |
|  | Right Prawy |
|  | Universal version Wersja uniwersalna |
|  | Length Długość |
|  | Recommended length range for a particular nail Zakres długości zalecany przy użyciu z danym gwoździem |
|  | Diameter Średnica |

| | |
|---|---|
|  | Torx drive Gniazdo torx |
|  | Torx drive, cannulated Gniazdo torx, kaniulowany |
|  | Hexagonal drive Gniazdo sześciokątne |
|  | Hexagonal drive cannulated Gniazdo sześciokątne kaniulowane |
|  | Locking Blokowany |
|  | Cannulated Kaniulowany |
|  | Angle Kąt |
|  | Available in sterile/ non- sterile condition Dostępny w wersji sterylnej/ niesterylnej |
|  | See surgical technique Patrz technika operacyjna |

Locking elements
Elementy blokujące

Icons describing the implant
Ikony opisujące implant

Locking elements
Elementy blokujące

ChM®

ChFN2 TROCHANTERIC NAIL
ChFN2 GWÓDZ KREŹTARZOWY

ChARTIX system

Icons describing the implant
Ikony opisujące implant

Available dimensions
Dostępne rozmiary

| Angle | Length | Product Code | Product Code | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 125° | 10 | 340 3.5737.340 | 3.5738.340 | |
| | | 360 3.5737.360 | 3.5738.360 | |
| | | 380 3.5737.380 | 3.5738.380 | |
| | | 400 3.5737.400 | 3.5738.400 | |
| | | 420 3.5737.420 | 3.5738.420 | |
| | 130° | 10 | 340 3.5739.340 | 3.5740.340 |
| | | | 360 3.5739.360 | 3.5740.360 |
| | | | 380 3.5739.380 | 3.5740.380 |
| | | | 400 3.5739.400 | 3.5740.400 |
| | | | 420 3.5739.420 | 3.5740.420 |
| | | 135° | 10 | 340 3.5741.340 |
| | | | 360 3.5741.360 | 3.5742.360 |
| | 380 3.5741.380 | | 3.5742.380 | |
| | 400 3.5741.400 | | 3.5742.400 | |
| | 420 3.5741.420 | | 3.5742.420 | |
| 135° | 10 | | 340 3.5761.340 | 3.5762.340 |
| | | 360 3.5761.360 | 3.5762.360 | |
| | | 380 3.5761.380 | 3.5762.380 | |
| | | 400 3.5761.400 | 3.5762.400 | |
| | | 420 3.5761.420 | 3.5762.420 | |
| | 130° | 10 | 340 3.5763.340 | 3.5764.340 |
| | | | 360 3.5763.360 | 3.5764.360 |
| | | | 380 3.5763.380 | 3.5764.380 |
| | | | 400 3.5763.400 | 3.5764.400 |
| | | | 420 3.5763.420 | 3.5764.420 |
| | | 135° | 10 | 340 3.5785.340 |
| | | | 360 3.5785.360 | 3.5786.360 |
| | 380 3.5785.380 | | 3.5786.380 | |
| | 400 3.5785.400 | | 3.5786.400 | |
| | 420 3.5785.420 | | 3.5786.420 | |
| 135° | 10 | | 340 3.5787.340 | 3.5788.340 |
| | | 360 3.5787.360 | 3.5788.360 | |
| | | 380 3.5787.380 | 3.5788.380 | |
| | | 400 3.5787.400 | 3.5788.400 | |
| | | 420 3.5787.420 | 3.5788.420 | |
| | 130° | 10 | 340 3.5789.340 | 3.5790.340 |
| | | | 360 3.5789.360 | 3.5790.360 |
| | | | 380 3.5789.380 | 3.5790.380 |
| | | | 400 3.5789.400 | 3.5790.400 |
| | | | 420 3.5789.420 | 3.5790.420 |

Use with instrument set no. 40.6340.600 40.6340.510
or 40.6340.700 + 40.6340.710
Stosować z instrumentalium 40.6340.600 40.6340.510
lub 40.6340.700 + 40.6340.710

| Locking Element | Length | Product Code | Product Code |
|-----------------|--------|--------------|--------------|
| 3.5159.5xx | T25 | 5.0 | 30-60 |
| 3.5885.xxx | T25 | 5.0 | 70-110 |
| 3.5804.xxx | T25 | 10.5 | 80-120 |
| 3.5161.003 | T25 | ✓ | 10.5 80-120 |
| 3.5961.xxx | T25 | ✓ | 10.5 80-120 |
| 3.5962.000 | T25 | ✓ | 10.5 80-120 |
| 3.5808.000 | T25 | ✓ | 10.5 80-120 |
| 3.5161.6xx | T25 | ✓ | 0-15 |

Paleta do gwóźdź krętarzowych (bez implantów)
Paleta for trochanteric nails (implants not included) 40.4681.100

The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5180.180S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufix "S", np. 3.5180.180S

For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży

5T/52 Non surgical technique
Patrz technika operacyjna

Catalogue no./ xxx should be replaced with a desired locking elements length
Nr katalogowy/ W miejsce xxx należy wstawić numer odpowiadający długości elementu blokującego

Length
Długość

ChM®

LOCKING ELEMENTS
ELEMENTY BLOKUJĄCE

ChARTIX system

CHARFIX DISTAL SCREW 3.5
CHARFIX WKRĘT BLOKUJĄCY 3,5

CHARFIX DISTAL SCREW 4.5
CHARFIX WKRĘT BLOKUJĄCY 4,5

CHARFIX DISTAL SCREW 5.0
CHARFIX WKRĘT BLOKUJĄCY 5,0

Icons describing the implant
Ikony opisujące implant

Available also in steel with a catalogue number that starts with a number 1 (instead of 3)
Dostępne również w wersji stalowej o numerze katalogowym zaczynającym się cyfrą 1 (zamiast 3)


| Length | Product Code | Product Code |
|--------|--------------|--------------|
| 20 | 3.1655.020 | |
| 25 | 3.1655.025 | |
| 30 | 3.1655.030 | |
| 35 | 3.1655.035 | |
| 40 | 3.1655.040 | |
| 45 | 3.1655.045 | |
| 50 | 3.1655.050 | |
| 25 | 3.1654.025 | |
| 30 | 3.1654.030 | |
| 35 | 3.1654.035 | |
| 40 | 3.1654.040 | |
| 45 | 3.1654.045 | |
| 50 | 3.1654.050 | |
| 55 | 3.1654.055 | |
| 60 | 3.1654.060 | |
| 65 | 3.1654.065 | |
| 70 | 3.1654.070 | |
| 80 | 3.1654.080 | |
| 30 | 3.1657.030 | |
| 35 | 3.1657.035 | |
| 40 | 3.1657.040 | |
| 45 | 3.1657.045 | |
| 50 | 3.1657.050 | |
| 55 | 3.1657.055 | |
| 60 | 3.1657.060 | |
| 65 | 3.1657.065 | |
| 70 | 3.1657.070 | |

CHARFIX END CAP M7
CHARFIX SRUBA ZAKŁĘPIAJĄCA M7

| Length | Product Code | Product Code |
|--------|--------------|--------------|
| 0 | 3.2104.200 | |
| +S | 3.2104.205 | |

The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5180.180S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufix "S", np. 3.5180.180S

For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży

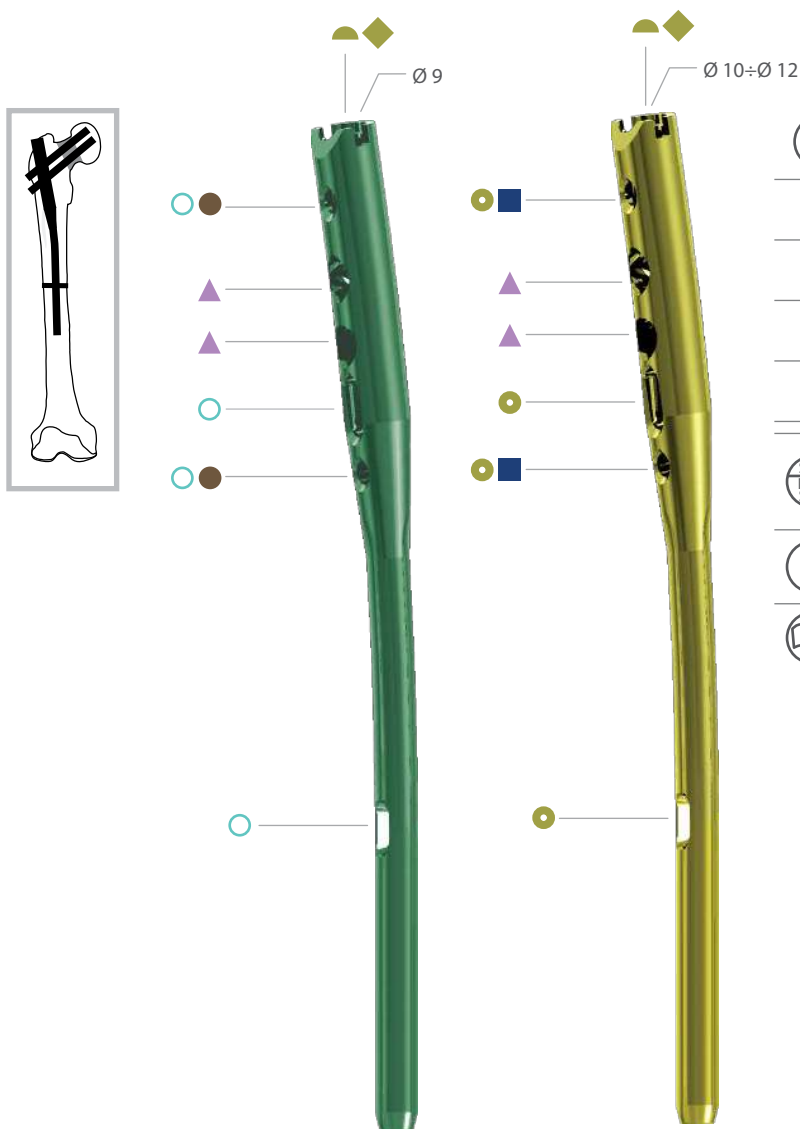

| | | TiA | |
|----|-----|-----|------------|
| | Len | | L R |
| 9 | 180 | | 3.5177.180 |
| | 200 | | 3.5177.200 |
| 10 | 180 | | 3.5178.180 |
| | 200 | | 3.5178.200 |
| 11 | 180 | | 3.5179.180 |
| | 200 | | 3.5179.200 |
| 12 | 180 | | 3.5180.180 |
| | 200 | | 3.5180.200 |



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5180.180S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5180.180S



For other sizes, please contact our Sales Department

W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży




ST-34 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **40.5500.500** or **40.5500.600**
Stosować z instrumentarium **40.5500.500** lub **40.5500.600**

| | TiA | | | | | |
|--|-----|------------|-----|---|-----|--------|
| | ▲ | 3.5168.xxx | T30 | ✓ | 7.5 | 50÷120 |
| | ■ | 3.5160.xxx | T25 | ✓ | 5.5 | 30÷90 |
| | ● | 3.5159.xxx | T25 | | 5.0 | 30÷90 |
| | ● | 3.5170.xxx | T25 | ✓ | 4.5 | 30÷90 |
| | ○ | 3.5169.xxx | T25 | | 4.0 | 30÷90 |
| | ▲ | 3.5162.000 | T30 | | | |
| | ◆ | 3.5161.xxx | T30 | ✓ | | 0÷15 |

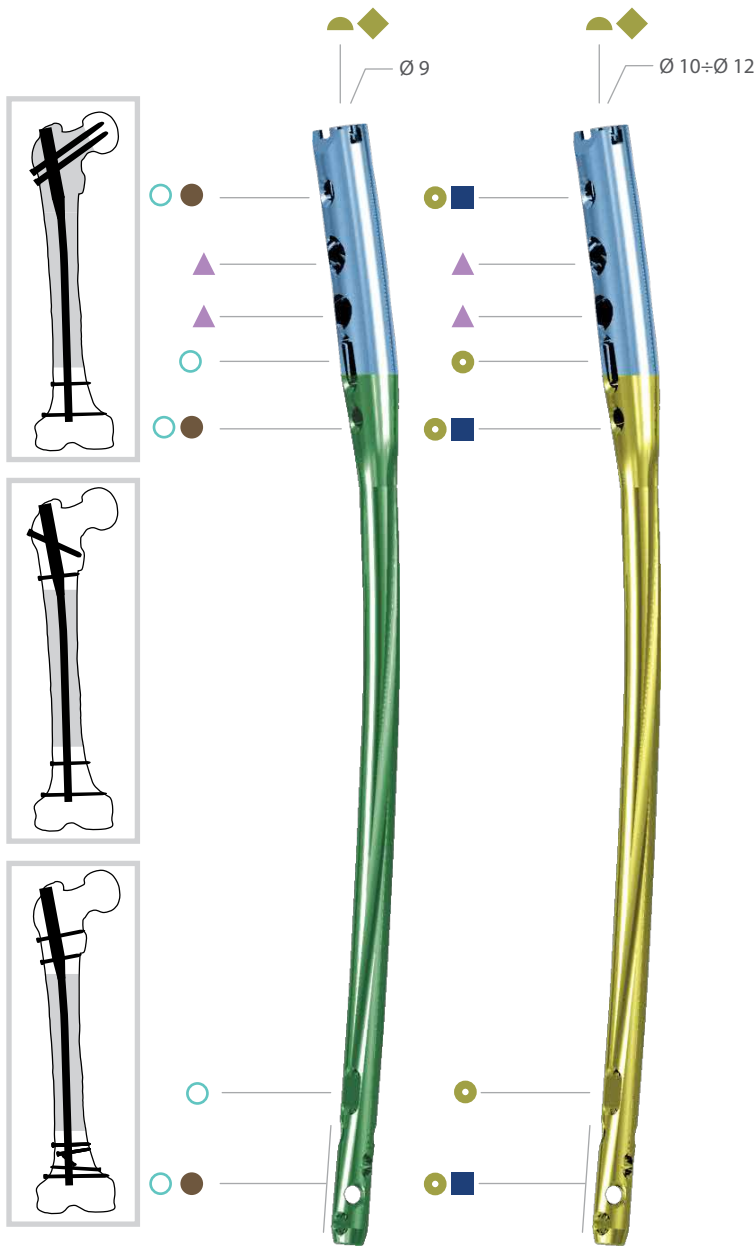

| | Len | L | R |
|----|-----|------------|------------|
| 9 | 340 | 3.5103.340 | 3.5104.340 |
| | 360 | 3.5103.360 | 3.5104.360 |
| | 380 | 3.5103.380 | 3.5104.380 |
| | 400 | 3.5103.400 | 3.5104.400 |
| | 420 | 3.5103.420 | 3.5104.420 |
| | 440 | 3.5103.440 | 3.5104.440 |
| 10 | 460 | 3.5103.460 | 3.5104.460 |
| | 340 | 3.5105.340 | 3.5106.340 |
| | 360 | 3.5105.360 | 3.5106.360 |
| | 380 | 3.5105.380 | 3.5106.380 |
| | 400 | 3.5105.400 | 3.5106.400 |
| | 420 | 3.5105.420 | 3.5106.420 |
| 11 | 440 | 3.5105.440 | 3.5106.440 |
| | 460 | 3.5105.460 | 3.5106.460 |
| | 340 | 3.5107.340 | 3.5108.340 |
| | 360 | 3.5107.360 | 3.5108.360 |
| | 380 | 3.5107.380 | 3.5108.380 |
| | 400 | 3.5107.400 | 3.5108.400 |
| 12 | 420 | 3.5107.420 | 3.5108.420 |
| | 440 | 3.5107.440 | 3.5108.440 |
| | 460 | 3.5107.460 | 3.5108.460 |
| | 340 | 3.5109.340 | 3.5110.340 |
| | 360 | 3.5109.360 | 3.5110.360 |
| | 380 | 3.5109.380 | 3.5110.380 |
| | 400 | 3.5109.400 | 3.5110.400 |
| | 420 | 3.5109.420 | 3.5110.420 |
| | 440 | 3.5109.440 | 3.5110.440 |
| | 460 | 3.5109.460 | 3.5110.460 |



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5180.180S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5180.180S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży




ST-34 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **40.5500.500** or **40.5500.600 + 40.5500.610**
Stosować z instrumentarium **40.5500.500** lub **40.5500.600 + 40.5500.610**

| | TiA | | | | | |
|--|-----|------------|-----|---|-----|--------|
| | ▲ | 3.5168.xxx | T30 | ✓ | 7.5 | 50÷120 |
| | ■ | 3.5160.xxx | T25 | | 5.5 | 30÷90 |
| | ● | 3.5159.xxx | T25 | | 5.0 | 30÷90 |
| | ● | 3.5170.xxx | T25 | ✓ | 4.5 | 30÷90 |
| | ○ | 3.5169.xxx | T25 | | 4.0 | 30÷90 |
| | ▲ | 3.5162.000 | T30 | | | |
| | ◆ | 3.5161.xxx | T30 | ✓ | | 0÷15 |

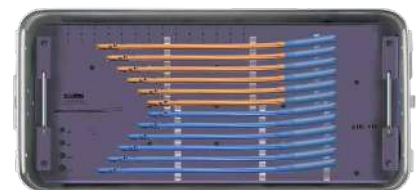

40.5752.000

Stand for anatomical femoral nails
(set with a box without implants)
Statyw na gwoździe anatomiczne
(komplet z puszką bez implantów)

CHARFIX2 DISTAL SCREW 5.0
CHARFIX2 WKREŃ BLOKUJĄCY 5,0



| | |
|----|------------|
| 30 | 3.5159.030 |
| 35 | 3.5159.035 |
| 40 | 3.5159.040 |
| 45 | 3.5159.045 |
| 50 | 3.5159.050 |
| 55 | 3.5159.055 |
| 60 | 3.5159.060 |
| 65 | 3.5159.065 |
| 70 | 3.5159.070 |
| 75 | 3.5159.075 |
| 80 | 3.5159.080 |
| 85 | 3.5159.085 |
| 90 | 3.5159.090 |

CHARFIX2 DISTAL SCREW 5.5
CHARFIX2 WKREŃ BLOKUJĄCY 5,5



| | |
|----|------------|
| 30 | 3.5160.030 |
| 35 | 3.5160.035 |
| 40 | 3.5160.040 |
| 45 | 3.5160.045 |
| 50 | 3.5160.050 |
| 55 | 3.5160.055 |
| 60 | 3.5160.060 |
| 65 | 3.5160.065 |
| 70 | 3.5160.070 |
| 75 | 3.5160.075 |
| 80 | 3.5160.080 |
| 85 | 3.5160.085 |
| 90 | 3.5160.090 |

CHARFIX2 DISTAL SCREW 4.0
CHARFIX2 WKREŃ BLOKUJĄCY 4,0



| | |
|----|------------|
| 30 | 3.5169.030 |
| 35 | 3.5169.035 |
| 40 | 3.5169.040 |
| 45 | 3.5169.045 |
| 50 | 3.5169.050 |
| 55 | 3.5169.055 |
| 60 | 3.5169.060 |
| 65 | 3.5169.065 |
| 70 | 3.5169.070 |
| 75 | 3.5169.075 |
| 80 | 3.5169.080 |
| 85 | 3.5169.085 |
| 90 | 3.5169.090 |

CHARFIX2 DISTAL SCREW 4.5
CHARFIX2 WKREŃ BLOKUJĄCY 4,5




| | |
|----|------------|
| 30 | 3.5170.030 |
| 35 | 3.5170.035 |
| 40 | 3.5170.040 |
| 45 | 3.5170.045 |
| 50 | 3.5170.050 |
| 55 | 3.5170.055 |
| 60 | 3.5170.060 |
| 65 | 3.5170.065 |
| 70 | 3.5170.070 |
| 75 | 3.5170.075 |
| 80 | 3.5170.080 |
| 85 | 3.5170.085 |
| 90 | 3.5170.090 |

CHARFIX2 RECONSTRUCTION CANNULATED SCREW 7.5
CHARFIX2 WKREŃ REKONSTRUKCYJNY KANIULOWANY 7,5



| | |
|-----|------------|
| 50 | 3.5168.050 |
| 55 | 3.5168.055 |
| 60 | 3.5168.060 |
| 65 | 3.5168.065 |
| 70 | 3.5168.070 |
| 75 | 3.5168.075 |
| 80 | 3.5168.080 |
| 85 | 3.5168.085 |
| 90 | 3.5168.090 |
| 95 | 3.5168.095 |
| 100 | 3.5168.100 |
| 105 | 3.5168.105 |
| 110 | 3.5168.110 |
| 115 | 3.5168.115 |
| 120 | 3.5168.120 |

CHARFIX2 END CAP M10X1.5
CHARFIX2 ŚRUBA ZAŚLEPIAJĄCA M10X1,5



| | |
|-----|------------|
| 0 | 3.5161.700 |
| +5 | 3.5161.705 |
| +10 | 3.5161.710 |
| +15 | 3.5161.715 |

CHARFIX2 COMPRESSION SCREW M10X1.5
CHARFIX2 ŚRUBA KOMPRESYJNA M10X1,5



3.5162.000



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5180.180S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5180.180S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży




ST-34 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Stand for CHARFIX2 nail locking elements (set with a box without implants)
Stawy na elementy blokujące gwoździe CHARFIX2 (komplet z puszką bez implantów) 40.5058.200



Stand for CHARFIX2 anatomical femoral nails and screws (set with a box without implants)
Stawy na wkrety i gwoździe udowe anatomiczne CHARFIX2 (komplet z puszką bez implantów) 15.0421.600

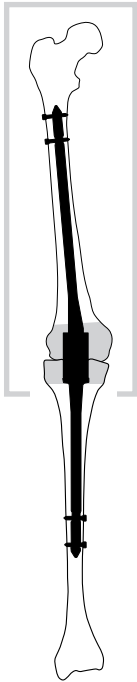

| | | TiA | |
|-----|------------|------------|------------|
| | Len | L | R |
| 10 | 180 | 3.6319.180 | 3.6320.180 |
| | 200 | 3.6319.200 | 3.6320.200 |
| | 220 | 3.6319.220 | 3.6320.220 |
| | 240 | 3.6319.240 | 3.6320.240 |
| | 260 | 3.6319.260 | 3.6320.260 |
| | 280 | 3.6319.280 | 3.6320.280 |
| | 300 | 3.6319.300 | 3.6320.300 |
| | 320 | 3.6319.320 | 3.6320.320 |
| | 340 | 3.6319.340 | 3.6320.340 |
| | 360 | 3.6319.360 | 3.6320.360 |
| | 380 | 3.6319.380 | 3.6320.380 |
| | 400 | 3.6319.400 | 3.6320.400 |
| | 420 | 3.6319.420 | 3.6320.420 |
| | 440 | 3.6319.440 | 3.6320.440 |
| 460 | 3.6319.460 | 3.6320.460 | |
| 480 | 3.6319.480 | 3.6320.480 | |
| 11 | 180 | 3.6321.180 | 3.6322.180 |
| | 200 | 3.6321.200 | 3.6322.200 |
| | 220 | 3.6321.220 | 3.6322.220 |
| | 240 | 3.6321.240 | 3.6322.240 |
| | 260 | 3.6321.260 | 3.6322.260 |
| | 280 | 3.6321.280 | 3.6322.280 |
| | 300 | 3.6321.300 | 3.6322.300 |
| | 320 | 3.6321.320 | 3.6322.320 |
| | 340 | 3.6321.340 | 3.6322.340 |
| | 360 | 3.6321.360 | 3.6322.360 |
| | 380 | 3.6321.380 | 3.6322.380 |
| | 400 | 3.6321.400 | 3.6322.400 |
| | 420 | 3.6321.420 | 3.6322.420 |
| | 440 | 3.6321.440 | 3.6322.440 |
| 460 | 3.6321.460 | 3.6322.460 | |
| 480 | 3.6321.480 | 3.6322.480 | |
| 12 | 180 | 3.6323.180 | 3.6324.180 |
| | 200 | 3.6323.200 | 3.6324.200 |
| | 220 | 3.6323.220 | 3.6324.220 |
| | 240 | 3.6323.240 | 3.6324.240 |
| | 260 | 3.6323.260 | 3.6324.260 |
| | 280 | 3.6323.280 | 3.6324.280 |
| | 300 | 3.6323.300 | 3.6324.300 |
| | 320 | 3.6323.320 | 3.6324.320 |
| | 340 | 3.6323.340 | 3.6324.340 |
| | 360 | 3.6323.360 | 3.6324.360 |
| | 380 | 3.6323.380 | 3.6324.380 |
| | 400 | 3.6323.400 | 3.6324.400 |
| | 420 | 3.6323.420 | 3.6324.420 |
| | 440 | 3.6323.440 | 3.6324.440 |
| 460 | 3.6323.460 | 3.6324.460 | |
| 480 | 3.6323.480 | 3.6324.480 | |



Use with instrument set no. **15.0427.100** or **15.0427.101 + 15.0427.102**
Stosować z instrumentarium **15.0427.100** lub **15.0427.101 + 15.0427.102**

| | TiA | | | | |
|--|------------|-----|-----|--------|--|
| | 3.5159.xxx | T25 | 5.0 | 26+100 | |
| | 3.6300.000 | T25 | | | |



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży





ST-69 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



| | L | R |
|----|---|---|
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |

CHARFIX *system 2*

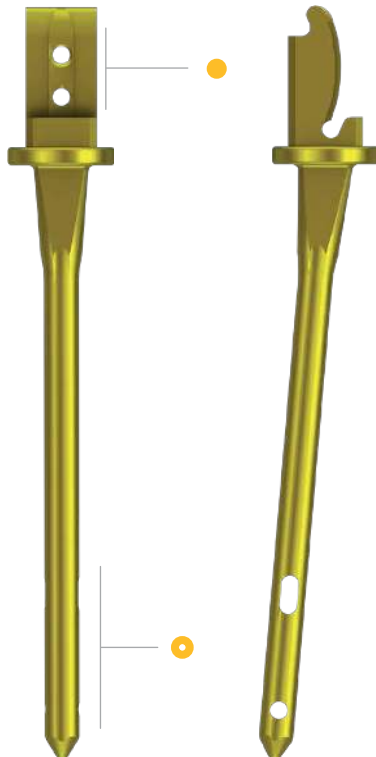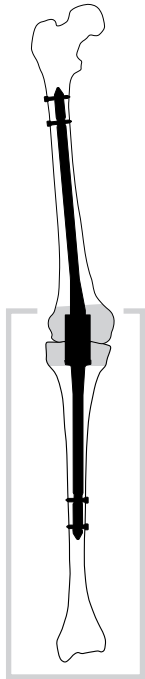

| Len | |
|-----|------------|
| 180 | 3.6343.180 |
| 200 | 3.6343.200 |
| 220 | 3.6343.220 |
| 240 | 3.6343.240 |
| 260 | 3.6343.260 |
| 280 | 3.6343.280 |
| 300 | 3.6343.300 |
| 320 | 3.6343.320 |
| 340 | 3.6343.340 |
| 360 | 3.6343.360 |
| 380 | 3.6343.380 |
| 400 | 3.6343.400 |
| 420 | 3.6343.420 |
| 440 | 3.6343.440 |
| 460 | 3.6343.460 |
| 480 | 3.6343.480 |
| 180 | 3.6344.180 |
| 200 | 3.6344.200 |
| 220 | 3.6344.220 |
| 240 | 3.6344.240 |
| 260 | 3.6344.260 |
| 280 | 3.6344.280 |
| 300 | 3.6344.300 |
| 320 | 3.6344.320 |
| 340 | 3.6344.340 |
| 360 | 3.6344.360 |
| 380 | 3.6344.380 |
| 400 | 3.6344.400 |
| 420 | 3.6344.420 |
| 440 | 3.6344.440 |
| 460 | 3.6344.460 |
| 480 | 3.6344.480 |
| 180 | 3.6345.180 |
| 200 | 3.6345.200 |
| 220 | 3.6345.220 |
| 240 | 3.6345.240 |
| 260 | 3.6345.260 |
| 280 | 3.6345.280 |
| 300 | 3.6345.300 |
| 320 | 3.6345.320 |
| 340 | 3.6345.340 |
| 360 | 3.6345.360 |
| 380 | 3.6345.380 |
| 400 | 3.6345.400 |
| 420 | 3.6345.420 |
| 440 | 3.6345.440 |
| 460 | 3.6345.460 |
| 480 | 3.6345.480 |



Use with instrument set no. **15.0427.100** or **15.0427.101 + 15.0427.102**
Stosować z instrumentarium **15.0427.100** lub **15.0427.101 + 15.0427.102**



3.5159.xxx T25 5.0 26÷100

3.6300.000 T25



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży




ST-69 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



10




11

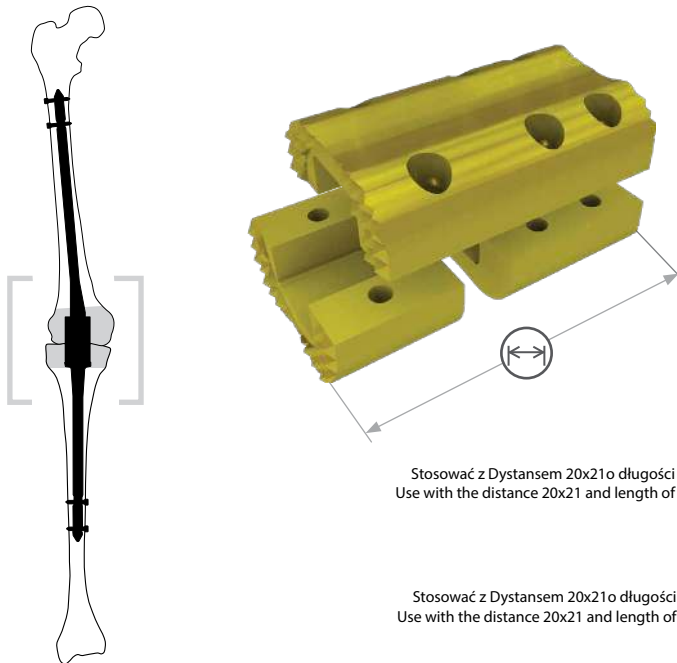12



Stosować z Dystansem 20x21 o długości min. 60mm
Use with the distance 20x21 and length of min. 60mm


Stosować z Dystansem 20x21 o długości min. 80mm
Use with the distance 20x21 and length of min. 80mm

|  |   | Number of T-screws Ilość śrub T (cat. no. nr kat. 3.6300.000)* |
|---|---|--|
| 20 | 3.6367.020 | 2 |
| 25 | 3.6367.025 | 2 |
| 30 | 3.6367.030 | 2 |
| 40 | 3.6367.040 | 4 |
| 50 | 3.6367.050 | 4 |
| 60 | 3.6367.060 | 4 |
| 70 | 3.6367.070 | 6 |
| 80 | 3.6367.080 | 6 |
| 90 | 3.6367.090 | 6 |
| 100 | 3.6367.100 | 6 |
| 110 | 3.6367.110 | 6 |
| 120 | 3.6367.120 | 8 |
| 130 | 3.6367.130 | 8 |
| 140 | 3.6367.140 | 8 |
| 150 | 3.6367.150 | 8 |
| 160 | 3.6367.160 | 8 |
| 170 | 3.6367.170 | 10 |
| 180 | 3.6367.180 | 10 |






* Not provided with the distance.
Brak w zestawie z dystansem.

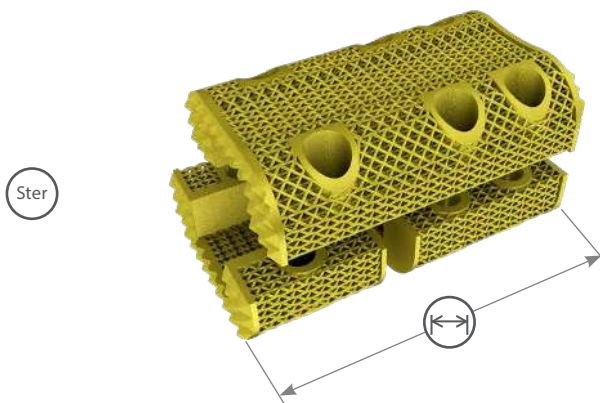CHARFIX2 FN DISTANCE CHARFIX2 FN DYSTANS



Ster

|  |   | Number of T-screws Ilość śrub T (cat. no. nr kat. 3.6300.000)* |
|---|---|--|
| 20 | 3.6380.020S | 2 |
| 25 | 3.6380.025S | 2 |
| 30 | 3.6380.030S | 2 |
| 40 | 3.6380.040S | 4 |
| 50 | 3.6380.050S | 4 |
| 60 | 3.6380.060S | 4 |
| 70 | 3.6380.070S | 6 |
| 80 | 3.6380.080S | 6 |
| 90 | 3.6380.090S | 6 |
| 100 | 3.6380.100S | 6 |



The sterile version includes the suffix „S” in the catalog number, e.g. 3.6380.050S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufix „S”, np. 3.6380.050S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-69 See surgical technique
Patrz technika operacyjna




Use with instrument set no. 15.0427.100 or 15.0427.101 + 15.0427.102
Stosować z instrumentarium 15.0427.100 lub 15.0427.101 + 15.0427.102



Caution! Available only in a sterile version!
Uwaga! Dostępny wyłącznie w wersji sterylnej!



* Not provided with the distance.
Brak w zestawie z dystansem.

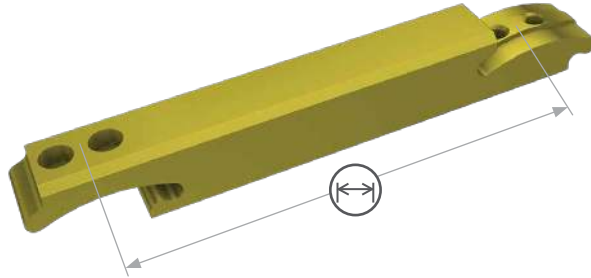

Number of **T**-screws
Ilość śrub **T**
(cat. no. nr kat. 3.6300.000)*

| | | |
|-----|------------|---|
| 60 | 3.6379.060 | 4 |
| 80 | 3.6379.080 | 4 |
| 100 | 3.6379.100 | 4 |
| 120 | 3.6379.120 | 4 |
| 140 | 3.6379.140 | 4 |



* Install the distance 20x21 with femoral and tibial nails using 4 T screws (cat. no. 3.6300.000).
Dystans 20x21 montować z gwoźdźmi, udowym i piszczelowym, przy użyciu 4szt śrub T (nr kat. 3.6300.000).

* Not provided with the distance.
Brak w zestawie z dystansem.

LOCKING ELEMENTS
ELEMENTY BLOKUJĄCE

CHARFIX2 DISTAL SCREW 5.0
CHARFIX2 WKRĘT BLOKUJĄCY 5,0



| | |
|-----|------------|
| T25 | |
| Len | TiA |
| 30 | 3.5159.030 |
| 35 | 3.5159.035 |
| 40 | 3.5159.040 |
| 45 | 3.5159.045 |
| 50 | 3.5159.050 |
| 55 | 3.5159.055 |
| 60 | 3.5159.060 |
| 65 | 3.5159.065 |
| 70 | 3.5159.070 |
| 75 | 3.5159.075 |
| 80 | 3.5159.080 |
| 85 | 3.5159.085 |
| 90 | 3.5159.090 |

CHARFIX2 FN SCREW T
CHARFIX2 FN ŚRUBA T



| | |
|------------|--|
| T25 | |
| TiA | |
| 3.6300.000 | |



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-69 See surgical technique
Patrz technika operacyjna




Use with instrument set no. **15.0427.100** or **15.0427.101 + 15.0427.102**
Stosować z instrumentarium **15.0427.100** lub **15.0427.101 + 15.0427.102**



Stand for CHARFIX2 nail locking elements
(set with a box without implants)
Statyw na elementy blokujące gwoździe CHARFIX2
(komplet z puszką bez implantów)

40.5058.200

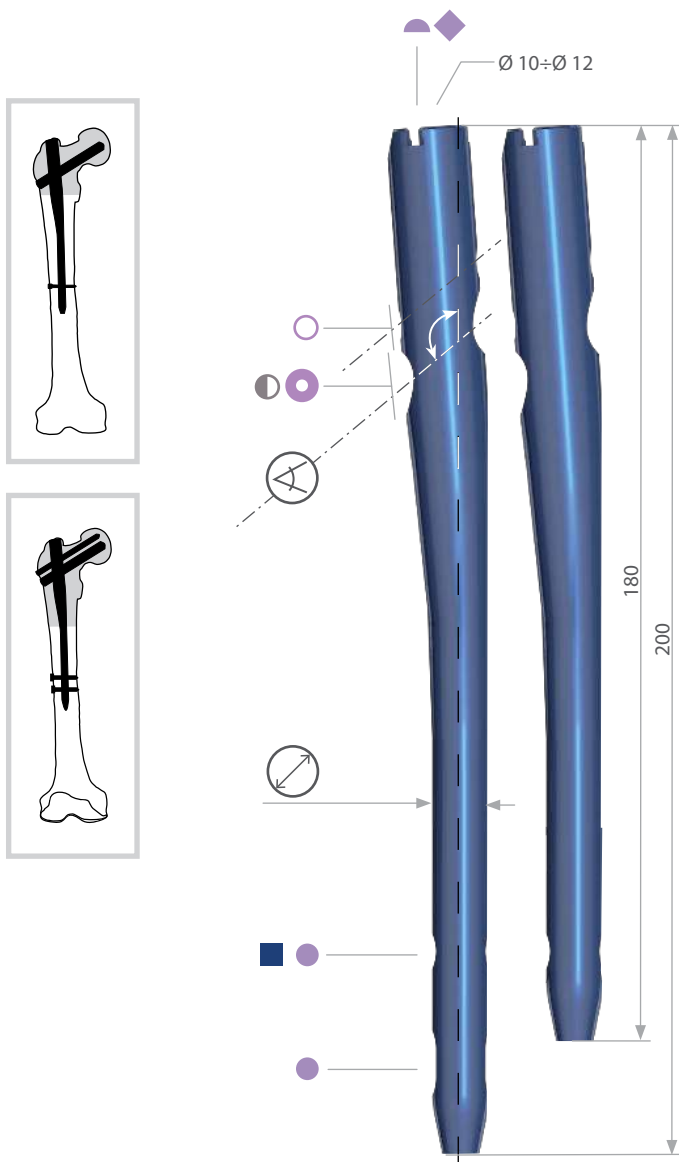

| Recommended Zalecane | Angle | Len | TiA | |
|-------------------------|-------|-----|------------|---|
| | | | L | R |
| 125° | 10 | 180 | 3.5639.180 | |
| | | 200 | 3.5639.200 | |
| | 11 | 180 | 3.5640.180 | |
| | | 200 | 3.5640.200 | |
| | 12 | 180 | 3.5641.180 | |
| | | 200 | 3.5641.200 | |
| 130° | 10 | 180 | 3.5651.180 | |
| | | 200 | 3.5651.200 | |
| | 11 | 180 | 3.5652.180 | |
| | | 200 | 3.5652.200 | |
| | 12 | 180 | 3.5653.180 | |
| | | 200 | 3.5653.200 | |
| 135° | 10 | 180 | 3.5663.180 | |
| | | 200 | 3.5663.200 | |
| | 11 | 180 | 3.5664.180 | |
| | | 200 | 3.5664.200 | |
| | 12 | 180 | 3.5665.180 | |
| | | 200 | 3.5665.200 | |

The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5180.180S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufix "S", np. 3.5180.180S


For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży

ST-52 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **40.6340.600** or **40.6340.700**
Stosować z instrumentarium **40.6340.600** lub **40.6340.700**

| | TiA | | | | |
|--|------------|-----|------|--------|---|
| | 3.5159.5xx | T25 | 5.0 | 30÷60 | |
| | 3.5160.xxx | T25 | 5.5 | 30÷90 | |
| | 3.5805.xxx | T25 | 5.0 | 70÷110 | |
| | 3.5804.xxx | | 10.5 | 80÷120 | ✓ |
| | 3.5161.003 | T25 | | | ✓ |
| | 3.5961.xxx | | 10.5 | 80÷120 | ✓ |
| | 3.5962.000 | T25 | | | |
| | 3.5808.000 | T25 | | | |
| | 3.5161.6xx | T25 | | 0÷15 | ✓ |

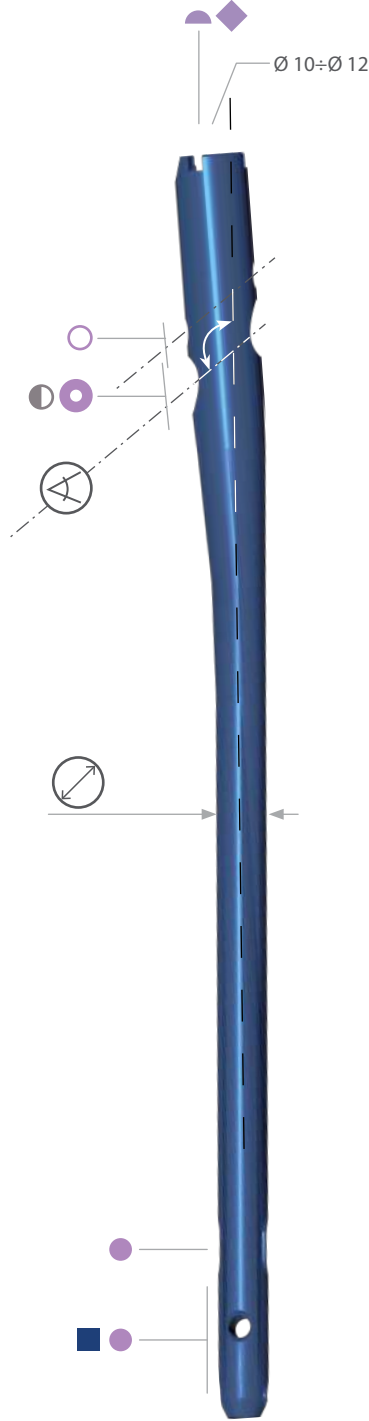

| | | Len | L | R |
|------|-----|------------|------------|---|
| 10 | 340 | 3.5737.340 | 3.5738.340 | |
| | 360 | 3.5737.360 | 3.5738.360 | |
| | 380 | 3.5737.380 | 3.5738.380 | |
| | 400 | 3.5737.400 | 3.5738.400 | |
| 125° | 420 | 3.5737.420 | 3.5738.420 | |
| | 340 | 3.5739.340 | 3.5740.340 | |
| | 360 | 3.5739.360 | 3.5740.360 | |
| | 380 | 3.5739.380 | 3.5740.380 | |
| 11 | 400 | 3.5739.400 | 3.5740.400 | |
| | 420 | 3.5739.420 | 3.5740.420 | |
| | 340 | 3.5741.340 | 3.5742.340 | |
| | 360 | 3.5741.360 | 3.5742.360 | |
| 12 | 380 | 3.5741.380 | 3.5742.380 | |
| | 400 | 3.5741.400 | 3.5742.400 | |
| | 420 | 3.5741.420 | 3.5742.420 | |
| | 340 | 3.5761.340 | 3.5762.340 | |
| 130° | 360 | 3.5761.360 | 3.5762.360 | |
| | 380 | 3.5761.380 | 3.5762.380 | |
| | 400 | 3.5761.400 | 3.5762.400 | |
| | 420 | 3.5761.420 | 3.5762.420 | |
| 11 | 340 | 3.5763.340 | 3.5764.340 | |
| | 360 | 3.5763.360 | 3.5764.360 | |
| | 380 | 3.5763.380 | 3.5764.380 | |
| | 400 | 3.5763.400 | 3.5764.400 | |
| 12 | 420 | 3.5763.420 | 3.5764.420 | |
| | 340 | 3.5765.340 | 3.5766.340 | |
| | 360 | 3.5765.360 | 3.5766.360 | |
| | 380 | 3.5765.380 | 3.5766.380 | |
| 10 | 400 | 3.5765.400 | 3.5766.400 | |
| | 420 | 3.5765.420 | 3.5766.420 | |
| | 340 | 3.5785.340 | 3.5786.340 | |
| | 360 | 3.5785.360 | 3.5786.360 | |
| 135° | 380 | 3.5785.380 | 3.5786.380 | |
| | 400 | 3.5785.400 | 3.5786.400 | |
| | 420 | 3.5785.420 | 3.5786.420 | |
| | 340 | 3.5787.340 | 3.5788.340 | |
| 11 | 360 | 3.5787.360 | 3.5788.360 | |
| | 380 | 3.5787.380 | 3.5788.380 | |
| | 400 | 3.5787.400 | 3.5788.400 | |
| | 420 | 3.5787.420 | 3.5788.420 | |
| 12 | 340 | 3.5789.340 | 3.5790.340 | |
| | 360 | 3.5789.360 | 3.5790.360 | |
| | 380 | 3.5789.380 | 3.5790.380 | |
| | 400 | 3.5789.400 | 3.5790.400 | |
| | 420 | 3.5789.420 | 3.5790.420 | |

Recommended
Zalecane



Use with instrument set no. **40.6340.600 + 40.6340.510**
or **40.6340.700 + 40.6340.710**
Stosować z instrumentarium **40.6340.600 + 40.6340.510**
lub **40.6340.700 + 40.6340.710**

| | TiA | | | |
|--|------------|-----|------|--------|
| | 3.5159.5xx | T25 | 5.0 | 30±60 |
| | 3.5160.xxx | T25 | 5.5 | 30±90 |
| | 3.5805.xxx | T25 | 5.0 | 70±110 |
| | 3.5804.xxx | | 10.5 | 80±120 |
| | 3.5161.003 | T25 | ✓ | |
| | 3.5961.xxx | | 10.5 | 80±120 |
| | 3.5962.000 | T25 | ✓ | |
| | 3.5808.000 | T25 | | |
| | 3.5161.6xx | T25 | ✓ | 0±15 |



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5180.180S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5180.180S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-52 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Paleta do gwoździ krętarzowych (bez implantów)
Palette for trochanteric nails (implants not included) 40.4681.100

CHFN2 JOIN TELESCOPIC SCREW 10.5
CHFN2 ŚRUBA ZESPALAJĄCA TELESKOPOWA 10,5



| Len | |
|-----|------------|
| 80 | 3.5961.080 |
| 85 | 3.5961.085 |
| 90 | 3.5961.090 |
| 95 | 3.5961.095 |
| 100 | 3.5961.100 |
| 105 | 3.5961.105 |
| 110 | 3.5961.110 |
| 115 | 3.5961.115 |
| 120 | 3.5961.120 |

CHFN2 JOIN SCREW 10.5
CHFN2 ŚRUBA ZESPALAJĄCA 10,5



| Len | |
|-----|------------|
| 80 | 3.5804.080 |
| 85 | 3.5804.085 |
| 90 | 3.5804.090 |
| 95 | 3.5804.095 |
| 100 | 3.5804.100 |
| 105 | 3.5804.105 |
| 110 | 3.5804.110 |
| 115 | 3.5804.115 |
| 120 | 3.5804.120 |

CHARFIX2 DISTAL SCREW 5.5
CHARFIX2 WKREŃ BLOKUJĄCY 5,5



| Len | |
|-----|------------|
| 30 | 3.5160.030 |
| 35 | 3.5160.035 |
| 40 | 3.5160.040 |
| 45 | 3.5160.045 |
| 50 | 3.5160.050 |
| 55 | 3.5160.055 |
| 60 | 3.5160.060 |
| 65 | 3.5160.065 |
| 70 | 3.5160.070 |
| 75 | 3.5160.075 |
| 80 | 3.5160.080 |
| 85 | 3.5160.085 |
| 90 | 3.5160.090 |

CHFN2 COMPRESSION SCREW
CHFN2 ŚRUBA KOMPRESYJNA



| | |
|--|------------|
| | 3.5962.000 |
|--|------------|

CHARFIX2 END CAP M8
CHARFIX2 ŚRUBA ZAŚLEPIAJĄCA M8



| | |
|----|------------|
| A | |
| +3 | 3.5161.003 |

CHARFIX2 DISTAL SCREW 5.0
CHARFIX2 WKREŃ BLOKUJĄCY 5,0




| Len | |
|-----|------------|
| 30 | 3.5159.530 |
| 35 | 3.5159.535 |
| 40 | 3.5159.540 |
| 45 | 3.5159.545 |
| 50 | 3.5159.550 |
| 55 | 3.5159.555 |
| 60 | 3.5159.560 |
| 65 | 3.5159.565 |
| 70 | 3.5159.570 |
| 75 | 3.5159.575 |
| 80 | 3.5159.580 |

CHFN2 JOIN SCREW 5.0
CHFN2 ŚRUBA ZESPALAJĄCA 5,0



| Len | |
|-----|------------|
| 70 | 3.5805.070 |
| 75 | 3.5805.075 |
| 80 | 3.5805.080 |
| 85 | 3.5805.085 |
| 90 | 3.5805.090 |
| 95 | 3.5805.095 |
| 100 | 3.5805.100 |
| 105 | 3.5805.105 |
| 110 | 3.5805.110 |

CHFN2 END CAP M12X1.75
CHFN2 ŚRUBA ZAŚLEPIAJĄCA M12X1,75



| | |
|-----|------------|
| A | |
| 0 | 3.5161.600 |
| +5 | 3.5161.605 |
| +10 | 3.5161.610 |
| +15 | 3.5161.615 |

CHFN2 SETTING SCREW M6
CHFN2 ŚRUBA USTALAJĄCA M6



| | |
|--|------------|
| | 3.5808.000 |
|--|------------|



Stand for ChFN2 trochanteric nails
(set with a container without implants)
Statyw do gwoździ krętarzowych ChFN2
(komplet z puszką bez implantów)



40.6328.000



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5180.180S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5180.180S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży

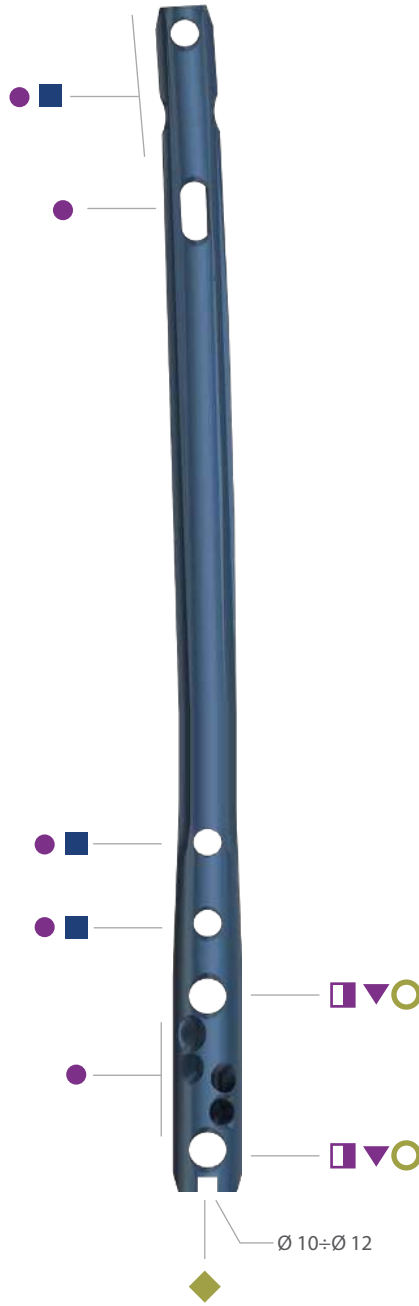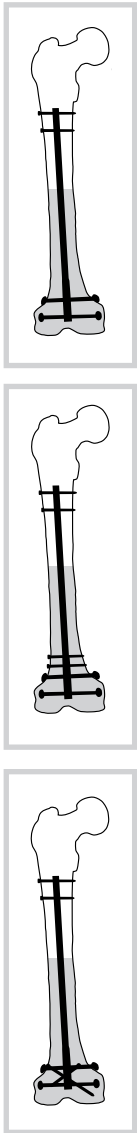

| | Len | TiA |
|-----|------------|------------|
| 10 | 180 | 3.5602.180 |
| | 200 | 3.5602.200 |
| | 220 | 3.5602.220 |
| | 240 | 3.5602.240 |
| | 260 | 3.5602.260 |
| | 280 | 3.5602.280 |
| | 300 | 3.5602.300 |
| | 320 | 3.5602.320 |
| | 340 | 3.5602.340 |
| | 360 | 3.5602.360 |
| | 380 | 3.5602.380 |
| | 400 | 3.5602.400 |
| 11 | 420 | 3.5602.420 |
| | 180 | 3.5603.180 |
| | 200 | 3.5603.200 |
| | 220 | 3.5603.220 |
| | 240 | 3.5603.240 |
| | 260 | 3.5603.260 |
| | 280 | 3.5603.280 |
| | 300 | 3.5603.300 |
| | 320 | 3.5603.320 |
| | 340 | 3.5603.340 |
| | 360 | 3.5603.360 |
| | 380 | 3.5603.380 |
| 12 | 400 | 3.5603.400 |
| | 420 | 3.5603.420 |
| | 180 | 3.5604.180 |
| | 200 | 3.5604.200 |
| | 220 | 3.5604.220 |
| | 240 | 3.5604.240 |
| | 260 | 3.5604.260 |
| | 280 | 3.5604.280 |
| | 300 | 3.5604.300 |
| | 320 | 3.5604.320 |
| | 340 | 3.5604.340 |
| | 360 | 3.5604.360 |
| 380 | 3.5604.380 | |
| 400 | 3.5604.400 | |
| 420 | 3.5604.420 | |



Use with instrument set no. **40.5860.500** or **40.5860.600 + 40.5860.610**
Stosować z instrumentarium **40.5860.500** lub **40.5860.600 + 40.5860.610**

| | TiA | | | | |
|--|------------|-----|-----|--------|---|
| | 3.5158.xxx | T25 | 6.5 | 50÷90 | |
| | 3.5151.xxx | T25 | 6.5 | 50÷120 | |
| | 3.5172.000 | S10 | | | |
| | 3.5160.xxx | T25 | 5.5 | 30÷90 | ✓ |
| | 3.5159.5xx | T25 | 5.0 | 30÷90 | |
| | 3.5161.006 | T25 | | | |



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5180.180S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5180.180S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-49 See surgical technique
Patrz technika operacyjna

CHARFIX2 DISTAL SCREW 5.0
CHARFIX2 WKREŃT BLOKUJĄCY 5,0



| Len | TiA |
|-----|------------|
| 30 | 3.5159.530 |
| 35 | 3.5159.535 |
| 40 | 3.5159.540 |
| 45 | 3.5159.545 |
| 50 | 3.5159.550 |
| 55 | 3.5159.555 |
| 60 | 3.5159.560 |
| 65 | 3.5159.565 |
| 70 | 3.5159.570 |
| 75 | 3.5159.575 |
| 80 | 3.5159.580 |
| 85 | 3.5159.585 |
| 90 | 3.5159.590 |

CHARFIX2 DISTAL SCREW 5.5
CHARFIX2 WKREŃT BLOKUJĄCY 5,5





| Len | TiA |
|-----|------------|
| 30 | 3.5160.030 |
| 35 | 3.5160.035 |
| 40 | 3.5160.040 |
| 45 | 3.5160.045 |
| 50 | 3.5160.050 |
| 55 | 3.5160.055 |
| 60 | 3.5160.060 |
| 65 | 3.5160.065 |
| 70 | 3.5160.070 |
| 75 | 3.5160.075 |
| 80 | 3.5160.080 |
| 85 | 3.5160.085 |
| 90 | 3.5160.090 |

CHARFIX2 DISTAL SCREW 6.5
CHARFIX2 WKREŃT BLOKUJĄCY 6,5



| Len | TiA |
|-----|------------|
| 50 | 3.5151.050 |
| 55 | 3.5151.055 |
| 60 | 3.5151.060 |
| 65 | 3.5151.065 |
| 70 | 3.5151.070 |
| 75 | 3.5151.075 |
| 80 | 3.5151.080 |
| 85 | 3.5151.085 |
| 90 | 3.5151.090 |
| 95 | 3.5151.095 |
| 100 | 3.5151.100 |
| 105 | 3.5151.105 |
| 110 | 3.5151.110 |
| 115 | 3.5151.115 |
| 120 | 3.5151.120 |

CHARFIX2 LOCKING SET 6.5
CHARFIX2 ZESTAW BLOKUJĄCY 6,5



| Len | Range Zakres | TiA |
|-----|--------------|------------|
| 50 | 50-65 | 3.5158.050 |
| 60 | 60-75 | 3.5158.060 |
| 70 | 70-85 | 3.5158.070 |
| 80 | 80-95 | 3.5158.080 |
| 90 | 90-105 | 3.5158.090 |

CHARFIX2 END CAP M8 SPEC
CHARFIX2 ŚRUBA ZAŚLEPIAJĄCA M8 SPEC



3.5161.006



3.5172.000



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5180.180S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5180.180S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży




Stand for CHARFIX2 nail locking elements
(set with box without implants)
Stawy na elementy blokujące gwoździe CHARFIX2
(komplet z puszką bez implantów)

40.5058.200



Stand for CHARFIX2 condylar retrograde femoral nails and screws
(set with a box without implants)
Stawy na wkrety i gwoździe udowe wsteczne kondylarne CHARFIX2
(komplet z puszką bez implantów)

15.0423.600

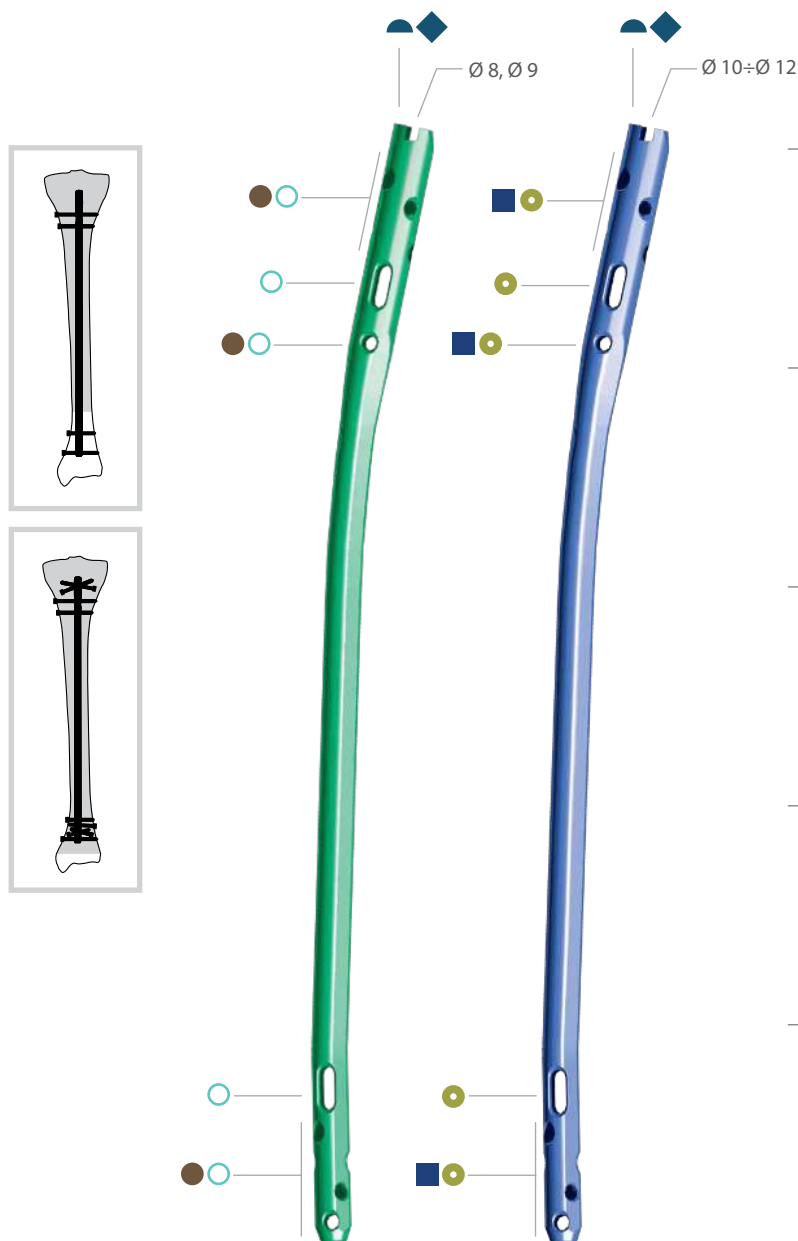

| | Len | | |
|-----|-----|------------|------------|
| 8 | 270 | 3.2651.270 | 3.2665.270 |
| | 285 | 3.2651.285 | 3.2665.285 |
| | 300 | 3.2651.300 | 3.2665.300 |
| | 315 | 3.2651.315 | 3.2665.315 |
| | 330 | 3.2651.330 | 3.2665.330 |
| | 345 | 3.2651.345 | 3.2665.345 |
| | 360 | 3.2651.360 | 3.2665.360 |
| | 375 | 3.2651.375 | 3.2665.375 |
| | 390 | 3.2651.390 | 3.2665.390 |
| | 9 | 270 | 3.2652.270 |
| 285 | | 3.2652.285 | 3.2666.285 |
| 300 | | 3.2652.300 | 3.2666.300 |
| 315 | | 3.2652.315 | 3.2666.315 |
| 330 | | 3.2652.330 | 3.2666.330 |
| 345 | | 3.2652.345 | 3.2666.345 |
| 360 | | 3.2652.360 | 3.2666.360 |
| 375 | | 3.2652.375 | 3.2666.375 |
| 390 | | 3.2652.390 | 3.2666.390 |
| 10 | | 270 | 3.2653.270 |
| | 285 | 3.2653.285 | 3.2667.285 |
| | 300 | 3.2653.300 | 3.2667.300 |
| | 315 | 3.2653.315 | 3.2667.315 |
| | 330 | 3.2653.330 | 3.2667.330 |
| | 345 | 3.2653.345 | 3.2667.345 |
| | 360 | 3.2653.360 | 3.2667.360 |
| | 375 | 3.2653.375 | 3.2667.375 |
| | 390 | 3.2653.390 | 3.2667.390 |
| | 11 | 270 | 3.2654.270 |
| 285 | | 3.2654.285 | |
| 300 | | 3.2654.300 | |
| 315 | | 3.2654.315 | |
| 330 | | 3.2654.330 | |
| 345 | | 3.2654.345 | |
| 360 | | 3.2654.360 | |
| 375 | | 3.2654.375 | |
| 390 | | 3.2654.390 | |
| 12 | | 270 | 3.2655.270 |
| | 285 | 3.2655.285 | |
| | 300 | 3.2655.300 | |
| | 315 | 3.2655.315 | |
| | 330 | 3.2655.330 | |
| | 345 | 3.2655.345 | |
| | 360 | 3.2655.360 | |
| | 375 | 3.2655.375 | |
| | 390 | 3.2655.390 | |



Use with instrument set no. **40.5300.500** or **40.5300.650**
Stosować z instrumentarium **40.5300.500** lub **40.5300.650**

| | TiA | | | | |
|--|------------|-----|---|-----|-------|
| | 3.5160.xxx | T25 | ✓ | 5.5 | 30÷90 |
| | 3.5159.xxx | T25 | | 5.0 | 30÷90 |
| | 3.5170.xxx | T25 | ✓ | 4.5 | 25÷80 |
| | 3.5169.xxx | T25 | | 4.0 | 25÷80 |
| | 3.5162.002 | T25 | | | |
| | 3.5161.1xx | T25 | ✓ | | 0÷15 |



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5180.180S


Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5180.180S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-38 See surgical technique
Patrz technika operacyjna

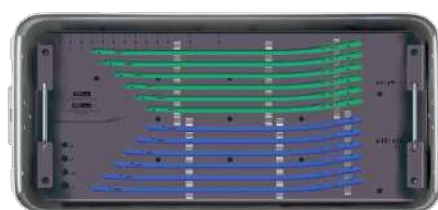

Stand for tibial nails CHARFIX/CHARFIX2 (implants not included)
Statyw do gwoździ piszczelowych CHARFIX/CHARFIX2 (bez implantów)

40.5750.000

CHARFIX2 DISTAL SCREW 4.0
CHARFIX2 WKREŃT BLOKUJĄCY 4,0



| T25 | |
|-----|------------|
| Len | TiA |
| 25 | 3.5169.025 |
| 30 | 3.5169.030 |
| 35 | 3.5169.035 |
| 40 | 3.5169.040 |
| 45 | 3.5169.045 |
| 50 | 3.5169.050 |
| 55 | 3.5169.055 |
| 60 | 3.5169.060 |
| 65 | 3.5169.065 |
| 70 | 3.5169.070 |
| 75 | 3.5169.075 |
| 80 | 3.5169.080 |

CHARFIX2 DISTAL SCREW 4.5
CHARFIX2 WKREŃT BLOKUJĄCY 4,5



| T25 | |
|-----|------------|
| Len | TiA |
| 25 | 3.5170.025 |
| 30 | 3.5170.030 |
| 35 | 3.5170.035 |
| 40 | 3.5170.040 |
| 45 | 3.5170.045 |
| 50 | 3.5170.050 |
| 55 | 3.5170.055 |
| 60 | 3.5170.060 |
| 65 | 3.5170.065 |
| 70 | 3.5170.070 |
| 75 | 3.5170.075 |
| 80 | 3.5170.080 |

CHARFIX2 DISTAL SCREW 5.0
CHARFIX2 WKREŃT BLOKUJĄCY 5,0




| T25 | |
|-----|------------|
| Len | TiA |
| 30 | 3.5159.030 |
| 35 | 3.5159.035 |
| 40 | 3.5159.040 |
| 45 | 3.5159.045 |
| 50 | 3.5159.050 |
| 55 | 3.5159.055 |
| 60 | 3.5159.060 |
| 65 | 3.5159.065 |
| 70 | 3.5159.070 |
| 75 | 3.5159.075 |
| 80 | 3.5159.080 |
| 85 | 3.5159.085 |
| 90 | 3.5159.090 |

CHARFIX2 DISTAL SCREW 5.5
CHARFIX2 WKREŃT BLOKUJĄCY 5,5



| T25 | |
|-----|------------|
| Len | TiA |
| 30 | 3.5160.030 |
| 35 | 3.5160.035 |
| 40 | 3.5160.040 |
| 45 | 3.5160.045 |
| 50 | 3.5160.050 |
| 55 | 3.5160.055 |
| 60 | 3.5160.060 |
| 65 | 3.5160.065 |
| 70 | 3.5160.070 |
| 75 | 3.5160.075 |
| 80 | 3.5160.080 |
| 85 | 3.5160.085 |
| 90 | 3.5160.090 |

CHARFIX2 END CAP M8
CHARFIX2 ŚRUBA ZASLEPIAJĄCA M8



| T25 | |
|-----|------------|
| A | TiA |
| 0 | 3.5161.100 |
| +5 | 3.5161.105 |
| +10 | 3.5161.110 |
| +15 | 3.5161.115 |

CHARFIX2 COMPRESSION SCREW M8
CHARFIX2 ŚRUBA KOMPRESYJNA M8



| T25 | |
|-----|------------|
| | TiA |
| | 3.5162.002 |



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5180.180S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufixs "S", np. 3.5180.180S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży





Stand for CHARFIX2 nail locking elements
(set with a box without implants)
Statyw na elementy blokujące gwoździe CHARFIX2
(komplet z puszką bez implantów)

40.5058.200



Stand for CHARFIX2 tibial nails and screws
(set with a box without implants)
Statyw na wkrety i gwoździe piszczelowe CHARFIX2
(komplet z puszką bez implantów)

15.0424.600

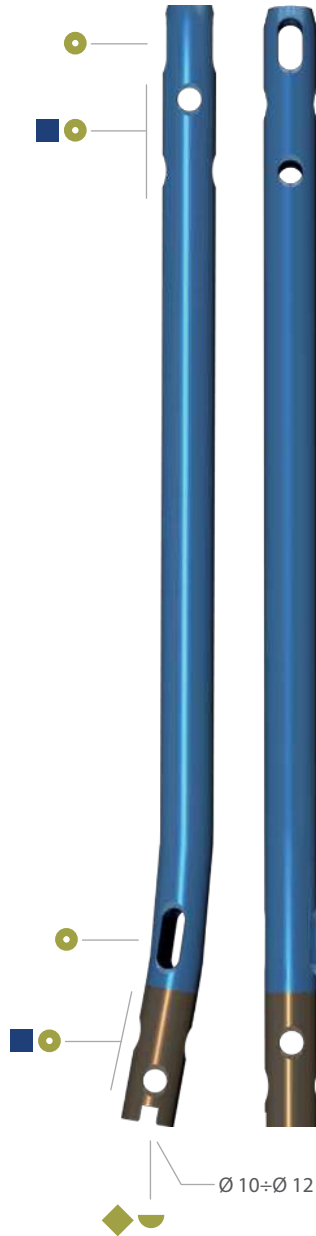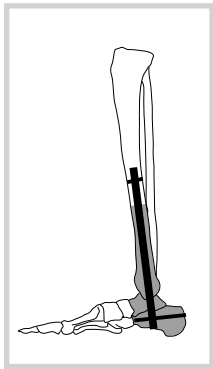

| | | TiA | |
|-----|------------|------------|------------|
| | Len | L | R |
| 10 | 180 | 3.5679.180 | 3.5680.180 |
| | 200 | 3.5679.200 | 3.5680.200 |
| | 220 | 3.5679.220 | 3.5680.220 |
| | 240 | 3.5679.240 | 3.5680.240 |
| | 260 | 3.5679.260 | 3.5680.260 |
| | 280 | 3.5679.280 | 3.5680.280 |
| | 300 | 3.5679.300 | 3.5680.300 |
| 11 | 320 | 3.5679.320 | 3.5680.320 |
| | 180 | 3.5681.180 | 3.5682.180 |
| | 200 | 3.5681.200 | 3.5682.200 |
| | 220 | 3.5681.220 | 3.5682.220 |
| | 240 | 3.5681.240 | 3.5682.240 |
| | 260 | 3.5681.260 | 3.5682.260 |
| | 280 | 3.5681.280 | 3.5682.280 |
| 12 | 300 | 3.5681.300 | 3.5682.300 |
| | 320 | 3.5681.320 | 3.5682.320 |
| | 180 | 3.5683.180 | 3.5684.180 |
| | 200 | 3.5683.200 | 3.5684.200 |
| | 220 | 3.5683.220 | 3.5684.220 |
| | 240 | 3.5683.240 | 3.5684.240 |
| | 260 | 3.5683.260 | 3.5684.260 |
| 280 | 3.5683.280 | 3.5684.280 | |
| 300 | 3.5683.300 | 3.5684.300 | |
| 320 | 3.5683.320 | 3.5684.320 | |



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5180.180S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5180.180S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-46 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **40.5300.500** with **40.5380.500**
or **40.5300.600 + 40.5300.610** with **40.5380.500**
Stosować z instrumentarium **40.5300.500** wraz z **40.5380.500**
lub **40.5300.600 + 40.5300.610** wraz z **40.5380.500**

| | TiA | | | | | |
|--|-----|------------|-----|---|-----|--------|
| | ■ | 3.5160.xxx | T25 | ✓ | 5.5 | 30÷100 |
| | ● | 3.5159.xxx | T25 | | 5.0 | 30÷100 |
| | ◐ | 3.5162.006 | T25 | ✓ | | |
| | ◆ | 3.5161.006 | T25 | | | |



Stand for tibial nails CHARFIX/CHARFIX2
(implants not included)
Statyw do gwóźdźi piszczelowych CHARFIX/CHARFIX2
(bez implantów)

40.5750.000

CHARFIX2 DISTAL SCREW 5.0
CHARFIX2 WKRĘT BLOKUJĄCY 5,0



| T25 | |
|-----|------------|
| Len | TiA |
| 26 | 3.5159.026 |
| 28 | 3.5159.028 |
| 30 | 3.5159.030 |
| 35 | 3.5159.035 |
| 40 | 3.5159.040 |
| 45 | 3.5159.045 |
| 50 | 3.5159.050 |
| 55 | 3.5159.055 |
| 60 | 3.5159.060 |
| 65 | 3.5159.065 |
| 70 | 3.5159.070 |
| 75 | 3.5159.075 |
| 80 | 3.5159.080 |
| 85 | 3.5159.085 |
| 90 | 3.5159.090 |

CHARFIX2 DISTAL SCREW 5.5
CHARFIX2 WKRĘT BLOKUJĄCY 5,5



| T25 | |
|-----|------------|
| Len | TiA |
| 26 | 3.5160.026 |
| 28 | 3.5160.028 |
| 30 | 3.5160.030 |
| 35 | 3.5160.035 |
| 40 | 3.5160.040 |
| 45 | 3.5160.045 |
| 50 | 3.5160.050 |
| 55 | 3.5160.055 |
| 60 | 3.5160.060 |
| 65 | 3.5160.065 |
| 70 | 3.5160.070 |
| 75 | 3.5160.075 |
| 80 | 3.5160.080 |
| 85 | 3.5160.085 |
| 90 | 3.5160.090 |

CHARFIX2 END CAP M8 SPEC.
CHARFIX2 ŚRUBA ZAŚLEPIAJĄCA M8 SPEC.



| T25 | |
|-----|------------|
| TiA | |
| | 3.5161.006 |

CHARFIX2 COMPRESSION SCREW M7X1
CHARFIX2 ŚRUBA KOMPRESYJNA M7X1



| T25 | |
|-----|------------|
| TiA | |
| | 3.5162.006 |



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5180.180S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufix "S", np. 3.5180.180S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



Stand for CHARFIX2 nail locking elements
(set with a box without implants)
Statyw na elementy blokujące gwoździe CHARFIX2
(komplet z puszką bez implantów)


40.5058.200



Stand for CHARFIX2 tibial nails and screws
(set with a box without implants)
Statyw na wkręty i gwoździe piszczelowe CHARFIX2
(komplet z puszką bez implantów)

15.0424.600

CHARFIX *system 2*

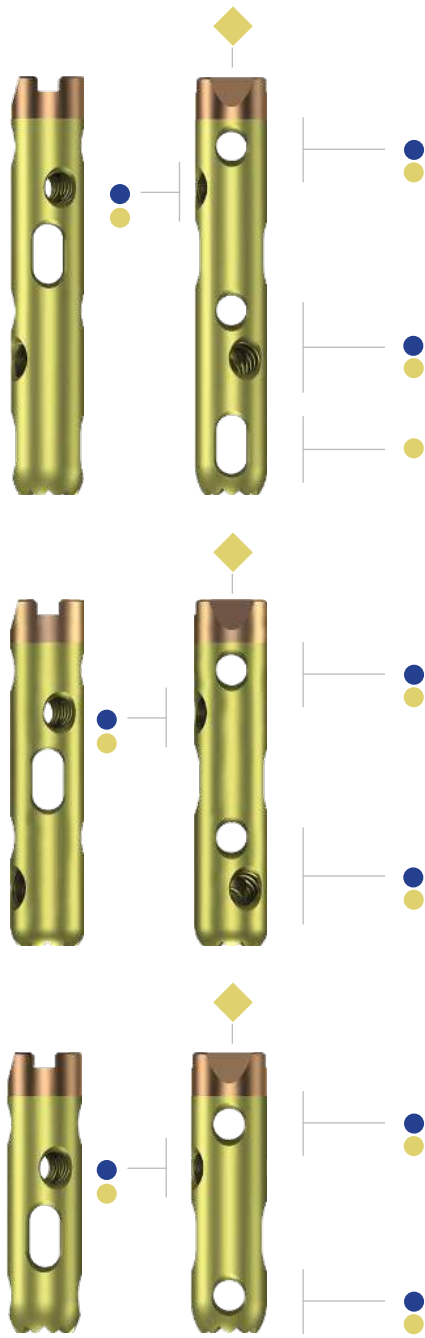

| | | Len | | |
|----|--|-----|------------|------------|
| 10 | | 45 | 3.6385.045 | 3.6386.045 |
| | | 55 | 3.6385.055 | 3.6386.055 |
| | | 70 | 3.6385.070 | 3.6386.070 |
| 12 | | 45 | 3.6389.045 | 3.6390.045 |
| | | 55 | 3.6389.055 | 3.6390.055 |
| | | 70 | 3.6389.070 | 3.6390.070 |



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5180.180S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufix "S", np. 3.5180.180S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-83 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **15.0428.100**
Stosować z instrumentarium **15.0428.100**

| | 3.5155.xxx | T25 | | ✓ | 5,0 | 20-60 |
|--|------------|-----|---|---|-----|-------|
| | 3.5156.xxx | T25 | ✓ | ✓ | 5,5 | 20-60 |
| | 3.5161.8xx | T25 | | ✓ | | 0-20 |

CHARFIX2 DISTAL SCREW 5.0
CHARFIX2 WKREŃT BLOKUJĄCY 5,0




| Len | T25 | TiA |
|-----|-----|------------|
| 20 | | 3.5155.020 |
| 22 | | 3.5155.022 |
| 24 | | 3.5155.024 |
| 26 | | 3.5155.026 |
| 28 | | 3.5155.028 |
| 30 | | 3.5155.030 |
| 32 | | 3.5155.032 |
| 34 | | 3.5155.034 |
| 36 | | 3.5155.036 |
| 38 | | 3.5155.038 |
| 40 | | 3.5155.040 |
| 42 | | 3.5155.042 |
| 45 | | 3.5155.045 |
| 50 | | 3.5155.050 |
| 55 | | 3.5155.055 |
| 60 | | 3.5155.060 |

CHARFIX2 DISTAL SCREW 5.5
CHARFIX2 WKREŃT BLOKUJĄCY 5,5



| Len | T25 | TiA |
|-----|-----|------------|
| 20 | | 3.5156.020 |
| 22 | | 3.5156.022 |
| 24 | | 3.5156.024 |
| 26 | | 3.5156.026 |
| 28 | | 3.5156.028 |
| 30 | | 3.5156.030 |
| 32 | | 3.5156.032 |
| 34 | | 3.5156.034 |
| 36 | | 3.5156.036 |
| 38 | | 3.5156.038 |
| 40 | | 3.5156.040 |
| 42 | | 3.5156.042 |
| 45 | | 3.5156.045 |
| 50 | | 3.5156.050 |
| 55 | | 3.5156.055 |
| 60 | | 3.5156.060 |

CHARFIX2 END CAP M6
CHARFIX2 ŚRUBA ZASLEPIAJĄCA M6




| A | T25 | TiA |
|-----|-----|------------|
| 0 | | 3.5161.800 |
| +5 | | 3.5161.805 |
| +10 | | 3.5161.810 |
| +15 | | 3.5161.815 |
| +20 | | 3.5161.820 |



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5180.180S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5180.180S





For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży

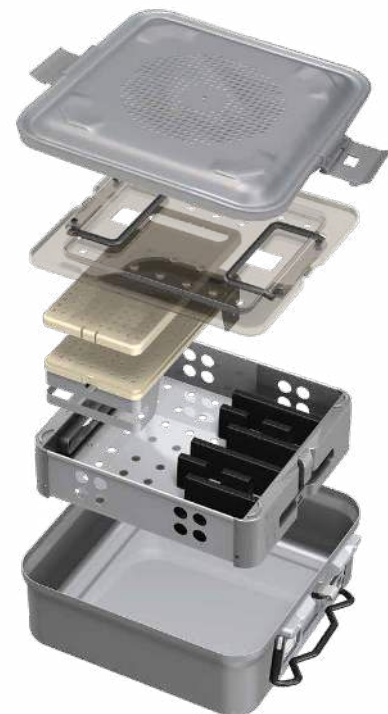

Stand for calcaneal nails
Statyw na gwoździe piętowe

15.0428.601

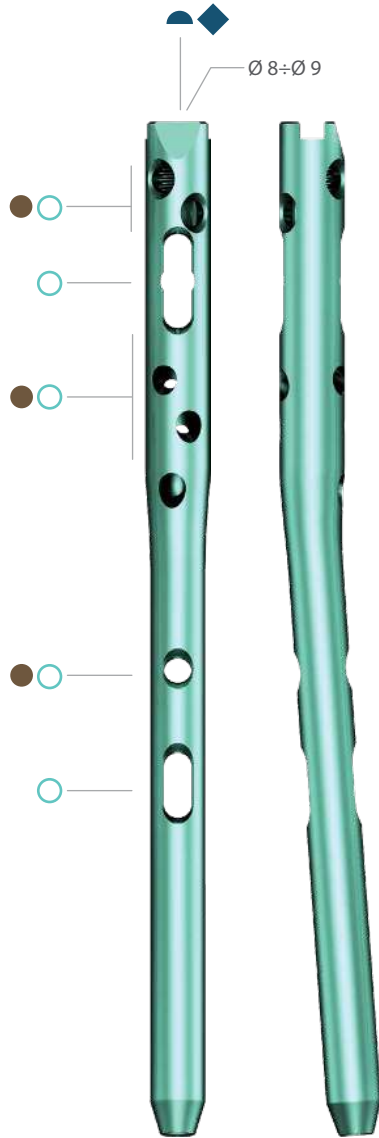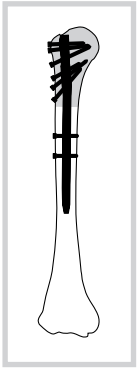

| | | |
|-----|---|------------|
| Len | | TiA |
| | | |
| 150 | 8 | 3.2978.150 |
| | 9 | 3.2979.150 |



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5180.180S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5180.180S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży




ST-43 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **40.5880.600** or **40.5880.700**
Stosować z instrumentarium **40.5880.600** lub **40.5880.700**

| | | | | | | |
|--|------------|-----|---|-----|-------|--|
| | TiA | | | | | |
| | 3.5170.xxx | T25 | ✓ | 4.5 | 25÷70 | |
| | 3.5169.xxx | T25 | | 4.0 | 25÷70 | |
| | 3.5162.004 | T25 | | | | |
| | 3.5161.2xx | T25 | ✓ | | 0÷5 | |

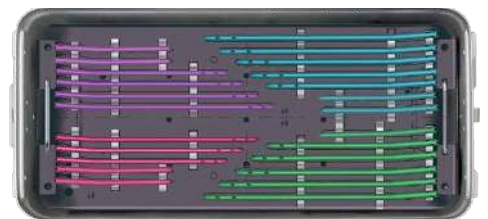

Stand for humeral nails (implants not included)
Statyw na gwoździe ramienne (bez implantów)

40.5751.000



| | Len | TiA | |
|---|-----|------------|---|
| | | L | R |
| 6 | 180 | 3.2956.180 | |
| | 200 | 3.2956.200 | |
| | 220 | 3.2956.220 | |
| | 240 | 3.2956.240 | |
| | 260 | 3.2956.260 | |
| | 280 | 3.2956.280 | |
| | 300 | 3.2956.300 | |
| 7 | 320 | 3.2956.320 | |
| | 180 | 3.2957.180 | |
| | 200 | 3.2957.200 | |
| | 220 | 3.2957.220 | |
| | 240 | 3.2957.240 | |
| | 260 | 3.2957.260 | |
| | 280 | 3.2957.280 | |
| 8 | 300 | 3.2957.300 | |
| | 320 | 3.2957.320 | |
| | 180 | 3.2958.180 | |
| | 200 | 3.2958.200 | |
| | 220 | 3.2958.220 | |
| | 240 | 3.2958.240 | |
| | 260 | 3.2958.260 | |
| 9 | 280 | 3.2958.280 | |
| | 300 | 3.2958.300 | |
| | 320 | 3.2958.320 | |
| | 180 | 3.2959.180 | |
| | 200 | 3.2959.200 | |
| | 220 | 3.2959.220 | |
| | 240 | 3.2959.240 | |
| | 260 | 3.2959.260 | |
| | 280 | 3.2959.280 | |
| | 300 | 3.2959.300 | |
| | 320 | 3.2959.320 | |

The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5180.180S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5180.180S


For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży

ST-43 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **40.5880.600** or **40.5880.700 + 40.5880.710**
Stosować z instrumentarium **40.5880.600** lub **40.5880.700 + 40.5880.710**

| | TiA | | | | | |
|--|------------|-----|---|-----|-------|--|
| | 3.5170.xxx | T25 | ✓ | 4.5 | 25÷70 | |
| | 3.5169.xxx | T25 | | 4.0 | 25÷70 | |
| | 3.5173.xxx | T25 | | 3.0 | 20÷50 | |
| | 3.5162.004 | T25 | | | | |
| | 3.5161.2xx | T25 | ✓ | | 0÷5 | |

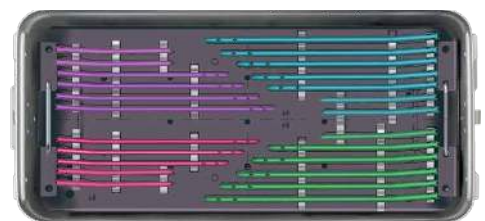

Stand for humeral nails (implants not included)
Statyw na gwoździe ramienne (bez implantów)

40.5751.000

CHARFIX2 DISTAL SCREW 4.0
CHARFIX2 WKRĘT BLOKUJĄCY 4,0



| | |
|----|------------|
| 25 | 3.5169.025 |
| 30 | 3.5169.030 |
| 35 | 3.5169.035 |
| 40 | 3.5169.040 |
| 45 | 3.5169.045 |
| 50 | 3.5169.050 |
| 55 | 3.5169.055 |
| 60 | 3.5169.060 |
| 65 | 3.5169.065 |
| 70 | 3.5169.070 |

CHARFIX2 DISTAL SCREW 4.5
CHARFIX2 WKRĘT BLOKUJĄCY 4,5



| | |
|----|------------|
| 25 | 3.5170.025 |
| 30 | 3.5170.030 |
| 35 | 3.5170.035 |
| 40 | 3.5170.040 |
| 45 | 3.5170.045 |
| 50 | 3.5170.050 |
| 55 | 3.5170.055 |
| 60 | 3.5170.060 |
| 65 | 3.5170.065 |
| 70 | 3.5170.070 |

CHARFIX2 DISTAL SCREW 3.0
CHARFIX2 WKRĘT BLOKUJĄCY 3,0




| | |
|----|------------|
| 20 | 3.5173.020 |
| 25 | 3.5173.025 |
| 30 | 3.5173.030 |
| 35 | 3.5173.035 |
| 40 | 3.5173.040 |
| 45 | 3.5173.045 |
| 50 | 3.5173.050 |

CHARFIX2 COMPRESSION SCREW M6X1
CHARFIX2 ŚRUBA KOMPRESYJNA M6X1



3.5162.004

CHARFIX2 END CAP M6
CHARFIX2 ŚRUBA ZASLEPIAJĄCA M6



| | |
|------|------------|
| 0 | 3.5161.200 |
| +2.5 | 3.5161.202 |
| +5 | 3.5161.205 |



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5180.180S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5180.180S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży




Stand for CHARFIX2 nail locking elements
(set with a box without implants)
Statyw na elementy blokujące gwoździe CHARFIX2
(komplet z puszką bez implantów)

40.5058.200




Stand for CHARFIX2 humeral nails and screws
(set with a box without implants)
Statyw na wkręty i gwoździe ramienne CHARFIX2
(komplet z puszką bez implantów)

15.0426.600

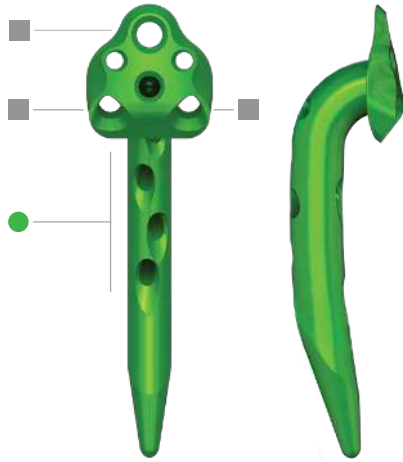

| Len | TiA |
|-----|------------|
| 50 | 3.5321.000 |


| | TiA | Co | | | |
|------------|-----|----|----|-----|-------|
| 3.5332.xxx | ✓ | | T8 | 2.4 | 12÷50 |
| 4.5235.xxx | | ✓ | T8 | 2.4 | 8÷38 |

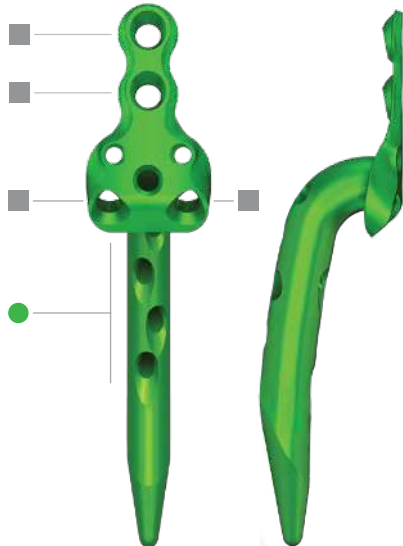

CHARFIX2 RADIAL NAIL L-61
CHARFIX2 GWÓŹDŹ PROMIENIOWY L-61

| Len | Ti |
|-----|------------|
| 61 | 3.5321.002 |


| | TiA | Co | | | |
|------------|-----|----|----|-----|-------|
| 3.5332.xxx | ✓ | | T8 | 2.4 | 12÷50 |
| 4.5235.xxx | | ✓ | T8 | 2.4 | 8÷38 |

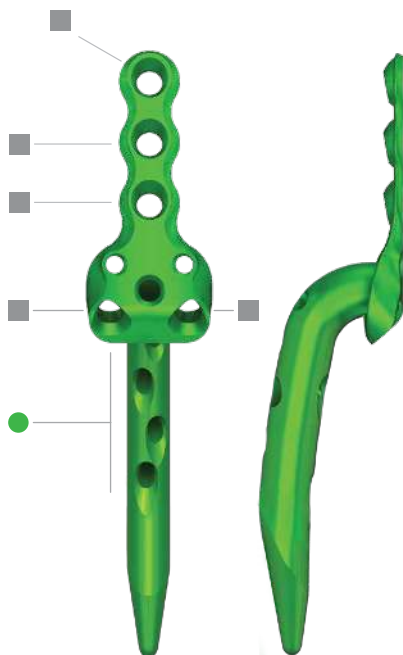

CHARFIX2 RADIAL NAIL L-68
CHARFIX2 GWÓŹDŹ PROMIENIOWY L-68

| Len | Ti |
|-----|------------|
| 68 | 3.5321.003 |


| | TiA | Co | | | |
|------------|-----|----|----|-----|-------|
| 3.5332.xxx | ✓ | | T8 | 2.4 | 12÷50 |
| 4.5235.xxx | | ✓ | T8 | 2.4 | 8÷38 |

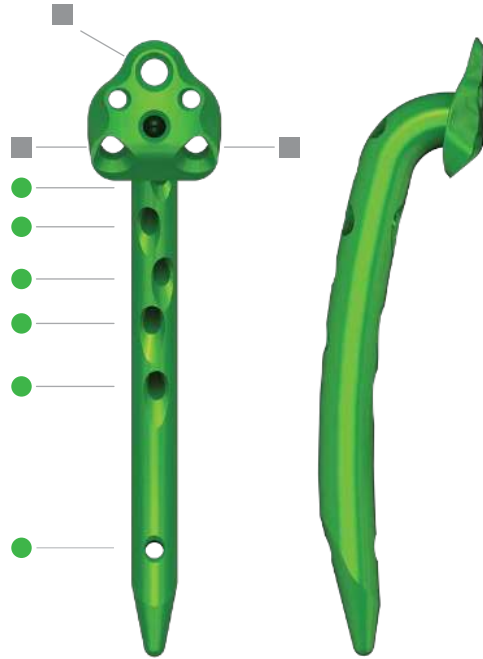

| Len | TiA |
|-----|------------|
| 68 | 3.5322.000 |

| | | TiA | Co | | | |
|--|------------|-----|----|----|-----|-------|
| | 3.5332.xxx | ✓ | | T8 | 2.4 | 12÷50 |
| | 4.5235.xxx | | ✓ | T8 | 2.4 | 8÷38 |

CHARFIX2 RADIAL NAIL L-79
CHARFIX2 GWÓZDŹ PROMIENIOWY L-79

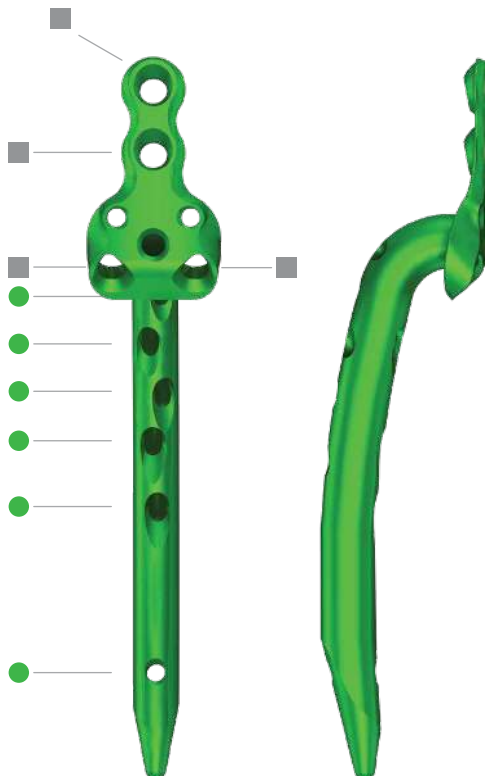


| Len | Ti |
|-----|------------|
| 79 | 3.5322.002 |

| | | TiA | Co | | | |
|--|------------|-----|----|----|-----|-------|
| | 3.5332.xxx | ✓ | | T8 | 2.4 | 12÷50 |
| | 4.5235.xxx | | ✓ | T8 | 2.4 | 8÷38 |

CHARFIX2 RADIAL NAIL L-86
CHARFIX2 GWÓŹDŹ PROMIENIOWY L-86


CHARFIX *system 2*

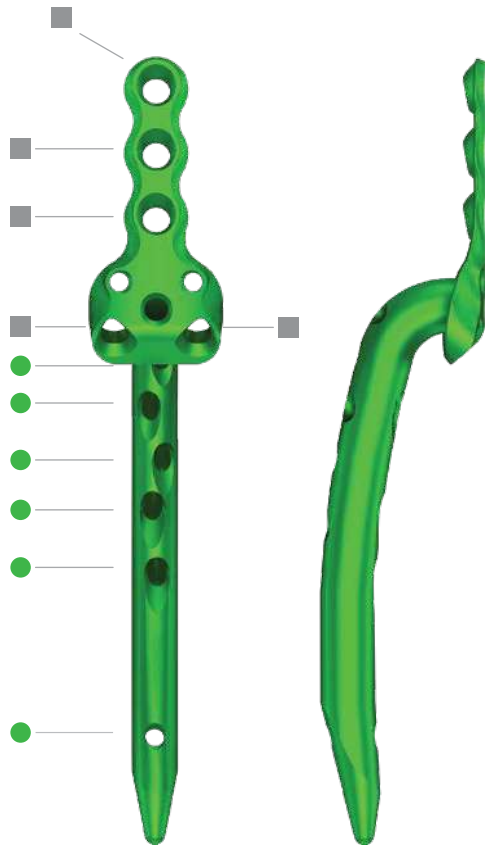

| Len | Ti |
|-----|------------|
| 86 | 3.5322.003 |

| | TiA | Co | | | |
|------------|-----|----|----|-----|-------|
| 3.5332.xxx | ✓ | | T8 | 2.4 | 12÷50 |
| 4.5235.xxx | | ✓ | T8 | 2.4 | 8÷38 |


CHARFIX2 RADIAL NAIL L-85
CHARFIX2 GWÓŹDŹ PROMIENIOWY L-85

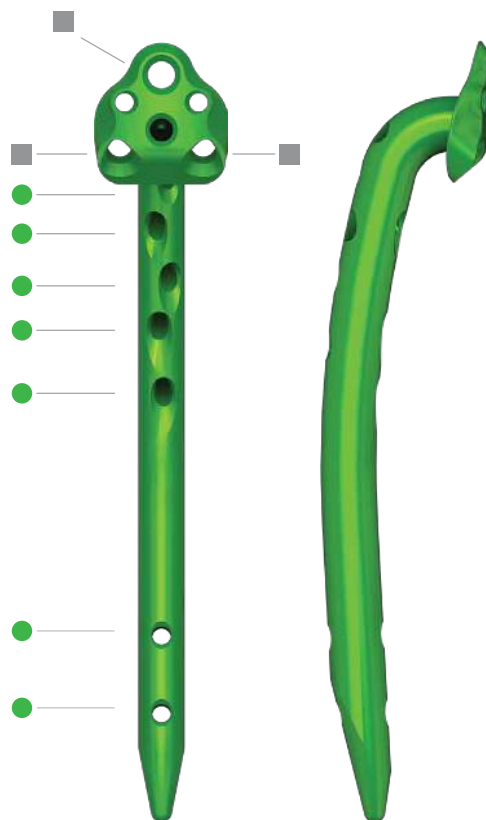

| Len | TiA |
|-----|------------|
| 85 | 3.5324.000 |

| | TiA | Co | | | |
|------------|-----|----|----|-----|-------|
| 3.5332.xxx | ✓ | | T8 | 2.4 | 12÷50 |
| 4.5235.xxx | | ✓ | T8 | 2.4 | 8÷38 |


CHARFIX^{system 2}

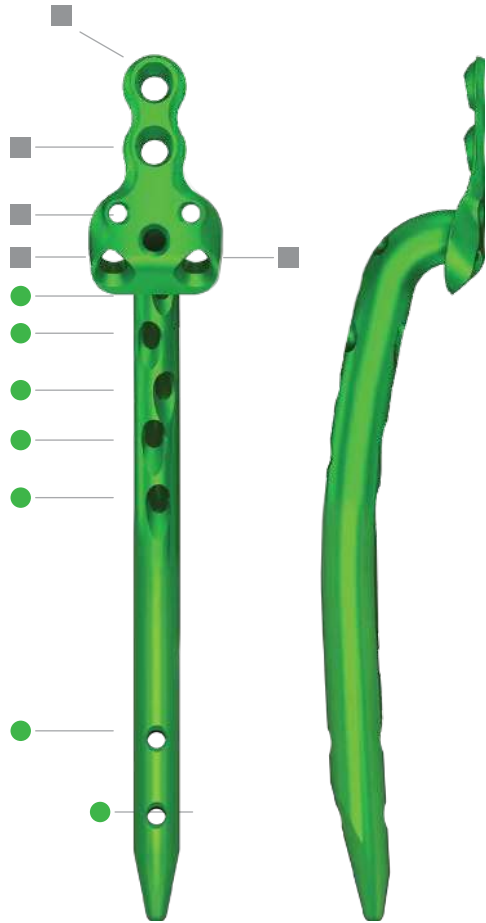

| Len | Ti |
|-----|------------|
| 96 | 3.5324.002 |

| | TiA | Co | | | |
|------------|-----|----|----|-----|-------|
| 3.5332.xxx | ✓ | | T8 | 2.4 | 12÷50 |
| 4.5235.xxx | | ✓ | T8 | 2.4 | 8÷38 |

CHARFIX2 RADIAL NAIL L-103
CHARFIX2 GWÓŹDŹ PROMIENIOWY L-103

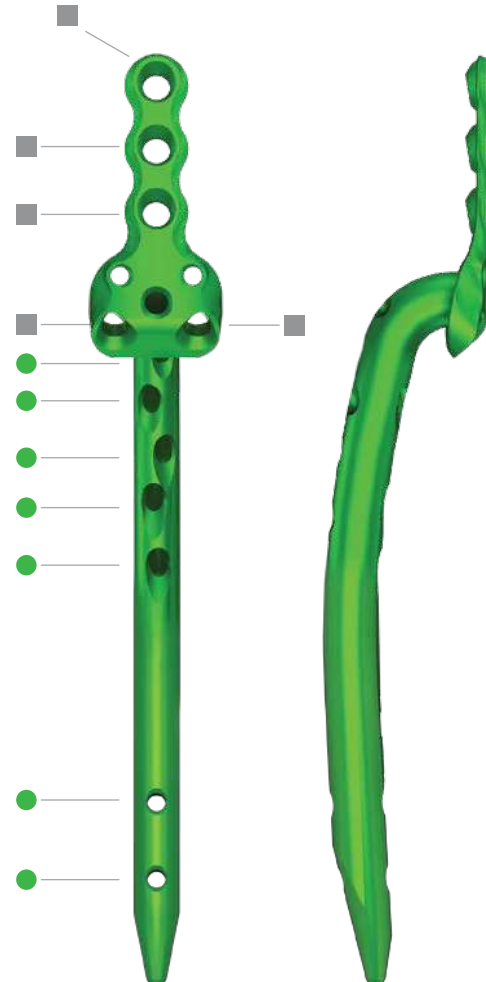

| Len | Ti |
|-----|------------|
| 103 | 3.5324.003 |

| | TiA | Co | | | |
|------------|-----|----|----|-----|-------|
| 3.5332.xxx | ✓ | | T8 | 2.4 | 12÷50 |
| 4.5235.xxx | | ✓ | T8 | 2.4 | 8÷38 |

The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5180.180S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5180.180S

For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży

ST-85 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **15.0429.100**
Stosować z instrumentarium **15.0429.100**

CHARFIX2 LOCKING SCREW 2.4 CHARFIX2 WKREŃ BLOKUJĄCY 2,4



| Len | T8 | TiA |
|-----|----|------------|
| 12 | | 3.5332.012 |
| 14 | | 3.5332.014 |
| 16 | | 3.5332.016 |
| 18 | | 3.5332.018 |
| 20 | | 3.5332.020 |
| 22 | | 3.5332.022 |
| 24 | | 3.5332.024 |
| 26 | | 3.5332.026 |
| 28 | | 3.5332.028 |
| 30 | | 3.5332.030 |
| 32 | | 3.5332.032 |
| 34 | | 3.5332.034 |
| 36 | | 3.5332.036 |
| 38 | | 3.5332.038 |
| 40 | | 3.5332.040 |
| 42 | | 3.5332.042 |
| 44 | | 3.5332.044 |
| 46 | | 3.5332.046 |
| 48 | | 3.5332.048 |
| 50 | | 3.5332.050 |

4.0CHLP SCREW VA 2.4 4,0CHLP WKREŃ VA 2,4




| Len | T8 | Co |
|-----|----|------------|
| 8 | | 4.5235.008 |
| 10 | | 4.5235.010 |
| 12 | | 4.5235.012 |
| 14 | | 4.5235.014 |
| 16 | | 4.5235.016 |
| 18 | | 4.5235.018 |
| 20 | | 4.5235.020 |
| 22 | | 4.5235.022 |
| 24 | | 4.5235.024 |
| 26 | | 4.5235.026 |
| 28 | | 4.5235.028 |
| 30 | | 4.5235.030 |
| 32 | | 4.5235.032 |
| 34 | | 4.5235.034 |
| 36 | | 4.5235.036 |
| 38 | | 4.5235.038 |




The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5180.180S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5180.180S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży

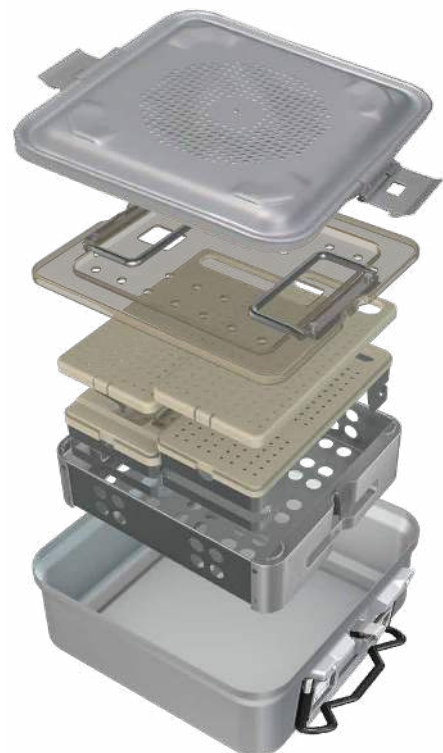

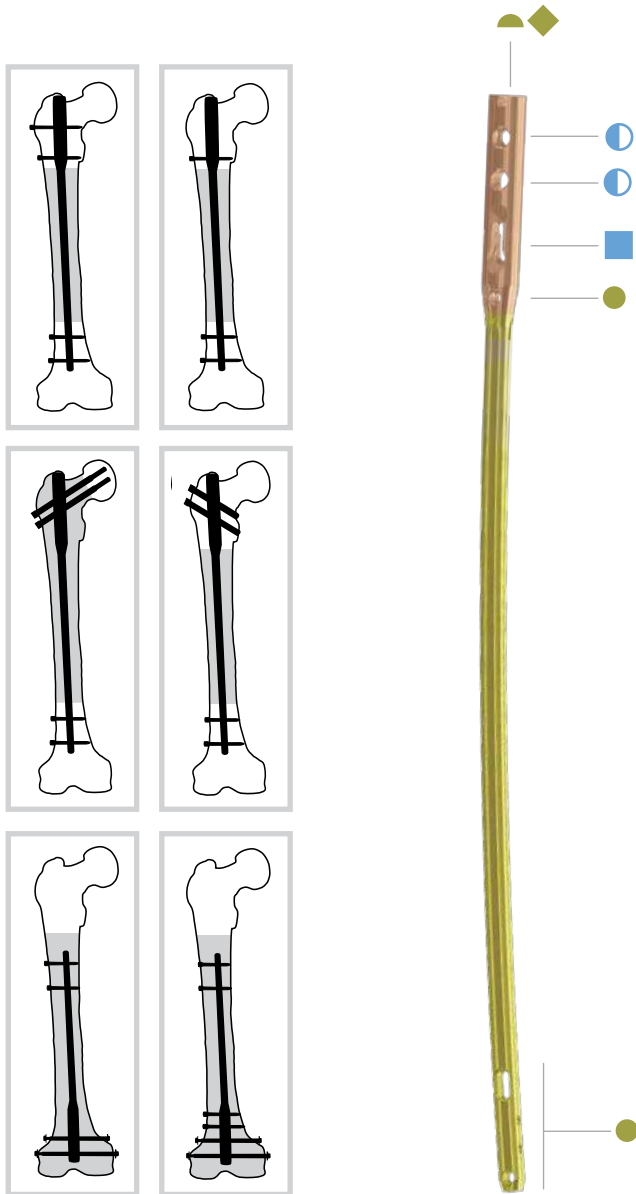

CHARFIX system

| | Len | L | R |
|-----|------------|------------|------------|
| 9 | 200 | 3.2855.200 | 3.2854.200 |
| | 220 | 3.2855.220 | 3.2854.220 |
| | 240 | 3.2855.240 | 3.2854.240 |
| | 260 | 3.2855.260 | 3.2854.260 |
| | 280 | 3.2855.280 | 3.2854.280 |
| | 300 | 3.2855.300 | 3.2854.300 |
| | 320 | 3.2855.320 | 3.2854.320 |
| | 340 | 3.2855.340 | 3.2854.340 |
| | 360 | 3.2855.360 | 3.2854.360 |
| | 380 | 3.2855.380 | 3.2854.380 |
| | 400 | 3.2855.400 | 3.2854.400 |
| | 420 | 3.2855.420 | 3.2854.420 |
| 10 | 440 | 3.2855.440 | 3.2854.440 |
| | 460 | 3.2855.460 | 3.2854.460 |
| | 200 | 3.2857.200 | 3.2856.200 |
| | 220 | 3.2857.220 | 3.2856.220 |
| | 240 | 3.2857.240 | 3.2856.240 |
| | 260 | 3.2857.260 | 3.2856.260 |
| | 280 | 3.2857.280 | 3.2856.280 |
| | 300 | 3.2857.300 | 3.2856.300 |
| | 320 | 3.2857.320 | 3.2856.320 |
| | 340 | 3.2857.340 | 3.2856.340 |
| | 360 | 3.2857.360 | 3.2856.360 |
| | 380 | 3.2857.380 | 3.2856.380 |
| 11 | 400 | 3.2857.400 | 3.2856.400 |
| | 420 | 3.2857.420 | 3.2856.420 |
| | 440 | 3.2857.440 | 3.2856.440 |
| | 460 | 3.2857.460 | 3.2856.460 |
| | 200 | 3.2859.200 | 3.2858.200 |
| | 220 | 3.2859.220 | 3.2858.220 |
| | 240 | 3.2859.240 | 3.2858.240 |
| | 260 | 3.2859.260 | 3.2858.260 |
| | 280 | 3.2859.280 | 3.2858.280 |
| | 300 | 3.2859.300 | 3.2858.300 |
| | 320 | 3.2859.320 | 3.2858.320 |
| | 340 | 3.2859.340 | 3.2858.340 |
| 12 | 360 | 3.2859.360 | 3.2858.360 |
| | 380 | 3.2859.380 | 3.2858.380 |
| | 400 | 3.2859.400 | 3.2858.400 |
| | 420 | 3.2859.420 | 3.2858.420 |
| | 440 | 3.2859.440 | 3.2858.440 |
| | 460 | 3.2859.460 | 3.2858.460 |
| | 200 | 3.2861.200 | 3.2860.200 |
| | 220 | 3.2861.220 | 3.2860.220 |
| | 240 | 3.2861.240 | 3.2860.240 |
| | 260 | 3.2861.260 | 3.2860.260 |
| | 280 | 3.2861.280 | 3.2860.280 |
| | 300 | 3.2861.300 | 3.2860.300 |
| 320 | 3.2861.320 | 3.2860.320 | |
| St | 340 | 3.2861.340 | 3.2860.340 |
| | 360 | 3.2861.360 | 3.2860.360 |
| | 380 | 3.2861.380 | 3.2860.380 |
| | 400 | 3.2861.400 | 3.2860.400 |
| | 420 | 3.2861.420 | 3.2860.420 |
| | 440 | 3.2861.440 | 3.2860.440 |
| 460 | 3.2861.460 | 3.2860.460 | |



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5180.180S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5180.180S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-24 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **40.5090.600, 40.5390.500**
or **40.5090.700 + 40.5090.710**
Stosować z instrumentarium **40.5090.600, 40.5390.500**
lub **40.5090.700 + 40.5090.710**



| | | | | | |
|--|---|------------|------|-----|------------|
| | ○ | 3.1651.xxx | S3.5 | 6.5 | 40÷110 |
| | ■ | 3.1652.xxx | S5.0 | ✓ | 6.5 60÷120 |
| | ◐ | 3.2109.xxx | S3.5 | 6.5 | 50÷90 |
| | ● | 3.1654.xxx | S3.5 | 4.5 | 30÷90 |
| | ◐ | 3.2106.007 | S3.5 | | |
| | ◆ | 3.2104.002 | S3.5 | | |
| | ◆ | 3.2104.3xx | S5.0 | ✓ | 0÷15 |



Stand for universal femoral nails (implants not included)
Statyw na gwoździe udowe uniwersalne (bez implantów)

40.5753.000

CHARFIX DISTAL SCREW 4.5
CHARFIX WKRĘT BLOKUJĄCY 4,5



| Len | S3.5 | TiA |
|-----|------|------------|
| 30 | | 3.1654.030 |
| 35 | | 3.1654.035 |
| 40 | | 3.1654.040 |
| 45 | | 3.1654.045 |
| 50 | | 3.1654.050 |
| 55 | | 3.1654.055 |
| 60 | | 3.1654.060 |
| 65 | | 3.1654.065 |
| 70 | | 3.1654.070 |
| 75 | | 3.1654.075 |
| 80 | | 3.1654.080 |
| 85 | | 3.1654.085 |
| 90 | | 3.1654.090 |

St

CHARFIX DISTAL SCREW 6.5
CHARFIX WKRĘT BLOKUJĄCY 6,5



| Len | S3.5 | TiA |
|-----|------|------------|
| 40 | | 3.1651.040 |
| 45 | | 3.1651.045 |
| 50 | | 3.1651.050 |
| 55 | | 3.1651.055 |
| 60 | | 3.1651.060 |
| 65 | | 3.1651.065 |
| 70 | | 3.1651.070 |
| 75 | | 3.1651.075 |
| 80 | | 3.1651.080 |
| 85 | | 3.1651.085 |
| 90 | | 3.1651.090 |
| 95 | | 3.1651.095 |
| 100 | | 3.1651.100 |
| 105 | | 3.1651.105 |
| 110 | | 3.1651.110 |

St


CHARFIX RECONSTRUCTION CANNULATED SCREW 6.5
CHARFIX WKRĘT REKONSTRUKCYJNY KANIULOWANY 6,5



| L | L ₁ | S5.0 | TiA |
|-----|----------------|------|------------|
| 60 | 25 | | 3.1652.060 |
| 65 | 25 | | 3.1652.065 |
| 70 | 25 | | 3.1652.070 |
| 75 | 25 | | 3.1652.075 |
| 80 | 25 | | 3.1652.080 |
| 85 | 25 | | 3.1652.085 |
| 90 | 25 | | 3.1652.090 |
| 95 | 32 | | 3.1652.095 |
| 100 | 32 | | 3.1652.100 |
| 105 | 32 | | 3.1652.105 |
| 110 | 32 | | 3.1652.110 |
| 115 | 32 | | 3.1652.115 |
| 120 | 32 | | 3.1652.120 |

St


CHARFIX END CAP M10X1
CHARFIX ŚRUBA ZAŚLEPIAJĄCA M10X1



| A | S3.5 | TiA |
|---|------|------------|
| 2 | | 3.2104.002 |

St


CHARFIX END CAP M10X1
CHARFIX ŚRUBA ZAŚLEPIAJĄCA M10X1



| A | S5.0 | TiA |
|-----|------|------------|
| 0 | | 3.2104.300 |
| +5 | | 3.2104.305 |
| +10 | | 3.2104.310 |
| +15 | | 3.2104.315 |

St

CHARFIX LOCKING SET 6.5
CHARFIX ZESTAW BLOKUJĄCY 6,5



| L | Range Zakres | S3.5 | TiA |
|----|--------------|------|------------|
| 50 | 50-65 | | 3.2109.050 |
| 60 | 60-75 | | 3.2109.060 |
| 70 | 70-85 | | 3.2109.070 |
| 80 | 80-95 | | 3.2109.080 |
| 90 | 90-105 | | 3.2109.090 |

St

CHARFIX COMPRESSION SCREW M10X1
CHARFIX ŚRUBA KOMPRESYJNA M10X1



| S3.5 | TiA |
|------|------------|
| | 3.2106.007 |

St



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5180.180S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5180.180S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży






Stand for CHARFIX nail locking elements
(set with a box without implants)
Statyw na elementy blokujące gwoździe CHARFIX
(komplet z puszką bez implantów)

40.4686.200



Stand for CHARFIX femoral screws and nails
(set with a box without implants)
Statyw na wkręty i gwoździe udowe CHARFIX
(komplet z puszką bez implantów)

15.0411.600

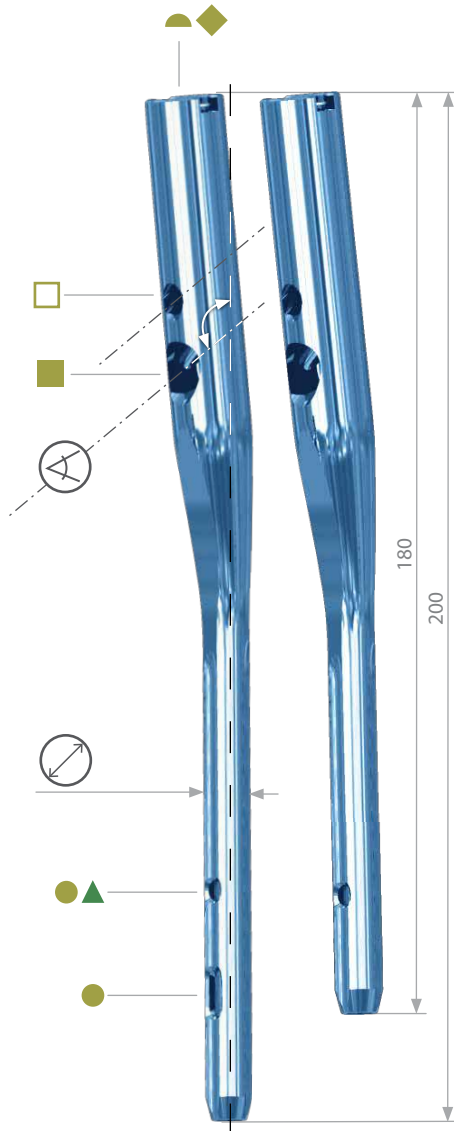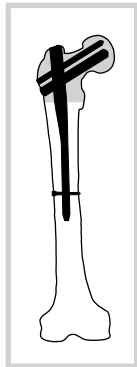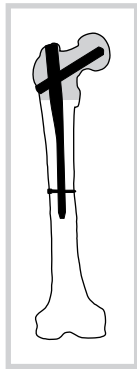

Recommended
Zalecane

| | | | | Len | |
|------|----|--|--|-----|------------|
| 125° | 10 | | | 180 | 3.4864.180 |
| | | | | 200 | 3.4864.200 |
| | 11 | | | 180 | 3.4865.180 |
| | | | | 200 | 3.4865.200 |
| | | | | 12 | 3.4866.180 |
| | | | | 200 | 3.4866.200 |
| 130° | 10 | | | 180 | 3.4876.180 |
| | | | | 200 | 3.4876.200 |
| | 11 | | | 180 | 3.4877.180 |
| | | | | 200 | 3.4877.200 |
| | | | | 12 | 3.4878.180 |
| | | | | 200 | 3.4878.200 |
| 135° | 10 | | | 180 | 3.4888.180 |
| | | | | 200 | 3.4888.200 |
| | 11 | | | 180 | 3.4889.180 |
| | | | | 200 | 3.4889.200 |
| | | | | 12 | 3.4890.180 |
| | | | | 200 | 3.4890.200 |



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5180.180S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufix "S", np. 3.5180.180S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-28 See surgical technique
Patrz technika operacyjna






Use with instrument set no. **40.5520.600**
Stosować z instrumentarium **40.5520.600**

| | TiA | | | | | |
|--|------------|------|---|---|-----|--------|
| | 3.1938.xxx | | | ✓ | 11 | 70÷120 |
| | 3.2104.003 | S3.5 | | ✓ | | |
| | 3.1935.xxx | S4 | | ✓ | 6.5 | 70÷120 |
| | 3.1657.xxx | S3.5 | ✓ | | 5.0 | 30÷60 |
| | 3.1654.xxx | S3.5 | | | 4.5 | 30÷60 |
| | 3.2106.008 | S4 | | | | |
| | 3.2104.6xx | S4 | | ✓ | | 0÷15 |



Stand for ChFN trochanteric nails
(set with a box without implants)
Stawy do gwoździ krętarzowych ChFN
(komplet z puszką bez implantów)

40.4687.200

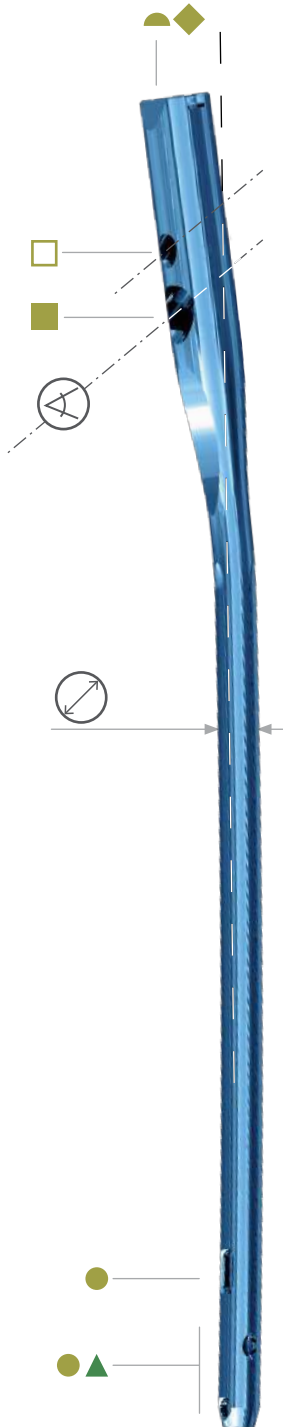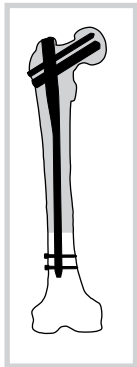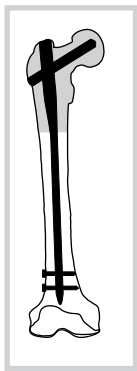

Recommended
Zalecane

| | | Len | L | R |
|------|-----|------------|------------|------------|
| 10 | | 340 | 3.4927.340 | 3.4926.340 |
| | | 360 | 3.4927.360 | 3.4926.360 |
| | | 380 | 3.4927.380 | 3.4926.380 |
| | | 400 | 3.4927.400 | 3.4926.400 |
| | | 420 | 3.4927.420 | 3.4926.420 |
| 125° | 11 | 340 | 3.4929.340 | 3.4928.340 |
| | | 360 | 3.4929.360 | 3.4928.360 |
| | | 380 | 3.4929.380 | 3.4928.380 |
| | | 400 | 3.4929.400 | 3.4928.400 |
| | | 420 | 3.4929.420 | 3.4928.420 |
| 12 | 340 | 3.4931.340 | 3.4930.340 | |
| | 360 | 3.4931.360 | 3.4930.360 | |
| | 380 | 3.4931.380 | 3.4930.380 | |
| | 400 | 3.4931.400 | 3.4930.400 | |
| | 420 | 3.4931.420 | 3.4930.420 | |
| 130° | 10 | 340 | 3.4951.340 | 3.4950.340 |
| | | 360 | 3.4951.360 | 3.4950.360 |
| | | 380 | 3.4951.380 | 3.4950.380 |
| | | 400 | 3.4951.400 | 3.4950.400 |
| | | 420 | 3.4951.420 | 3.4950.420 |
| | 11 | 340 | 3.4953.340 | 3.4952.340 |
| | | 360 | 3.4953.360 | 3.4952.360 |
| | | 380 | 3.4953.380 | 3.4952.380 |
| | | 400 | 3.4953.400 | 3.4952.400 |
| | | 420 | 3.4953.420 | 3.4952.420 |
| | 12 | 340 | 3.4955.340 | 3.4954.340 |
| | | 360 | 3.4955.360 | 3.4954.360 |
| | | 380 | 3.4955.380 | 3.4954.380 |
| | | 400 | 3.4955.400 | 3.4954.400 |
| | | 420 | 3.4955.420 | 3.4954.420 |
| 135° | 10 | 340 | 3.4975.340 | 3.4974.340 |
| | | 360 | 3.4975.360 | 3.4974.360 |
| | | 380 | 3.4975.380 | 3.4974.380 |
| | | 400 | 3.4975.400 | 3.4974.400 |
| | | 420 | 3.4975.420 | 3.4974.420 |
| | 11 | 340 | 3.4977.340 | 3.4976.340 |
| | | 360 | 3.4977.360 | 3.4976.360 |
| | | 380 | 3.4977.380 | 3.4976.380 |
| | | 400 | 3.4977.400 | 3.4976.400 |
| | | 420 | 3.4977.420 | 3.4976.420 |
| | 12 | 340 | 3.4979.340 | 3.4978.340 |
| | | 360 | 3.4979.360 | 3.4978.360 |
| | | 380 | 3.4979.380 | 3.4978.380 |
| | | 400 | 3.4979.400 | 3.4978.400 |
| | | 420 | 3.4979.420 | 3.4978.420 |



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5180.180S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufix "S", np. 3.5180.180S



For other sizes, please contact our Sales Department

W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-28 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **40.5520.600**
Stosować z instrumentarium **40.5520.600**

| | TiA | | | | | |
|--|------------|------|---|-----|--------|--|
| | 3.1938.xxx | | ✓ | 11 | 70÷120 | |
| | 3.2104.003 | S3.5 | ✓ | | | |
| | 3.1935.xxx | S4.0 | ✓ | 6.5 | 70÷120 | |
| | 3.1657.xxx | S3.5 | ✓ | 5.0 | 30÷60 | |
| | 3.1654.xxx | S3.5 | | 4.5 | 30÷60 | |
| | 3.2106.008 | S4.0 | | | | |
| | 3.2104.6xx | S4.0 | ✓ | | 0÷15 | |



Palette for trochanteric nails (implants not included)
Paleta do gwoździ krętarzowych (bez implantów)

40.4681.100



CHFN JOIN CANNULATED TROCHANTERIC
SCREW COLLAR 6.5
CHFN ŚRUBA ZESPALAJĄCA KANIULOWANA
KRĘTARZOWA Z KOŁNIERZEM 6,5



| Len | S4.0 | TiA |
|-----|------|------------|
| 70 | | 3.1935.070 |
| 75 | | 3.1935.075 |
| 80 | | 3.1935.080 |
| 85 | | 3.1935.085 |
| 90 | | 3.1935.090 |
| 95 | | 3.1935.095 |
| 100 | | 3.1935.100 |
| 105 | | 3.1935.105 |
| 110 | | 3.1935.110 |
| 115 | | 3.1935.115 |
| 120 | | 3.1935.120 |

CHARFIX DISTAL SCREW 4.5
CHARFIX WKREŃ BLOKUJĄCY 4,5



| Len | S3.5 | TiA |
|-----|------|------------|
| 30 | | 3.1654.030 |
| 35 | | 3.1654.035 |
| 40 | | 3.1654.040 |
| 45 | | 3.1654.045 |
| 50 | | 3.1654.050 |
| 55 | | 3.1654.055 |
| 60 | | 3.1654.060 |
| 65 | | 3.1654.065 |
| 70 | | 3.1654.070 |
| 75 | | 3.1654.075 |
| 80 | | 3.1654.080 |

CHARFIX DISTAL SCREW 5.0
CHARFIX WKREŃ BLOKUJĄCY 5,0



| Len | S3.5 | TiA |
|-----|------|------------|
| 30 | | 3.1657.030 |
| 35 | | 3.1657.035 |
| 40 | | 3.1657.040 |
| 45 | | 3.1657.045 |
| 50 | | 3.1657.050 |
| 55 | | 3.1657.055 |
| 60 | | 3.1657.060 |
| 65 | | 3.1657.065 |
| 70 | | 3.1657.070 |
| 75 | | 3.1657.075 |
| 80 | | 3.1657.080 |

CHFN JOIN CANNULATED TROCHANTERIC
SCREW COLLAR 11
CHFN ŚRUBA ZESPALAJĄCA KANIULOWANA
KRĘTARZOWA Z KOŁNIERZEM 11




| Len | O | TiA |
|-----|---|------------|
| 70 | | 3.1938.070 |
| 75 | | 3.1938.075 |
| 80 | | 3.1938.080 |
| 85 | | 3.1938.085 |
| 90 | | 3.1938.090 |
| 95 | | 3.1938.095 |
| 100 | | 3.1938.100 |
| 105 | | 3.1938.105 |
| 110 | | 3.1938.110 |
| 115 | | 3.1938.115 |
| 120 | | 3.1938.120 |

CHFN END CAP M8X1.25
CHFN ŚRUBA ZASLEPIAJĄCA M8X1,25



| Len | S3.5 | TiA |
|-----|------|------------|
| | | 3.2104.003 |

CHFN END CAP M12X1.75
CHFN ŚRUBA ZASLEPIAJĄCA M12X1,75



| A | S4.0 | TiA |
|-----|------|------------|
| 0 | | 3.2104.600 |
| +5 | | 3.2104.605 |
| +10 | | 3.2104.610 |
| +15 | | 3.2104.615 |

CHFN COMPRESSION SCREW M8X1.25
CHFN ŚRUBA KOMPRESYJNA M8X1,25





| Len | S4.0 | TiA |
|-----|------|------------|
| | | 3.2106.008 |



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5180.180S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5180.180S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży

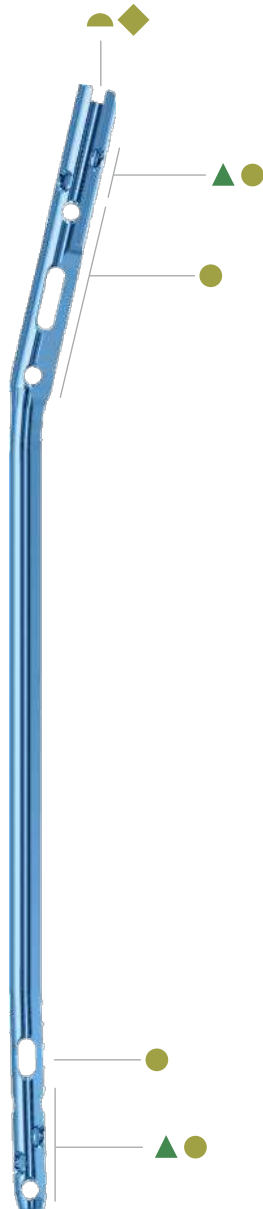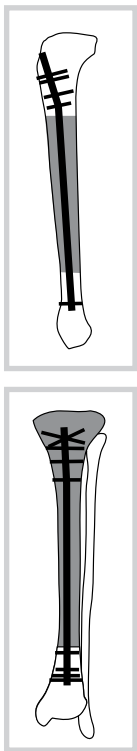

| Len | Len | TiA | L R | L R |
|-----|------------|-----|-----|------------|
| 270 | 3.2623.270 | | | 3.2637.270 |
| 285 | 3.2623.285 | | | 3.2637.285 |
| 300 | 3.2623.300 | | | 3.2637.300 |
| 315 | 3.2623.315 | | | 3.2637.315 |
| 330 | 3.2623.330 | | | 3.2637.330 |
| 345 | 3.2623.345 | | | 3.2637.345 |
| 360 | 3.2623.360 | | | 3.2637.360 |
| 375 | 3.2623.375 | | | 3.2637.375 |
| 390 | 3.2623.390 | | | 3.2637.390 |
| 270 | 3.2624.270 | | | 3.2638.270 |
| 285 | 3.2624.285 | | | 3.2638.285 |
| 300 | 3.2624.300 | | | 3.2638.300 |
| 315 | 3.2624.315 | | | 3.2638.315 |
| 330 | 3.2624.330 | | | 3.2638.330 |
| 345 | 3.2624.345 | | | 3.2638.345 |
| 360 | 3.2624.360 | | | 3.2638.360 |
| 375 | 3.2624.375 | | | 3.2638.375 |
| 390 | 3.2624.390 | | | 3.2638.390 |
| 270 | 3.2625.270 | | | 3.2639.270 |
| 285 | 3.2625.285 | | | 3.2639.285 |
| 300 | 3.2625.300 | | | 3.2639.300 |
| 315 | 3.2625.315 | | | 3.2639.315 |
| 330 | 3.2625.330 | | | 3.2639.330 |
| 345 | 3.2625.345 | | | 3.2639.345 |
| 360 | 3.2625.360 | | | 3.2639.360 |
| 375 | 3.2625.375 | | | 3.2639.375 |
| 390 | 3.2625.390 | | | 3.2639.390 |
| 270 | 3.2626.270 | | | |
| 285 | 3.2626.285 | | | |
| 300 | 3.2626.300 | | | |
| 315 | 3.2626.315 | | | |
| 330 | 3.2626.330 | | | |
| 345 | 3.2626.345 | | | |
| 360 | 3.2626.360 | | | |
| 375 | 3.2626.375 | | | |
| 390 | 3.2626.390 | | | |
| 270 | 3.2627.270 | | | |
| 285 | 3.2627.285 | | | |
| 300 | 3.2627.300 | | | |
| 315 | 3.2627.315 | | | |
| 330 | 3.2627.330 | | | |
| 345 | 3.2627.345 | | | |
| 360 | 3.2627.360 | | | |
| 375 | 3.2627.375 | | | |
| 390 | 3.2627.390 | | | |



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5180.180S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufix "S", np. 3.5180.180S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży




ST-25 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **40.5000.100, 40.5000.500, 40.5000.600**
Stosować z instrumentarium **40.5000.100, 40.5000.500, 40.5000.600**

| | TiA | | | | | |
|--|-----|------------|------|---|-----|-------|
| | ▲ | 3.1657.xxx | S3.5 | ✓ | 5.0 | 26÷80 |
| | ● | 3.1654.xxx | S3.5 | | 4.5 | 25÷80 |
| | ▲ | 3.2106.002 | S3.5 | | | |
| | ◆ | 3.2104.1xx | S3.5 | ✓ | | 0÷15 |

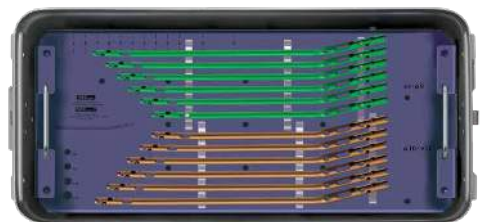

Stand for tibial nails CHARFIX/CHARFIX2 (implants not included)
Stawy do gwóździ piszczelowych CHARFIX/CHARFIX2 (bez implantów)

40.5750.000

CHARFIX DISTAL SCREW 4.5 CHARFIX WKRĘT BLOKUJĄCY 4,5



| S3.5 | |
|------|------------|
| Len | TiA |
| 25 | 3.1654.025 |
| 30 | 3.1654.030 |
| 35 | 3.1654.035 |
| 40 | 3.1654.040 |
| 45 | 3.1654.045 |
| 50 | 3.1654.050 |
| 55 | 3.1654.055 |
| 60 | 3.1654.060 |
| 65 | 3.1654.065 |
| 70 | 3.1654.070 |
| 75 | 3.1654.075 |
| 80 | 3.1654.080 |

St

CHARFIX DISTAL SCREW 5.0 CHARFIX WKRĘT BLOKUJĄCY 5,0



| S3.5 | |
|------|------------|
| Len | TiA |
| 30 | 3.1657.030 |
| 35 | 3.1657.035 |
| 40 | 3.1657.040 |
| 45 | 3.1657.045 |
| 50 | 3.1657.050 |
| 55 | 3.1657.055 |
| 60 | 3.1657.060 |
| 65 | 3.1657.065 |
| 70 | 3.1657.070 |
| 75 | 3.1657.075 |
| 80 | 3.1657.080 |

St


CHARFIX COMPRESSION SCREW M8X1.25 CHARFIX ŚRUBA KOMPRESYJNA M8X1,25



| S3.5 | |
|------------|-----|
| Len | TiA |
| 3.2106.002 | |

St

CHARFIX END CAP M8 CHARFIX ŚRUBA ZAŚLEPIAJĄCA M8



| S3.5 | |
|------|------------|
| A | TiA |
| 0 | 3.2104.100 |
| +5 | 3.2104.105 |
| +10 | 3.2104.110 |
| +15 | 3.2104.115 |

St



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5180.180S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5180.180S




For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



Stand for CHARFIX nail locking elements
(set with a box without implants)
Stawy na elementy blokujące gwoździe CHARFIX
(komplet z puszką bez implantów)

40.4686.200

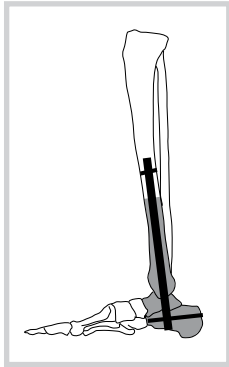

| | | Len | | | | | |
|----|-----|-----|------------|--|--|--|------------|
| 10 | 160 | | 3.2492.160 | | | | 3.2482.160 |
| | 180 | | 3.2492.180 | | | | 3.2482.180 |
| | 200 | | 3.2492.200 | | | | 3.2482.200 |
| | 220 | | 3.2492.220 | | | | 3.2482.220 |
| | 240 | | 3.2492.240 | | | | 3.2482.240 |
| | 260 | | 3.2492.260 | | | | 3.2482.260 |
| | 280 | | 3.2492.280 | | | | 3.2482.280 |
| | 300 | | 3.2492.300 | | | | 3.2482.300 |
| 11 | 160 | | 3.2493.160 | | | | 3.2483.160 |
| | 180 | | 3.2493.180 | | | | 3.2483.180 |
| | 200 | | 3.2493.200 | | | | 3.2483.200 |
| | 220 | | 3.2493.220 | | | | 3.2483.220 |
| | 240 | | 3.2493.240 | | | | 3.2483.240 |
| | 260 | | 3.2493.260 | | | | 3.2483.260 |
| | 280 | | 3.2493.280 | | | | 3.2483.280 |
| | 300 | | 3.2493.300 | | | | 3.2483.300 |
| 12 | 160 | | 3.2494.160 | | | | 3.2484.160 |
| | 180 | | 3.2494.180 | | | | 3.2484.180 |
| | 200 | | 3.2494.200 | | | | 3.2484.200 |
| | 220 | | 3.2494.220 | | | | 3.2484.220 |
| | 240 | | 3.2494.240 | | | | 3.2484.240 |
| | 260 | | 3.2494.260 | | | | 3.2484.260 |
| | 280 | | 3.2494.280 | | | | 3.2484.280 |
| | 300 | | 3.2494.300 | | | | 3.2484.300 |



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5180.180S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5180.180S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-27 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **40.5000.100, 40.5000.500, 40.5000.600** *
Stosować z instrumentarium **40.5000.100, 40.5000.500, 40.5000.600** *

| | 3.1654.xxx | S3.5 | | | 4.5 | 25÷100 |
|--|------------|------|--|---|-----|--------|
| | 3.2104.003 | S3.5 | | ✓ | | |

* Use with instrument set **40.5000.600**, with targeter B-D **40.5372**, lateral targeter **40.5378**, or with instrument set **40.5000.100/40.5000.500**, with angular targeter 90° **40.5007.000** – left, **40.5007.100** – right, connecting screw M8x1,25 **40.5008**, targeter D **40.5010**.


Stosować z instrumentarium **40.5000.600**, z celownikiem B-D **40.5372**, celownikiem bocznym **40.5378**, lub z instrumentarium **40.5000.100/40.5000.500**, z celownikiem kątowym 90° **40.5007.000** - lewym, **40.5007.100** - prawym, śrubą łączącą M8x1,25 **40.5008**, celownikiem D **40.5010**.

CHARFIX DISTAL SCREW 4.5
CHARFIX WKRĘT BLOKUJĄCY 4,5



| Len | S3.5 | TiA |
|-----|------|-----|
| 25 | | |
| 30 | | |
| 35 | | |
| 40 | | |
| 45 | | |
| 50 | | |
| 55 | | |
| 60 | | |
| 65 | | |
| 70 | | |
| 75 | | |
| 80 | | |
| 85 | | |
| 90 | | |
| 95 | | |
| 100 | | |

CHFND END CAP M8X1.25
CHFND ŚRUBA ZAŚLEPIAJĄCA M8X1,25



| A | S3.5 | TiA |
|----|------|-----|
| +3 | | |



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5180.180S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5180.180S




For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



Stand for CHARFIX nail locking elements
(set with a box without implants)
Stawy na elementy blokujące gwoździe CHARFIX
(komplet z puszką bez implantów)

40.4686.200

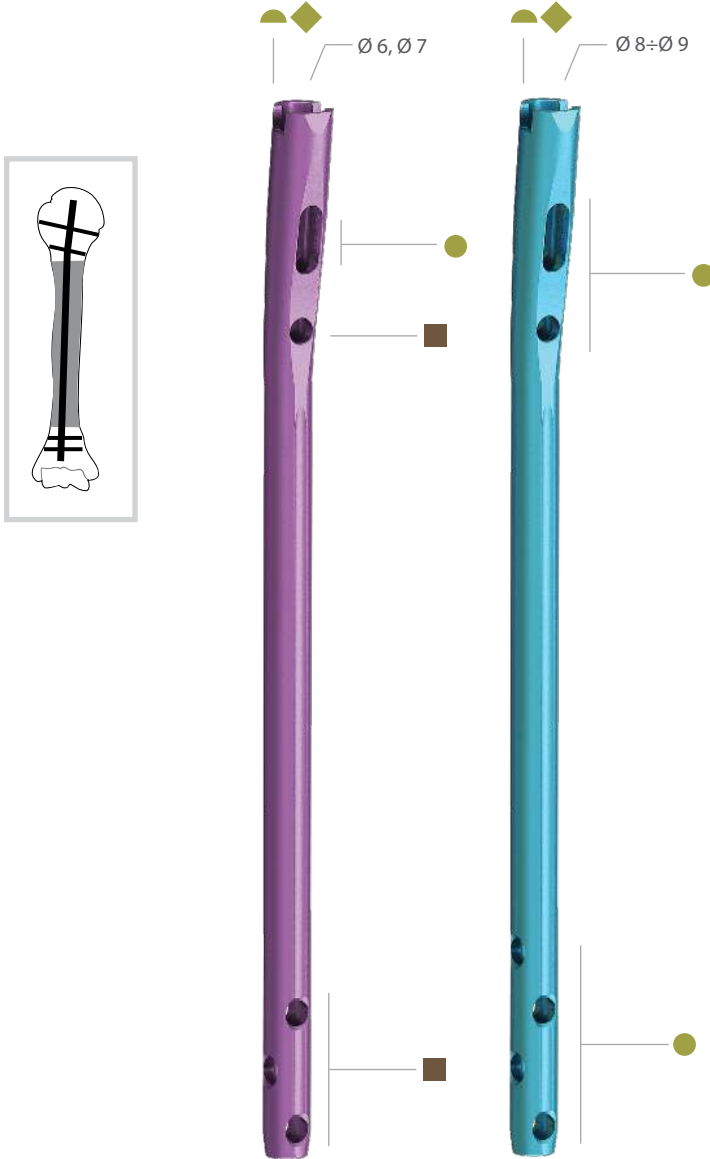

| | Len | L R | L R |
|---|-----|------------|------------|
| 6 | 180 | 3.2383.180 | 3.2099.180 |
| | 200 | 3.2383.200 | 3.2099.200 |
| | 220 | 3.2383.220 | 3.2099.220 |
| | 240 | 3.2383.240 | 3.2099.240 |
| | 260 | 3.2383.260 | 3.2099.260 |
| | 280 | 3.2383.280 | 3.2099.280 |
| 7 | 180 | 3.2384.180 | 3.2100.180 |
| | 200 | 3.2384.200 | 3.2100.200 |
| | 220 | 3.2384.220 | 3.2100.220 |
| | 240 | 3.2384.240 | 3.2100.240 |
| | 260 | 3.2384.260 | 3.2100.260 |
| | 280 | 3.2384.280 | 3.2100.280 |
| 8 | 180 | 3.2095.180 | 3.2097.180 |
| | 200 | 3.2095.200 | 3.2097.200 |
| | 220 | 3.2095.220 | 3.2097.220 |
| | 240 | 3.2095.240 | 3.2097.240 |
| | 260 | 3.2095.260 | 3.2097.260 |
| | 280 | 3.2095.280 | 3.2097.280 |
| 9 | 180 | 3.2096.180 | 3.2098.180 |
| | 200 | 3.2096.200 | 3.2098.200 |
| | 220 | 3.2096.220 | 3.2098.220 |
| | 240 | 3.2096.240 | 3.2098.240 |
| | 260 | 3.2096.260 | 3.2098.260 |
| | 280 | 3.2096.280 | 3.2098.280 |

Ster Non Ster The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5180.180S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5180.180S

i For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży

ST-04 See surgical technique
Patrz technika operacyjna

Use with instrument set no. 40.5020.500
Stosować z instrumentarium 40.5020.500

| | TiA | S3.5 | 4.5 | 25÷80 |
|--|------------|------|-----|-------|
| | 3.1654.xxx | S3.5 | 4.5 | 25÷80 |
| | 3.1655.xxx | S3.5 | 3.5 | 20÷50 |
| | 3.2106.004 | S3.5 | | |
| | 3.2104.5xx | S3.5 | ✓ | 0÷5 |

St



Stand for humeral nails (implants not included)
Statyw na gwoździe ramienne (bez implantów)

40.5751.000

CHARFIX DISTAL SCREW 3.5 CHARFIX WKRĘT BLOKUJĄCY 3,5



| Len | S3.5 | TiA |
|-----|------|-----|
| 20 | | |
| 25 | | |
| 30 | | |
| 35 | | |
| 40 | | |
| 45 | | |
| 50 | | |

St

CHARFIX DISTAL SCREW 4.5 CHARFIX WKRĘT BLOKUJĄCY 4,5



| Len | S3.5 | TiA |
|-----|------|-----|
| 25 | | |
| 30 | | |
| 35 | | |
| 40 | | |
| 45 | | |
| 50 | | |
| 55 | | |
| 60 | | |
| 65 | | |
| 70 | | |
| 80 | | |

St


CHARFIX COMPRESSION SCREW M7X1 CHARFIX ŚRUBA KOMPRESYJNA M7X1



| S3.5 | TiA |
|------------|-----|
| 3.2106.004 | |

St

CHARFIX END CAP M7 CHARFIX ŚRUBA ZAŚLEPIAJĄCA M7



| A | S3.5 | TiA |
|----|------|-----|
| 0 | | |
| +5 | | |

St



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5180.180S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5180.180S




For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



Stand for CHARFIX nail locking elements
(set with a box without implants)
Stawy na elementy blokujące gwoździe CHARFIX
(komplet z puszką bez implantów)

40.4686.200

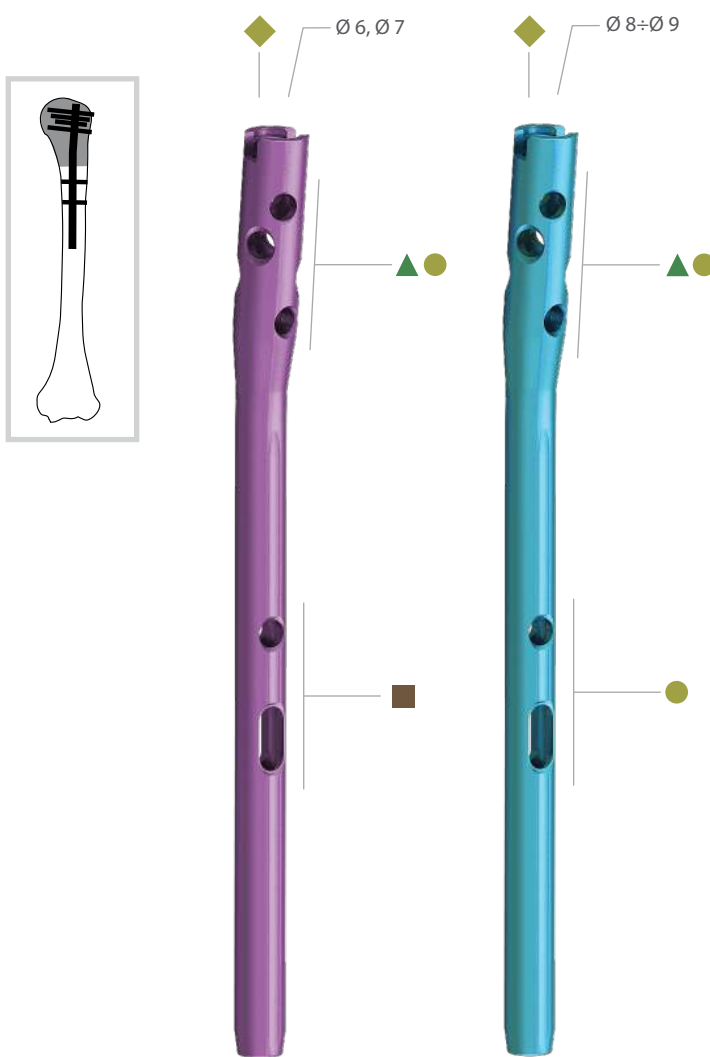

| | Len | |
|---|-----|------------|
| 7 | 150 | 3.2432.150 |
| | 180 | 3.2432.180 |
| 8 | 150 | 3.2434.150 |
| | 180 | 3.2434.180 |
| 9 | 150 | 3.2436.150 |
| | 180 | 3.2436.180 |

St

Ster
Non
Ster

The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5180.180S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufix "S", np. 3.5180.180S

i

For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży

ST-04

See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **40.5020.500**
Stosować z instrumentarium **40.5020.500**

| | TiA | | | | | |
|--|-----|------------|------|---|-----|-------|
| | ▲ | 3.1657.xxx | S3.5 | ✓ | 5.0 | 30÷70 |
| | ● | 3.1654.xxx | S3.5 | | 4.5 | 25÷80 |
| | ■ | 3.1655.xxx | S3.5 | | 3.5 | 20÷50 |
| | ◆ | 3.2104.2xx | S3.5 | ✓ | | 0÷5 |

St



Stand for humeral nails (implants not included)
Statyw na gwoździe ramienne (bez implantów)

40.5751.000



| | Len | |
|---|-----|------------|
| 6 | 200 | 3.2431.200 |
| | 220 | 3.2431.220 |
| | 240 | 3.2431.240 |
| | 260 | 3.2431.260 |
| | 280 | 3.2431.280 |
| | 300 | 3.2431.300 |
| 7 | 320 | 3.2431.320 |
| | 200 | 3.2433.200 |
| | 220 | 3.2433.220 |
| | 240 | 3.2433.240 |
| | 260 | 3.2433.260 |
| | 280 | 3.2433.280 |
| 8 | 300 | 3.2433.300 |
| | 320 | 3.2433.320 |
| | 200 | 3.2435.200 |
| | 220 | 3.2435.220 |
| | 240 | 3.2435.240 |
| | 260 | 3.2435.260 |
| 9 | 280 | 3.2435.280 |
| | 300 | 3.2435.300 |
| | 320 | 3.2435.320 |
| | 200 | 3.2437.200 |
| | 220 | 3.2437.220 |
| | 240 | 3.2437.240 |
| | 260 | 3.2437.260 |
| | 280 | 3.2437.280 |
| | 300 | 3.2437.300 |
| | 320 | 3.2437.320 |

St

Ster
Non
Ster

The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5180.180S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5180.180S

i

For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży

ST-04

See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **40.5020.500**
Stosować z instrumentarium **40.5020.500**

| | TiA | | | | |
|--|-----|------------|------|---|-----------|
| | ▲ | 3.1657.xxx | S3.5 | ✓ | 5.0 30÷70 |
| | ● | 3.1654.xxx | S3.5 | | 4.5 25÷80 |
| | ■ | 3.1655.xxx | S3.5 | | 3.5 20÷50 |
| | ◆ | 3.2104.2xx | S3.5 | ✓ | 0÷5 |

St



Stand for humeral nails (implants not included)
Statyw na gwoździe ramienne (bez implantów)

40.5751.000

CHARFIX DISTAL SCREW 3.5 CHARFIX WKREŃT BLOKUJĄCY 3,5



| Len | S3.5 TiA |
|-----|-------------|
| 20 | 3.1655.020 |
| 25 | 3.1655.025 |
| 30 | 3.1655.030 |
| 35 | 3.1655.035 |
| 40 | 3.1655.040 |
| 45 | 3.1655.045 |
| 50 | 3.1655.050 |

St

CHARFIX DISTAL SCREW 4.5 CHARFIX WKREŃT BLOKUJĄCY 4,5



| Len | S3.5 TiA |
|-----|-------------|
| 25 | 3.1654.025 |
| 30 | 3.1654.030 |
| 35 | 3.1654.035 |
| 40 | 3.1654.040 |
| 45 | 3.1654.045 |
| 50 | 3.1654.050 |
| 55 | 3.1654.055 |
| 60 | 3.1654.060 |
| 65 | 3.1654.065 |
| 70 | 3.1654.070 |
| 80 | 3.1654.080 |

St


CHARFIX DISTAL SCREW 5.0 CHARFIX WKREŃT BLOKUJĄCY 5,0



| Len | S3.5 TiA |
|-----|-------------|
| 30 | 3.1657.030 |
| 35 | 3.1657.035 |
| 40 | 3.1657.040 |
| 45 | 3.1657.045 |
| 50 | 3.1657.050 |
| 55 | 3.1657.055 |
| 60 | 3.1657.060 |
| 65 | 3.1657.065 |
| 70 | 3.1657.070 |

St

CHARFIX END CAP M7 CHARFIX ŚRUBA ZAŚLEPIAJĄCA M7



| A | S3.5 TiA |
|----|-------------|
| 0 | 3.2104.200 |
| +5 | 3.2104.205 |

St



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5180.180S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufixs "S", np. 3.5180.180S





For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



Stand for CHARFIX nail locking elements
(set with a box without implants)
Stawy na elementy blokujące gwoździe CHARFIX
(komplet z puszką bez implantów)

40.4686.200

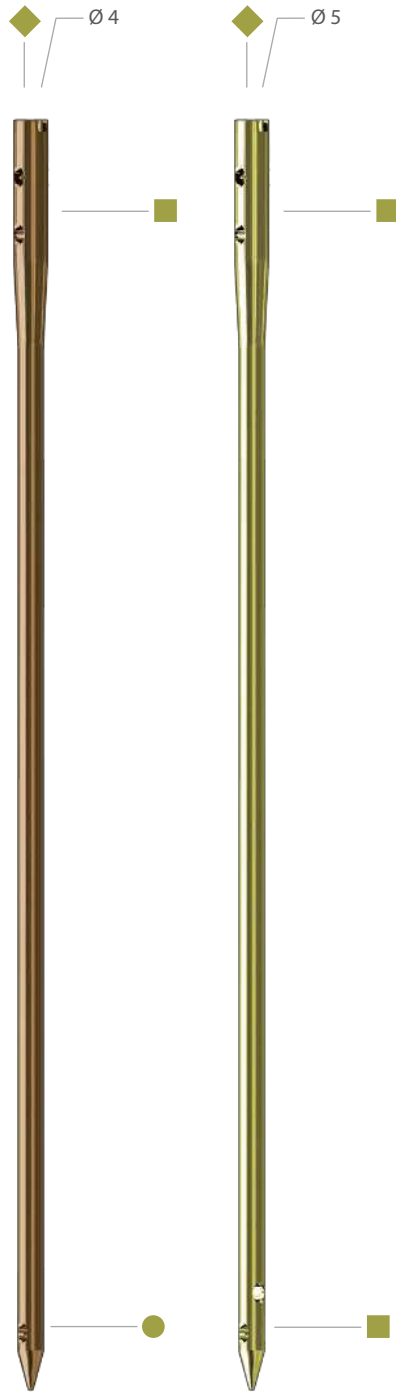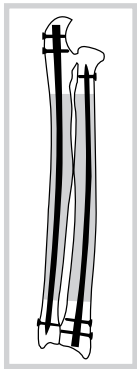

| | Len | TiA |
|---|-----|------------|
| 4 | 180 | 3.2102.180 |
| | 200 | 3.2102.200 |
| | 220 | 3.2102.220 |
| | 240 | 3.2102.240 |
| | 260 | 3.2102.260 |
| 5 | 180 | 3.2103.180 |
| | 200 | 3.2103.200 |
| | 220 | 3.2103.220 |
| | 240 | 3.2103.240 |
| | 260 | 3.2103.260 |



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5180.180S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5180.180S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży





ST-07 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **40.4580.500, 15.0417.100**
Stosować z instrumentarium **40.4580.500, 15.0417.100**

| | TiA | | | | |
|--|------------|------|---------|-------|--|
| | 3.1203.xxx | S2.5 | 2.7 | 16÷34 | |
| | 3.1022.xxx | S2.5 | 1.5/2.7 | 16÷26 | |
| | 3.2104.004 | S2.5 | | | |

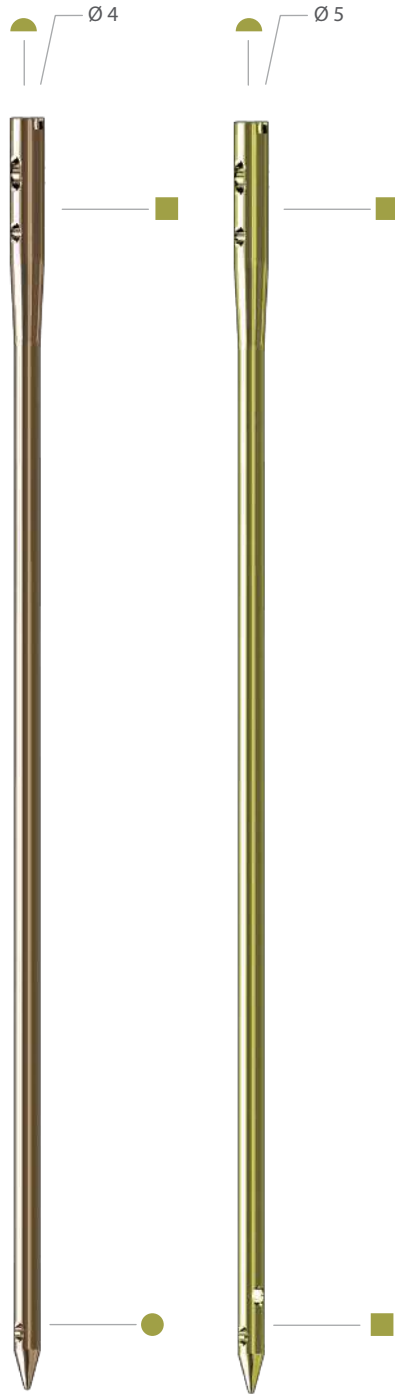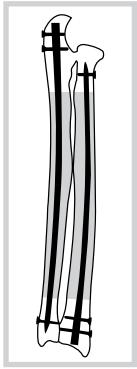

| | Len | TiA |
|---|-----|------------|
| 4 | 180 | 3.2360.180 |
| | 200 | 3.2360.200 |
| | 220 | 3.2360.220 |
| | 240 | 3.2360.240 |
| | 260 | 3.2360.260 |
| 5 | 180 | 3.2361.180 |
| | 200 | 3.2361.200 |
| | 220 | 3.2361.220 |
| | 240 | 3.2361.240 |
| | 260 | 3.2361.260 |



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5180.180S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5180.180S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-07 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **40.4580.500, 15.0417.100**
Stosować z instrumentarium **40.4580.500, 15.0417.100**

| | TiA | Hex | Thread | Length | Locking |
|--|------------|------|---------|--------|---------|
| | 3.1203.xxx | S2.5 | 2.7 | 16÷34 | |
| | 3.1022.xxx | S2.5 | 1.5/2.7 | 16÷26 | |
| | 3.2106.006 | S2.5 | | | |

CORTICAL SELF - TAPPING SCREW 2.7
WKRĘT KOROWY SAMOGWINTUJĄCY 2,7




| S2.5 | |
|------|------------|
| Len | TiA |
| 16 | 3.1203.016 |
| 18 | 3.1203.018 |
| 20 | 3.1203.020 |
| 22 | 3.1203.022 |
| 24 | 3.1203.024 |
| 26 | 3.1203.026 |
| 28 | 3.1203.028 |
| 30 | 3.1203.030 |
| 32 | 3.1203.032 |
| 34 | 3.1203.034 |

CORTEX SELF - TAPPING SCREW 1.5/2.7
WKRĘT KOROWY SAMOGWINTUJĄCY 1,5/2,7



| S2.5 | |
|------|------------|
| Len | TiA |
| 16 | 3.1022.016 |
| 18 | 3.1022.018 |
| 20 | 3.1022.020 |
| 22 | 3.1022.022 |
| 24 | 3.1022.024 |
| 26 | 3.1022.026 |

CHARFIX END CAP M4X0.7
CHARFIX ŚRUBA ZAŚLEPIAJĄCA M4X0,7



| A | TiA |
|------|------------|
| +2.5 | 3.2104.004 |

CHARFIX COMPRESSION SCREW M4
CHARFIX ŚRUBA KOMPRESYJNA M4



| S2.5 | |
|------|------------|
| TiA | |
| | 3.2106.006 |



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5180.180S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5180.180S




For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



Stand for forearm nails (set with container without implants)
Statyw do gwoździ przedramienia (komplet z puszką bez implantów)

40.8538.000

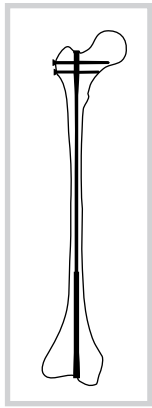

| | Len | St | L R |
|-----|------------|------------|-----|
| 3.5 | 180 | 1.2512.180 | |
| | 190 | 1.2512.190 | |
| | 200 | 1.2512.200 | |
| | 210 | 1.2512.210 | |
| | 220 | 1.2512.220 | |
| | 230 | 1.2512.230 | |
| | 240 | 1.2512.240 | |
| | 250 | 1.2512.250 | |
| | 260 | 1.2512.260 | |
| | 270 | 1.2512.270 | |
| | 280 | 1.2512.280 | |
| | 290 | 1.2512.290 | |
| 300 | 1.2512.300 | | |
| 4 | 180 | 1.2513.180 | |
| | 190 | 1.2513.190 | |
| | 200 | 1.2513.200 | |
| | 210 | 1.2513.210 | |
| | 220 | 1.2513.220 | |
| | 230 | 1.2513.230 | |
| | 240 | 1.2513.240 | |
| | 250 | 1.2513.250 | |
| | 260 | 1.2513.260 | |
| | 270 | 1.2513.270 | |
| | 280 | 1.2513.280 | |
| | 290 | 1.2513.290 | |
| 300 | 1.2513.300 | | |
| 4.5 | 180 | 1.2514.180 | |
| | 190 | 1.2514.190 | |
| | 200 | 1.2514.200 | |
| | 210 | 1.2514.210 | |
| | 220 | 1.2514.220 | |
| | 230 | 1.2514.230 | |
| | 240 | 1.2514.240 | |
| | 250 | 1.2514.250 | |
| | 260 | 1.2514.260 | |
| | 270 | 1.2514.270 | |
| | 280 | 1.2514.280 | |
| | 290 | 1.2514.290 | |
| 300 | 1.2514.300 | | |



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5180.180S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5180.180S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży




ST-17 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **40.5080.500 + 15.0417.100** or **40.4580.500**
Stosować z instrumentarium **40.5080.500 + 15.0417.100** lub **40.4580.500**

| | St | | | | |
|--|------------|------|-----|------|--|
| | 1.1203.xxx | S2.5 | 2.7 | 6÷45 | |
| | 1.2104.004 | S2.5 | | | |

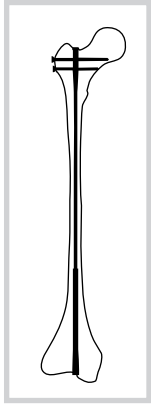

| | Len | St | L R |
|-----|-----|----|-------|
| 3.5 | 120 | | |
| | 125 | | |
| | 130 | | |
| | 135 | | |
| | 140 | | |
| | 145 | | |
| 4 | 150 | | |
| | 120 | | |
| | 125 | | |
| | 130 | | |
| | 135 | | |
| | 140 | | |
| 4.5 | 145 | | |
| | 150 | | |
| | 120 | | |
| | 125 | | |
| | 130 | | |
| | 135 | | |



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5180.180S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5180.180S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży




ST-17 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **40.5080.500 + 15.0417.100** or **40.4580.500**
Stosować z instrumentarium **40.5080.500 + 15.0417.100** lub **40.4580.500**

| | St | | | | |
|------------|----|------|--|--|--|
| 1.2530.000 | | S2.5 | | | |

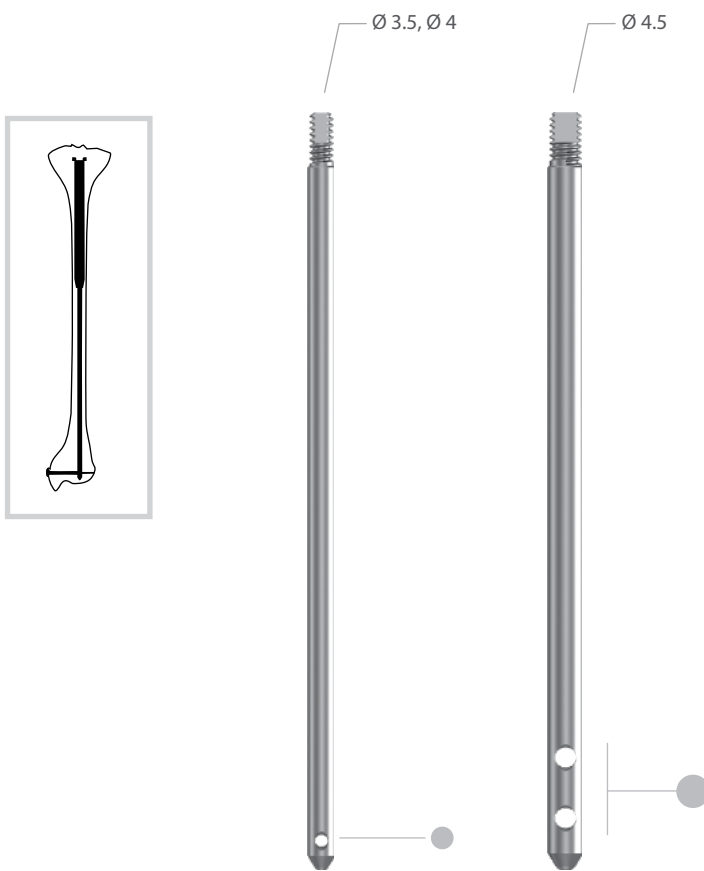

| | Len | St |
|-----|------------|------------|
| 3.5 | 180 | 1.2533.180 |
| | 190 | 1.2533.190 |
| | 200 | 1.2533.200 |
| | 210 | 1.2533.210 |
| | 220 | 1.2533.220 |
| | 230 | 1.2533.230 |
| | 240 | 1.2533.240 |
| | 250 | 1.2533.250 |
| | 260 | 1.2533.260 |
| | 270 | 1.2533.270 |
| | 280 | 1.2533.280 |
| | 290 | 1.2533.290 |
| 300 | 1.2533.300 | |
| 4 | 180 | 1.2534.180 |
| | 190 | 1.2534.190 |
| | 200 | 1.2534.200 |
| | 210 | 1.2534.210 |
| | 220 | 1.2534.220 |
| | 230 | 1.2534.230 |
| | 240 | 1.2534.240 |
| | 250 | 1.2534.250 |
| | 260 | 1.2534.260 |
| | 270 | 1.2534.270 |
| | 280 | 1.2534.280 |
| | 290 | 1.2534.290 |
| 300 | 1.2534.300 | |
| 4.5 | 180 | 1.2535.180 |
| | 190 | 1.2535.190 |
| | 200 | 1.2535.200 |
| | 210 | 1.2535.210 |
| | 220 | 1.2535.220 |
| | 230 | 1.2535.230 |
| | 240 | 1.2535.240 |
| | 250 | 1.2535.250 |
| | 260 | 1.2535.260 |
| | 270 | 1.2535.270 |
| | 280 | 1.2535.280 |
| | 290 | 1.2535.290 |
| 300 | 1.2535.300 | |



Use with instrument set no. **40.5080.500 + 15.0417.100** or **40.4580.500**
Stosować z instrumentarium **40.5080.500 + 15.0417.100** lub **40.4580.500**

| | St | | | | |
|--|------------|------|---------|-------|--|
| | 1.1022.xxx | S2.5 | 1.5/2.7 | 10÷70 | |
| | 1.1203.xxx | S2.5 | 2.7 | 6÷45 | |



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5180.180S



Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5180.180S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-17 See surgical technique
Patrz technika operacyjna

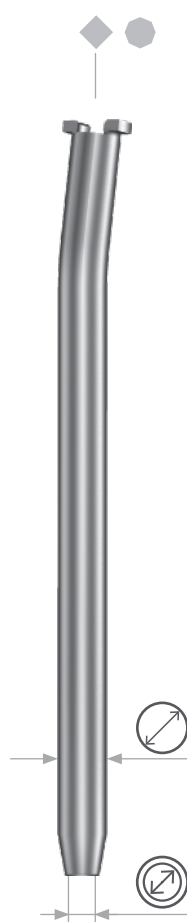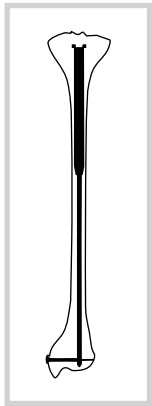

| | | | St |
|-----|-----|-----|------------|
| | | Len | L R |
| 6.5 | 3.5 | 80 | 1.2543.080 |
| | | 90 | 1.2543.090 |
| | | 100 | 1.2543.100 |
| | | 110 | 1.2543.110 |
| | | 120 | 1.2543.120 |
| | | 130 | 1.2543.130 |
| | | 140 | 1.2543.140 |
| 7 | 4 | 150 | 1.2543.150 |
| | | 80 | 1.2544.080 |
| | | 90 | 1.2544.090 |
| | | 100 | 1.2544.100 |
| | | 110 | 1.2544.110 |
| | | 120 | 1.2544.120 |
| | | 130 | 1.2544.130 |
| 7.5 | 4.5 | 140 | 1.2544.140 |
| | | 150 | 1.2544.150 |
| | | 80 | 1.2545.080 |
| | | 90 | 1.2545.090 |
| | | 100 | 1.2545.100 |
| | | 110 | 1.2545.110 |
| | | 120 | 1.2545.120 |
| | | 130 | 1.2545.130 |
| | | 140 | 1.2545.140 |
| | | 150 | 1.2545.150 |



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5180.180S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5180.180S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-17 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **15.0417.000 + 40.5080.500**
Stosować z instrumentarium **15.0417.000 + 40.5080.500**

| | St | | |
|--|------------|------|--|
| | 1.2530.000 | S2.5 | |
| | 1.2529.005 | S2.5 | |

CORTICAL SELF - TAPPING SCREW 2.7 WKRĘT KOROWY SAMOGWINTUJĄCY 2,7




| S2.5 | |
|------|------------|
| Len | St |
| 8 | 1.1203.008 |
| 10 | 1.1203.010 |
| 12 | 1.1203.012 |
| 14 | 1.1203.014 |
| 16 | 1.1203.016 |
| 18 | 1.1203.018 |
| 20 | 1.1203.020 |
| 22 | 1.1203.022 |
| 24 | 1.1203.024 |
| 26 | 1.1203.026 |
| 28 | 1.1203.028 |
| 30 | 1.1203.030 |
| 32 | 1.1203.032 |
| 34 | 1.1203.034 |
| 36 | 1.1203.036 |
| 38 | 1.1203.038 |
| 40 | 1.1203.040 |
| 45 | 1.1203.045 |

CORTEX SELF-TAPPING SCREW 1.5/2.7 WKRĘT KOROWY SAMOGWIN. 1,5/2,7




| S2.5 | |
|------|------------|
| Len | St |
| 12 | 1.1022.012 |
| 14 | 1.1022.014 |
| 16 | 1.1022.016 |
| 18 | 1.1022.018 |
| 20 | 1.1022.020 |
| 22 | 1.1022.022 |
| 24 | 1.1022.024 |
| 26 | 1.1022.026 |
| 28 | 1.1022.028 |
| 30 | 1.1022.030 |

CHARFIX END CAP M4X0.7 CHARFIX ŚRUBA ZAŚLEPIAJĄCA M4X0,7



| S2.5 | |
|------|------------|
| Len | St |
| +2.5 | 1.2104.004 |

END CAP M5 ŚRUBA ZAŚLEPIAJĄCA M5



| S2.5 | |
|------|------------|
| A | St |
| +2.5 | 1.2530.000 |

LIMITER SCREW M5 ŚRUBA OGRANICZAJĄCA M5





| S2.5 | |
|------|------------|
| St | |
| | 1.2529.005 |



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5180.180S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5180.180S




For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



| | | DIN with nut DIN z nakrętką | DIN without nut DIN bez nakrętki | AO | Harris | Hudson | Stryker / Zimmer / Trinkle |
|------|-----|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| 6.0 | 390 | 40.5103.000 | 40.5103.100 | 40.5103.200 | 40.5103.300 | 40.5103.400 | 40.5103.500 |
| 6.5 | 390 | 40.5104.000 | 40.5104.100 | 40.5104.200 | 40.5104.300 | 40.5104.400 | 40.5104.500 |
| 7.0 | 390 | 40.4541.000 | 40.4541.100 | 40.4541.200 | 40.4541.300 | 40.4541.400 | 40.4541.500 |
| 7.5 | 390 | 40.5105.000 | 40.5105.100 | 40.5105.200 | 40.5105.300 | 40.5105.400 | 40.5105.500 |
| 8.0 | 480 | 40.4542.000 | 40.4542.100 | 40.4542.200 | 40.4542.300 | 40.4542.400 | 40.4542.500 |
| 8.5 | 480 | 40.5106.000 | 40.5106.100 | 40.5106.200 | 40.5106.300 | 40.5106.400 | 40.5106.500 |
| 9.0 | 480 | 40.4543.000 | 40.4543.100 | 40.4543.200 | 40.4543.300 | 40.4543.400 | 40.4543.500 |
| 9.5 | 480 | 40.5107.000 | 40.5107.100 | 40.5107.200 | 40.5107.300 | 40.5107.400 | 40.5107.500 |
| 10.0 | 480 | 40.4544.000 | 40.4544.100 | 40.4544.200 | 40.4544.300 | 40.4544.400 | 40.4544.500 |
| 10.5 | 480 | 40.5108.000 | 40.5108.100 | 40.5108.200 | 40.5108.300 | 40.5108.400 | 40.5108.500 |
| 11.0 | 480 | 40.4545.000 | 40.4545.100 | 40.4545.200 | 40.4545.300 | 40.4545.400 | 40.4545.500 |
| 11.5 | 480 | 40.5109.000 | 40.5109.100 | 40.5109.200 | 40.5109.300 | 40.5109.400 | 40.5109.500 |
| 12.0 | 480 | 40.4546.000 | 40.4546.100 | 40.4546.200 | 40.4546.300 | 40.4546.400 | 40.4546.500 |
| 12.5 | 480 | 40.5110.000 | 40.5110.100 | 40.5110.200 | 40.5110.300 | 40.5110.400 | 40.5110.500 |
| 13.0 | 480 | 40.4547.000 | 40.4547.100 | 40.4547.200 | 40.4547.300 | 40.4547.400 | 40.4547.500 |
| 13.5 | 480 | 40.5111.000 | 40.5111.100 | 40.5111.200 | 40.5111.300 | 40.5111.400 | 40.5111.500 |
| 14.0 | 480 | 40.4548.000 | 40.4548.100 | 40.4548.200 | 40.4548.300 | 40.4548.400 | 40.4548.500 |
| 14.5 | 480 | 40.5112.000 | 40.5112.100 | 40.5112.200 | 40.5112.300 | 40.5112.400 | 40.5112.500 |
| 15.0 | 480 | 40.5113.000 | 40.5113.100 | 40.5113.200 | 40.5113.300 | 40.5113.400 | 40.5113.500 |
| 15.5 | 480 | 40.5114.000 | 40.5114.100 | 40.5114.200 | 40.5114.300 | 40.5114.400 | 40.5114.500 |
| 16.0 | 480 | 40.5115.000 | 40.5115.100 | 40.5115.200 | 40.5115.300 | 40.5115.400 | 40.5115.500 |
| 16.5 | 480 | 40.5116.000 | 40.5116.100 | 40.5116.200 | 40.5116.300 | 40.5116.400 | 40.5116.500 |
| 17.0 | 480 | 40.5117.000 | 40.5117.100 | 40.5117.200 | 40.5117.300 | 40.5117.400 | 40.5117.500 |
| 17.5 | 480 | 40.5118.000 | 40.5118.100 | 40.5118.200 | 40.5118.300 | 40.5118.400 | 40.5118.500 |
| 18.0 | 480 | 40.5119.000 | 40.5119.100 | 40.5119.200 | 40.5119.300 | 40.5119.400 | 40.5119.500 |

available connections
dostępne typy zamocowań

40.xxxx.000



DIN with coupling nut

40.xxxx.300



Harris

40.xxxx.100



DIN without coupling nut

40.xxxx.400



Hudson

40.xxxx.200



AO


40.xxxx.500



Stryker / Zimmer / Trinkle



leading
czołowy



| | | DIN | AO | Harris | Stryker/Zimmer/Trinkle |
|------|-----|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| 6.0 | 390 | 40.5103.110 | 40.5103.210 | 40.5103.310 | 40.5103.510 |
| 6.5 | 390 | 40.5104.110 | 40.5104.210 | 40.5104.310 | 40.5104.510 |
| 7.0 | 390 | 40.4541.110 | 40.4541.210 | 40.4541.310 | 40.4541.510 |
| 7.5 | 390 | 40.5105.110 | 40.5105.210 | 40.5105.310 | 40.5105.510 |
| 8.0 | 480 | 40.4542.110 | 40.4542.210 | 40.4542.310 | 40.4542.510 |
| 8.5 | 480 | 40.5106.110 | 40.5106.210 | 40.5106.310 | 40.5106.510 |
| 9.0 | 480 | 40.4543.110 | 40.4543.210 | 40.4543.310 | 40.4543.510 |
| 9.5 | 480 | 40.5107.110 | 40.5107.210 | 40.5107.310 | 40.5107.510 |
| 10.0 | 480 | 40.4544.110 | 40.4544.210 | 40.4544.310 | 40.4544.510 |
| 10.5 | 480 | 40.5108.110 | 40.5108.210 | 40.5108.310 | 40.5108.510 |
| 11.0 | 480 | 40.4545.110 | 40.4545.210 | 40.4545.310 | 40.4545.510 |
| 11.5 | 480 | 40.5109.110 | 40.5109.210 | 40.5109.310 | 40.5109.510 |
| 12.0 | 480 | 40.4546.110 | 40.4546.210 | 40.4546.310 | 40.4546.510 |
| 12.5 | 480 | 40.5110.110 | 40.5110.210 | 40.5110.310 | 40.5110.510 |
| 13.0 | 480 | 40.4547.110 | 40.4547.210 | 40.4547.310 | 40.4547.510 |
| 13.5 | 480 | 40.5111.110 | 40.5111.210 | 40.5111.310 | 40.5111.510 |
| 14.0 | 480 | 40.4548.110 | 40.4548.210 | 40.4548.310 | 40.4548.510 |
| 14.5 | 480 | 40.5112.110 | 40.5112.210 | 40.5112.310 | 40.5112.510 |
| 15.0 | 480 | 40.5113.110 | 40.5113.210 | 40.5113.310 | 40.5113.510 |
| 15.5 | 480 | 40.5114.110 | 40.5114.210 | 40.5114.310 | 40.5114.510 |
| 16.0 | 480 | 40.5115.110 | 40.5115.210 | 40.5115.310 | 40.5115.510 |
| 16.5 | 480 | 40.5116.110 | 40.5116.210 | 40.5116.310 | 40.5116.510 |
| 17.0 | 480 | 40.5117.110 | 40.5117.210 | 40.5117.310 | 40.5117.510 |
| 17.5 | 480 | 40.5118.110 | 40.5118.210 | 40.5118.310 | 40.5118.510 |
| 18.0 | 480 | 40.5119.110 | 40.5119.210 | 40.5119.310 | 40.5119.510 |

available connections
dostępne typy zamocowań

40.xxxx.110



DIN

40.xxxx.210



AO

40.xxxx.310



Harris

40.xxxx.510



Stryker/Zimmer/Trinkle

Reamer diameter 6-7.5mm
Średnica rozwiertaka 6-7,5mm



The maximum torque is 3Nm
Maksymalny moment obrotowy wynosi 3Nm


Reamer diameter 8-18mm
Średnica rozwiertaka 8-18mm

The maximum torque is 10Nm
Maksymalny moment obrotowy wynosi 10Nm

GUIDE ROD DRUT PROWADZĄCY





|  |  | D | |
|---|---|---|-------------|
| 1.8 | 600 | 4 | 40.4749.600 |
| 2.5 | 500 | 5 | 40.4747.500 |
| 3.0 | 700 | 5 | 40.3929.000 |
| 2.5 | 1000 | 4 | 40.1350.000 |
| 3.0 | 1000 | 4 | 40.3924.001 |
| 3.0 | 1000 | 5 | 40.3929.001 |



|  |  | D | |
|--|--|---|-------------|
| 3.0 | 1000 | 5 | 40.3930.000 |



|  |  | |
|---|---|-------------|
| 3.0 | 600 | 40.3925.000 |
| 3.5 | 600 | 40.3926.000 |
| 4.0 | 600 | 40.3927.000 |
| 5.0 | 600 | 40.3928.000 |



Protective guide
Prowadnica ochronna 40.6375.000



Hand
Pokrętło 40.3232.000



Stand for reamers (set with container)
Statyw na rozwiertaki (komplet z kontenerem) 40.5762.200


Stand insert for reamers (internal tray only)
Wkładka statywu na rozwiertaki (tylko taca wewnętrzna) 40.5762.300



**Reamer
Rozwiertak**

| Ø | Part No. | Ø | Part No. | Ø | Part No. |
|------|-------------|------|-------------|------|-------------|
| 8.0 | 40.8834.000 | 11.5 | 40.8841.000 | 15.0 | 40.8848.000 |
| 8.5 | 40.8835.000 | 12.0 | 40.8842.000 | 15.5 | 40.8849.000 |
| 9.0 | 40.8836.000 | 12.5 | 40.8843.000 | 16.0 | 40.8850.000 |
| 9.5 | 40.8837.000 | 13.0 | 40.8844.000 | 16.5 | 40.8851.000 |
| 10.0 | 40.8838.000 | 13.5 | 40.8845.000 | 17.0 | 40.8852.000 |
| 10.5 | 40.8839.000 | 14.0 | 40.8846.000 | 17.5 | 40.8853.000 |
| 11.0 | 40.8840.000 | 14.5 | 40.8847.000 | 18.0 | 40.8854.000 |

**Reamer handle
Uchwyt rozwiertaka**



available connections
dostępne typy zamocowań

DIN


AO

Harris

Stryker/Zimmer/Trinkle

| Len | Part No. | Part No. | Part No. | Part No. |
|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 480 | 40.8833.100 | 40.8833.200 | 40.8833.300 | 40.8833.500 |

**Drut prowadzący
Guide rod**

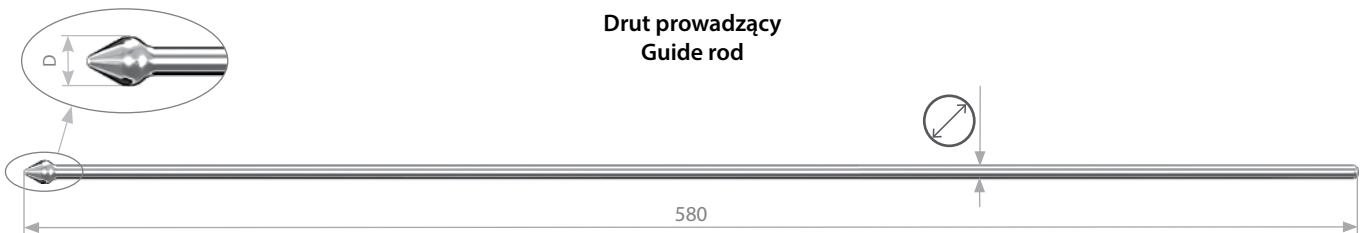


| Ø | Len | D | Part No. |
|-----|-----|-----|-------------|
| 3.0 | 580 | 5.0 | 40.3929.580 |
| 1.8 | 580 | 4.0 | 40.4749.580 |



Stand for reamers (set with container)
Statyw na rozwiertaki (komplet z kontenerem)

40.8832.000

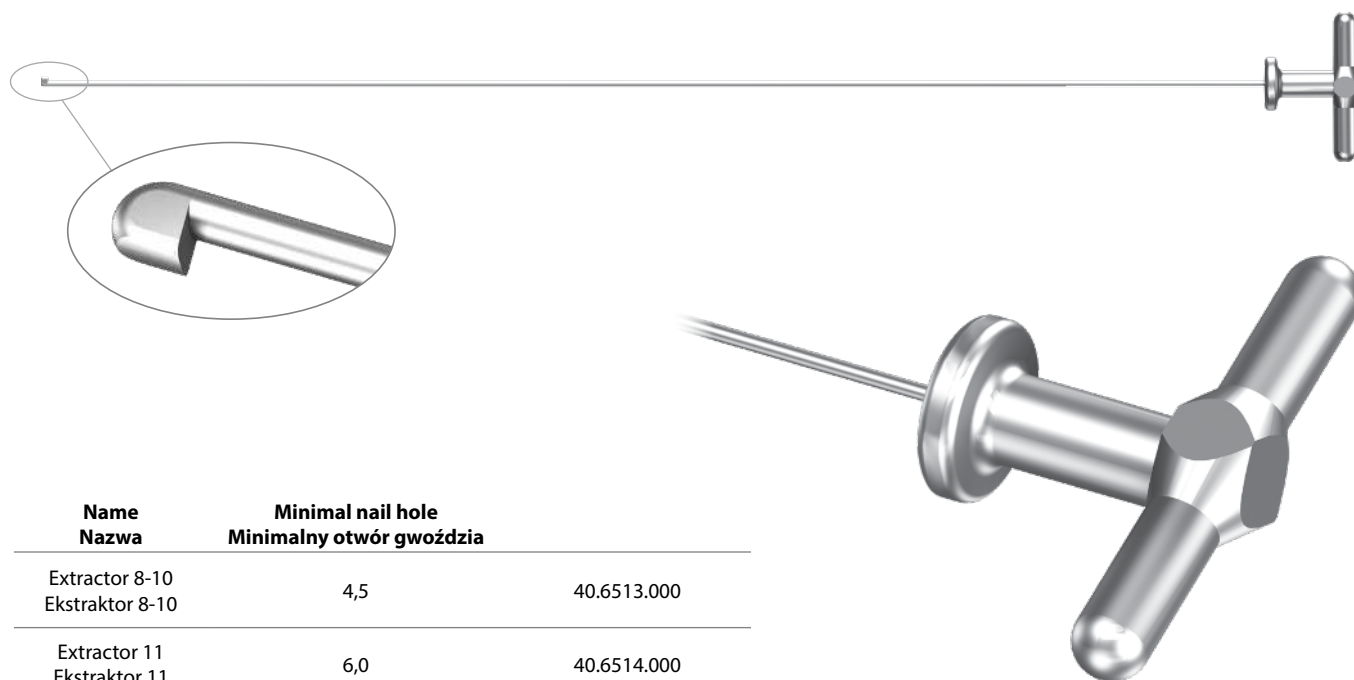

| Name Nazwa | Minimal nail hole Minimalny otwór gwoździa | |
|-----------------------------------|---|-------------|
| Extractor 8-10 Ekstraktor 8-10 | 4,5 | 40.6513.000 |
| Extractor 11 Ekstraktor 11 | 6,0 | 40.6514.000 |

| Catalogue no. Nr katalogowy | Page Strona | Catalogue no. Nr katalogowy | Page Strona | Catalogue no. Nr katalogowy | Page Strona | Catalogue no. Nr katalogowy | Page Strona |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1.1022.012 | 54 | 1.2522.130 | 51 | 1.2544.100 | 53 | 3.1654.090 | 34, 41 |
| 1.1022.014 | 54 | 1.2522.135 | 51 | 1.2544.110 | 53 | 3.1654.100 | 41 |
| 1.1022.016 | 54 | 1.2522.140 | 51 | 1.2544.120 | 53 | 3.1655.020 | 43, 46 |
| 1.1022.018 | 54 | 1.2522.145 | 51 | 1.2544.130 | 53 | 3.1655.025 | 43, 46 |
| 1.1022.020 | 54 | 1.2522.150 | 51 | 1.2544.140 | 53 | 3.1655.030 | 43, 46 |
| 1.1022.022 | 54 | 1.2523.120 | 51 | 1.2544.150 | 53 | 3.1655.035 | 43, 46 |
| 1.1022.024 | 54 | 1.2523.125 | 51 | 1.2545.080 | 53 | 3.1655.040 | 43, 46 |
| 1.1022.026 | 54 | 1.2523.130 | 51 | 1.2545.090 | 53 | 3.1655.045 | 43, 46 |
| 1.1022.028 | 54 | 1.2523.135 | 51 | 1.2545.100 | 53 | 3.1655.050 | 43, 46 |
| 1.1022.030 | 54 | 1.2523.140 | 51 | 1.2545.110 | 53 | 3.1657.026 | 39 |
| 1.1203.008 | 54 | 1.2523.145 | 51 | 1.2545.120 | 53 | 3.1657.030 | 37, 39, 46 |
| 1.1203.010 | 54 | 1.2523.150 | 51 | 1.2545.130 | 53 | 3.1657.035 | 37, 39, 46 |
| 1.1203.012 | 54 | 1.2524.120 | 51 | 1.2545.140 | 53 | 3.1657.040 | 37, 39, 46 |
| 1.1203.014 | 54 | 1.2524.125 | 51 | 1.2545.150 | 53 | 3.1657.045 | 37, 39, 46 |
| 1.1203.016 | 54 | 1.2524.130 | 51 | 3.1022.016 | 49 | 3.1657.050 | 37, 39, 46 |
| 1.1203.018 | 54 | 1.2524.135 | 51 | 3.1022.018 | 49 | 3.1657.055 | 37, 39, 46 |
| 1.1203.020 | 54 | 1.2524.140 | 51 | 3.1022.020 | 49 | 3.1657.060 | 37, 39, 46 |
| 1.1203.022 | 54 | 1.2524.145 | 51 | 3.1022.022 | 49 | 3.1657.065 | 37, 39, 46 |
| 1.1203.024 | 54 | 1.2524.150 | 51 | 3.1022.024 | 49 | 3.1657.070 | 37, 39, 46 |
| 1.1203.026 | 54 | 1.2529.005 | 54 | 3.1022.026 | 49 | 3.1657.075 | 37, 39 |
| 1.1203.028 | 54 | 1.2530.000 | 54 | 3.1203.016 | 49 | 3.1657.080 | 37, 39 |
| 1.1203.030 | 54 | 1.2533.180 | 52 | 3.1203.018 | 49 | 3.1935.070 | 37 |
| 1.1203.032 | 54 | 1.2533.190 | 52 | 3.1203.020 | 49 | 3.1935.075 | 37 |
| 1.1203.034 | 54 | 1.2533.200 | 52 | 3.1203.022 | 49 | 3.1935.080 | 37 |
| 1.1203.036 | 54 | 1.2533.210 | 52 | 3.1203.024 | 49 | 3.1935.085 | 37 |
| 1.1203.038 | 54 | 1.2533.220 | 52 | 3.1203.026 | 49 | 3.1935.090 | 37 |
| 1.1203.040 | 54 | 1.2533.230 | 52 | 3.1203.028 | 49 | 3.1935.095 | 37 |
| 1.1203.045 | 54 | 1.2533.240 | 52 | 3.1203.030 | 49 | 3.1935.100 | 37 |
| 1.2104.004 | 54 | 1.2533.250 | 52 | 3.1203.032 | 49 | 3.1935.105 | 37 |
| 1.2512.180 | 50 | 1.2533.260 | 52 | 3.1203.034 | 49 | 3.1935.110 | 37 |
| 1.2512.190 | 50 | 1.2533.270 | 52 | 3.1651.040 | 34 | 3.1935.115 | 37 |
| 1.2512.200 | 50 | 1.2533.280 | 52 | 3.1651.045 | 34 | 3.1935.120 | 37 |
| 1.2512.210 | 50 | 1.2533.290 | 52 | 3.1651.050 | 34 | 3.1938.070 | 37 |
| 1.2512.220 | 50 | 1.2533.300 | 52 | 3.1651.055 | 34 | 3.1938.075 | 37 |
| 1.2512.230 | 50 | 1.2534.180 | 52 | 3.1651.060 | 34 | 3.1938.080 | 37 |
| 1.2512.240 | 50 | 1.2534.190 | 52 | 3.1651.065 | 34 | 3.1938.085 | 37 |
| 1.2512.250 | 50 | 1.2534.200 | 52 | 3.1651.070 | 34 | 3.1938.090 | 37 |
| 1.2512.260 | 50 | 1.2534.210 | 52 | 3.1651.075 | 34 | 3.1938.095 | 37 |
| 1.2512.270 | 50 | 1.2534.220 | 52 | 3.1651.080 | 34 | 3.1938.100 | 37 |
| 1.2512.280 | 50 | 1.2534.230 | 52 | 3.1651.085 | 34 | 3.1938.105 | 37 |
| 1.2512.290 | 50 | 1.2534.240 | 52 | 3.1651.090 | 34 | 3.1938.110 | 37 |
| 1.2512.300 | 50 | 1.2534.250 | 52 | 3.1651.100 | 34 | 3.1938.115 | 37 |
| 1.2513.180 | 50 | 1.2534.260 | 52 | 3.1651.105 | 34 | 3.1938.120 | 37 |
| 1.2513.190 | 50 | 1.2534.270 | 52 | 3.1651.110 | 34 | 3.2095.180 | 42 |
| 1.2513.200 | 50 | 1.2534.280 | 52 | 3.1652.060 | 34 | 3.2095.200 | 42 |
| 1.2513.210 | 50 | 1.2534.290 | 52 | 3.1652.065 | 34 | 3.2095.220 | 42 |
| 1.2513.220 | 50 | 1.2534.300 | 52 | 3.1652.070 | 34 | 3.2095.240 | 42 |
| 1.2513.230 | 50 | 1.2535.180 | 52 | 3.1652.075 | 34 | 3.2095.260 | 42 |
| 1.2513.240 | 50 | 1.2535.190 | 52 | 3.1652.080 | 34 | 3.2095.280 | 42 |
| 1.2513.250 | 50 | 1.2535.200 | 52 | 3.1652.085 | 34 | 3.2095.300 | 42 |
| 1.2513.260 | 50 | 1.2535.210 | 52 | 3.1652.090 | 34 | 3.2095.320 | 42 |
| 1.2513.270 | 50 | 1.2535.220 | 52 | 3.1652.095 | 34 | 3.2096.180 | 42 |
| 1.2513.280 | 50 | 1.2535.230 | 52 | 3.1652.100 | 34 | 3.2096.200 | 42 |
| 1.2513.290 | 50 | 1.2535.240 | 52 | 3.1652.105 | 34 | 3.2096.220 | 42 |
| 1.2513.300 | 50 | 1.2535.250 | 52 | 3.1652.110 | 34 | 3.2096.240 | 42 |
| 1.2514.180 | 50 | 1.2535.260 | 52 | 3.1652.115 | 34 | 3.2096.260 | 42 |
| 1.2514.190 | 50 | 1.2535.270 | 52 | 3.1652.120 | 34 | 3.2096.280 | 42 |
| 1.2514.200 | 50 | 1.2535.280 | 52 | 3.1654.025 | 39, 41, 43, 46 | 3.2096.300 | 42 |
| 1.2514.210 | 50 | 1.2535.290 | 52 | 3.1654.030 | 34, 37, 39, 41, 43, 46 | 3.2096.320 | 42 |
| 1.2514.220 | 50 | 1.2535.300 | 52 | 3.1654.035 | 34, 37, 39, 41, 43, 46 | 3.2097.180 | 42 |
| 1.2514.230 | 50 | 1.2543.080 | 53 | 3.1654.040 | 34, 37, 39, 41, 43, 46 | 3.2097.200 | 42 |
| 1.2514.240 | 50 | 1.2543.090 | 53 | 3.1654.045 | 34, 37, 39, 41, 43, 46 | 3.2097.220 | 42 |
| 1.2514.250 | 50 | 1.2543.100 | 53 | 3.1654.050 | 34, 37, 39, 41, 43, 46 | 3.2097.240 | 42 |
| 1.2514.260 | 50 | 1.2543.110 | 53 | 3.1654.055 | 34, 37, 39, 41, 43, 46 | 3.2097.260 | 42 |
| 1.2514.270 | 50 | 1.2543.120 | 53 | 3.1654.060 | 34, 37, 39, 41, 43, 46 | 3.2097.280 | 42 |
| 1.2514.280 | 50 | 1.2543.130 | 53 | 3.1654.065 | 34, 37, 39, 41, 43, 46 | 3.2097.300 | 42 |
| 1.2514.290 | 50 | 1.2543.140 | 53 | 3.1654.070 | 34, 37, 39, 41, 43, 46 | 3.2097.320 | 42 |
| 1.2514.300 | 50 | 1.2543.150 | 53 | 3.1654.075 | 34, 37, 39, 41 | 3.2098.180 | 42 |
| 1.2522.120 | 51 | 1.2544.080 | 53 | 3.1654.080 | 34, 37, 39, 41, 43, 46 | 3.2098.200 | 42 |
| 1.2522.125 | 51 | 1.2544.090 | 53 | 3.1654.085 | 34, 41 | 3.2098.220 | 42 |

| Catalogue no. Nr katalogowy | Page Strona | Catalogue no. Nr katalogowy | Page Strona | Catalogue no. Nr katalogowy | Page Strona | Catalogue no. Nr katalogowy | Page Strona |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| 3.2098.240 | 42 | 3.2383.180 | 42 | 3.2484.300 | 40 | 3.2637.270 | 38 |
| 3.2098.260 | 42 | 3.2383.200 | 42 | 3.2492.160 | 40 | 3.2637.285 | 38 |
| 3.2098.280 | 42 | 3.2383.220 | 42 | 3.2492.180 | 40 | 3.2637.300 | 38 |
| 3.2098.300 | 42 | 3.2383.240 | 42 | 3.2492.200 | 40 | 3.2637.315 | 38 |
| 3.2098.320 | 42 | 3.2383.260 | 42 | 3.2492.220 | 40 | 3.2637.330 | 38 |
| 3.2099.180 | 42 | 3.2383.280 | 42 | 3.2492.240 | 40 | 3.2637.345 | 38 |
| 3.2099.200 | 42 | 3.2383.300 | 42 | 3.2492.260 | 40 | 3.2637.360 | 38 |
| 3.2099.220 | 42 | 3.2383.320 | 42 | 3.2492.280 | 40 | 3.2637.375 | 38 |
| 3.2099.240 | 42 | 3.2384.180 | 42 | 3.2492.300 | 40 | 3.2637.390 | 38 |
| 3.2099.260 | 42 | 3.2384.200 | 42 | 3.2493.160 | 40 | 3.2638.270 | 38 |
| 3.2099.280 | 42 | 3.2384.220 | 42 | 3.2493.180 | 40 | 3.2638.285 | 38 |
| 3.2099.300 | 42 | 3.2384.240 | 42 | 3.2493.200 | 40 | 3.2638.300 | 38 |
| 3.2099.320 | 42 | 3.2384.260 | 42 | 3.2493.220 | 40 | 3.2638.315 | 38 |
| 3.2100.180 | 42 | 3.2384.280 | 42 | 3.2493.240 | 40 | 3.2638.330 | 38 |
| 3.2100.200 | 42 | 3.2384.300 | 42 | 3.2493.260 | 40 | 3.2638.345 | 38 |
| 3.2100.220 | 42 | 3.2384.320 | 42 | 3.2493.280 | 40 | 3.2638.360 | 38 |
| 3.2100.240 | 42 | 3.2431.200 | 45 | 3.2493.300 | 40 | 3.2638.375 | 38 |
| 3.2100.260 | 42 | 3.2431.220 | 45 | 3.2494.160 | 40 | 3.2638.390 | 38 |
| 3.2100.280 | 42 | 3.2431.240 | 45 | 3.2494.180 | 40 | 3.2639.270 | 38 |
| 3.2100.300 | 42 | 3.2431.260 | 45 | 3.2494.200 | 40 | 3.2639.285 | 38 |
| 3.2100.320 | 42 | 3.2431.280 | 45 | 3.2494.220 | 40 | 3.2639.300 | 38 |
| 3.2102.180 | 47 | 3.2431.300 | 45 | 3.2494.240 | 40 | 3.2639.315 | 38 |
| 3.2102.200 | 47 | 3.2431.320 | 45 | 3.2494.260 | 40 | 3.2639.330 | 38 |
| 3.2102.220 | 47 | 3.2432.150 | 44 | 3.2494.280 | 40 | 3.2639.345 | 38 |
| 3.2102.240 | 47 | 3.2433.200 | 45 | 3.2494.300 | 40 | 3.2639.360 | 38 |
| 3.2102.260 | 47 | 3.2433.220 | 45 | 3.2623.270 | 38 | 3.2639.375 | 38 |
| 3.2103.180 | 47 | 3.2433.240 | 45 | 3.2623.285 | 38 | 3.2639.390 | 38 |
| 3.2103.200 | 47 | 3.2433.260 | 45 | 3.2623.300 | 38 | 3.2651.270 | 19 |
| 3.2103.220 | 47 | 3.2433.280 | 45 | 3.2623.315 | 38 | 3.2651.285 | 19 |
| 3.2103.240 | 47 | 3.2433.300 | 45 | 3.2623.330 | 38 | 3.2651.300 | 19 |
| 3.2103.260 | 47 | 3.2433.320 | 45 | 3.2623.345 | 38 | 3.2651.315 | 19 |
| 3.2104.002 | 34 | 3.2434.150 | 44 | 3.2623.360 | 38 | 3.2651.330 | 19 |
| 3.2104.003 | 37, 41 | 3.2435.200 | 45 | 3.2623.375 | 38 | 3.2651.345 | 19 |
| 3.2104.004 | 49 | 3.2435.220 | 45 | 3.2623.390 | 38 | 3.2651.360 | 19 |
| 3.2104.100 | 39 | 3.2435.240 | 45 | 3.2624.270 | 38 | 3.2651.375 | 19 |
| 3.2104.105 | 39 | 3.2435.260 | 45 | 3.2624.285 | 38 | 3.2651.390 | 19 |
| 3.2104.110 | 39 | 3.2435.280 | 45 | 3.2624.300 | 38 | 3.2652.270 | 19 |
| 3.2104.115 | 39 | 3.2435.300 | 45 | 3.2624.315 | 38 | 3.2652.285 | 19 |
| 3.2104.200 | 46 | 3.2435.320 | 45 | 3.2624.330 | 38 | 3.2652.300 | 19 |
| 3.2104.205 | 46 | 3.2436.150 | 44 | 3.2624.345 | 38 | 3.2652.315 | 19 |
| 3.2104.300 | 34 | 3.2437.200 | 45 | 3.2624.360 | 38 | 3.2652.330 | 19 |
| 3.2104.305 | 34 | 3.2437.220 | 45 | 3.2624.375 | 38 | 3.2652.345 | 19 |
| 3.2104.310 | 34 | 3.2437.240 | 45 | 3.2624.390 | 38 | 3.2652.360 | 19 |
| 3.2104.315 | 34 | 3.2437.260 | 45 | 3.2625.270 | 38 | 3.2652.375 | 19 |
| 3.2104.500 | 43 | 3.2437.280 | 45 | 3.2625.285 | 38 | 3.2652.390 | 19 |
| 3.2104.505 | 43 | 3.2437.300 | 45 | 3.2625.300 | 38 | 3.2653.270 | 19 |
| 3.2104.600 | 37 | 3.2437.320 | 45 | 3.2625.315 | 38 | 3.2653.285 | 19 |
| 3.2104.605 | 37 | 3.2482.160 | 40 | 3.2625.330 | 38 | 3.2653.300 | 19 |
| 3.2104.610 | 37 | 3.2482.180 | 40 | 3.2625.345 | 38 | 3.2653.315 | 19 |
| 3.2104.615 | 37 | 3.2482.200 | 40 | 3.2625.360 | 38 | 3.2653.330 | 19 |
| 3.2106.002 | 39 | 3.2482.220 | 40 | 3.2625.375 | 38 | 3.2653.345 | 19 |
| 3.2106.004 | 43 | 3.2482.240 | 40 | 3.2625.390 | 38 | 3.2653.360 | 19 |
| 3.2106.006 | 49 | 3.2482.260 | 40 | 3.2626.270 | 38 | 3.2653.375 | 19 |
| 3.2106.007 | 34 | 3.2482.280 | 40 | 3.2626.285 | 38 | 3.2653.390 | 19 |
| 3.2106.008 | 37 | 3.2482.300 | 40 | 3.2626.300 | 38 | 3.2654.270 | 19 |
| 3.2109.050 | 34 | 3.2483.160 | 40 | 3.2626.315 | 38 | 3.2654.285 | 19 |
| 3.2109.060 | 34 | 3.2483.180 | 40 | 3.2626.330 | 38 | 3.2654.300 | 19 |
| 3.2109.070 | 34 | 3.2483.200 | 40 | 3.2626.345 | 38 | 3.2654.315 | 19 |
| 3.2109.080 | 34 | 3.2483.220 | 40 | 3.2626.360 | 38 | 3.2654.330 | 19 |
| 3.2109.090 | 34 | 3.2483.240 | 40 | 3.2626.375 | 38 | 3.2654.345 | 19 |
| 3.2360.180 | 48 | 3.2483.260 | 40 | 3.2626.390 | 38 | 3.2654.360 | 19 |
| 3.2360.200 | 48 | 3.2483.280 | 40 | 3.2627.270 | 38 | 3.2654.375 | 19 |
| 3.2360.220 | 48 | 3.2483.300 | 40 | 3.2627.285 | 38 | 3.2654.390 | 19 |
| 3.2360.240 | 48 | 3.2484.160 | 40 | 3.2627.300 | 38 | 3.2655.270 | 19 |
| 3.2360.260 | 48 | 3.2484.180 | 40 | 3.2627.315 | 38 | 3.2655.285 | 19 |
| 3.2361.180 | 48 | 3.2484.200 | 40 | 3.2627.330 | 38 | 3.2655.300 | 19 |
| 3.2361.200 | 48 | 3.2484.220 | 40 | 3.2627.345 | 38 | 3.2655.315 | 19 |
| 3.2361.220 | 48 | 3.2484.240 | 40 | 3.2627.360 | 38 | 3.2655.330 | 19 |
| 3.2361.240 | 48 | 3.2484.260 | 40 | 3.2627.375 | 38 | 3.2655.345 | 19 |
| 3.2361.260 | 48 | 3.2484.280 | 40 | 3.2627.390 | 38 | 3.2655.360 | 19 |

| Catalogue no. Nr katalogowy | Page Strona | Catalogue no. Nr katalogowy | Page Strona | Catalogue no. Nr katalogowy | Page Strona | Catalogue no. Nr katalogowy | Page Strona |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| 3.2655.375 | 19 | 3.2856.460 | 33 | 3.2861.460 | 33 | 3.4929.380 | 36 |
| 3.2655.390 | 19 | 3.2857.200 | 33 | 3.2956.180 | 26 | 3.4929.400 | 36 |
| 3.2665.270 | 19 | 3.2857.220 | 33 | 3.2956.200 | 26 | 3.4929.420 | 36 |
| 3.2665.285 | 19 | 3.2857.240 | 33 | 3.2956.220 | 26 | 3.4930.340 | 36 |
| 3.2665.300 | 19 | 3.2857.260 | 33 | 3.2956.240 | 26 | 3.4930.360 | 36 |
| 3.2665.315 | 19 | 3.2857.280 | 33 | 3.2956.260 | 26 | 3.4930.380 | 36 |
| 3.2665.330 | 19 | 3.2857.300 | 33 | 3.2956.280 | 26 | 3.4930.400 | 36 |
| 3.2665.345 | 19 | 3.2857.320 | 33 | 3.2956.300 | 26 | 3.4930.420 | 36 |
| 3.2665.360 | 19 | 3.2857.340 | 33 | 3.2956.320 | 26 | 3.4931.340 | 36 |
| 3.2665.375 | 19 | 3.2857.360 | 33 | 3.2957.180 | 26 | 3.4931.360 | 36 |
| 3.2665.390 | 19 | 3.2857.380 | 33 | 3.2957.200 | 26 | 3.4931.380 | 36 |
| 3.2666.270 | 19 | 3.2857.400 | 33 | 3.2957.220 | 26 | 3.4931.400 | 36 |
| 3.2666.285 | 19 | 3.2857.420 | 33 | 3.2957.240 | 26 | 3.4931.420 | 36 |
| 3.2666.300 | 19 | 3.2857.440 | 33 | 3.2957.260 | 26 | 3.4950.340 | 36 |
| 3.2666.315 | 19 | 3.2857.460 | 33 | 3.2957.280 | 26 | 3.4950.360 | 36 |
| 3.2666.330 | 19 | 3.2858.200 | 33 | 3.2957.300 | 26 | 3.4950.380 | 36 |
| 3.2666.345 | 19 | 3.2858.220 | 33 | 3.2957.320 | 26 | 3.4950.400 | 36 |
| 3.2666.360 | 19 | 3.2858.240 | 33 | 3.2958.180 | 26 | 3.4950.420 | 36 |
| 3.2666.375 | 19 | 3.2858.260 | 33 | 3.2958.200 | 26 | 3.4951.340 | 36 |
| 3.2666.390 | 19 | 3.2858.280 | 33 | 3.2958.220 | 26 | 3.4951.360 | 36 |
| 3.2667.270 | 19 | 3.2858.300 | 33 | 3.2958.240 | 26 | 3.4951.380 | 36 |
| 3.2667.285 | 19 | 3.2858.320 | 33 | 3.2958.260 | 26 | 3.4951.400 | 36 |
| 3.2667.300 | 19 | 3.2858.340 | 33 | 3.2958.280 | 26 | 3.4951.420 | 36 |
| 3.2667.315 | 19 | 3.2858.360 | 33 | 3.2958.300 | 26 | 3.4952.340 | 36 |
| 3.2667.330 | 19 | 3.2858.380 | 33 | 3.2958.320 | 26 | 3.4952.360 | 36 |
| 3.2667.345 | 19 | 3.2858.400 | 33 | 3.2959.180 | 26 | 3.4952.380 | 36 |
| 3.2667.360 | 19 | 3.2858.420 | 33 | 3.2959.200 | 26 | 3.4952.400 | 36 |
| 3.2667.375 | 19 | 3.2858.440 | 33 | 3.2959.220 | 26 | 3.4952.420 | 36 |
| 3.2667.390 | 19 | 3.2858.460 | 33 | 3.2959.240 | 26 | 3.4953.340 | 36 |
| 3.2854.200 | 33 | 3.2859.200 | 33 | 3.2959.260 | 26 | 3.4953.360 | 36 |
| 3.2854.220 | 33 | 3.2859.220 | 33 | 3.2959.280 | 26 | 3.4953.380 | 36 |
| 3.2854.240 | 33 | 3.2859.240 | 33 | 3.2959.300 | 26 | 3.4953.400 | 36 |
| 3.2854.260 | 33 | 3.2859.260 | 33 | 3.2959.320 | 26 | 3.4953.420 | 36 |
| 3.2854.280 | 33 | 3.2859.280 | 33 | 3.2978.150 | 25 | 3.4954.340 | 36 |
| 3.2854.300 | 33 | 3.2859.300 | 33 | 3.2979.150 | 25 | 3.4954.360 | 36 |
| 3.2854.320 | 33 | 3.2859.320 | 33 | 3.4864.180 | 35 | 3.4954.380 | 36 |
| 3.2854.340 | 33 | 3.2859.340 | 33 | 3.4864.200 | 35 | 3.4954.400 | 36 |
| 3.2854.360 | 33 | 3.2859.360 | 33 | 3.4865.180 | 35 | 3.4954.420 | 36 |
| 3.2854.380 | 33 | 3.2859.380 | 33 | 3.4865.200 | 35 | 3.4955.340 | 36 |
| 3.2854.400 | 33 | 3.2859.400 | 33 | 3.4866.180 | 35 | 3.4955.360 | 36 |
| 3.2854.420 | 33 | 3.2859.420 | 33 | 3.4866.200 | 35 | 3.4955.380 | 36 |
| 3.2854.440 | 33 | 3.2859.440 | 33 | 3.4876.180 | 35 | 3.4955.400 | 36 |
| 3.2854.460 | 33 | 3.2859.460 | 33 | 3.4876.200 | 35 | 3.4955.420 | 36 |
| 3.2855.200 | 33 | 3.2860.200 | 33 | 3.4877.180 | 35 | 3.4974.340 | 36 |
| 3.2855.220 | 33 | 3.2860.220 | 33 | 3.4877.200 | 35 | 3.4974.360 | 36 |
| 3.2855.240 | 33 | 3.2860.240 | 33 | 3.4878.180 | 35 | 3.4974.380 | 36 |
| 3.2855.260 | 33 | 3.2860.260 | 33 | 3.4878.200 | 35 | 3.4974.400 | 36 |
| 3.2855.280 | 33 | 3.2860.280 | 33 | 3.4888.180 | 35 | 3.4974.420 | 36 |
| 3.2855.300 | 33 | 3.2860.300 | 33 | 3.4888.200 | 35 | 3.4975.340 | 36 |
| 3.2855.320 | 33 | 3.2860.320 | 33 | 3.4889.180 | 35 | 3.4975.360 | 36 |
| 3.2855.340 | 33 | 3.2860.340 | 33 | 3.4889.200 | 35 | 3.4975.380 | 36 |
| 3.2855.360 | 33 | 3.2860.360 | 33 | 3.4890.180 | 35 | 3.4975.400 | 36 |
| 3.2855.380 | 33 | 3.2860.380 | 33 | 3.4890.200 | 35 | 3.4975.420 | 36 |
| 3.2855.400 | 33 | 3.2860.400 | 33 | 3.4926.340 | 36 | 3.4976.340 | 36 |
| 3.2855.420 | 33 | 3.2860.420 | 33 | 3.4926.360 | 36 | 3.4976.360 | 36 |
| 3.2855.440 | 33 | 3.2860.440 | 33 | 3.4926.380 | 36 | 3.4976.380 | 36 |
| 3.2855.460 | 33 | 3.2860.460 | 33 | 3.4926.400 | 36 | 3.4976.400 | 36 |
| 3.2856.200 | 33 | 3.2861.200 | 33 | 3.4926.420 | 36 | 3.4976.420 | 36 |
| 3.2856.220 | 33 | 3.2861.220 | 33 | 3.4927.340 | 36 | 3.4977.340 | 36 |
| 3.2856.240 | 33 | 3.2861.240 | 33 | 3.4927.360 | 36 | 3.4977.360 | 36 |
| 3.2856.260 | 33 | 3.2861.260 | 33 | 3.4927.380 | 36 | 3.4977.380 | 36 |
| 3.2856.280 | 33 | 3.2861.280 | 33 | 3.4927.400 | 36 | 3.4977.400 | 36 |
| 3.2856.300 | 33 | 3.2861.300 | 33 | 3.4927.420 | 36 | 3.4977.420 | 36 |
| 3.2856.320 | 33 | 3.2861.320 | 33 | 3.4928.340 | 36 | 3.4978.340 | 36 |
| 3.2856.340 | 33 | 3.2861.340 | 33 | 3.4928.360 | 36 | 3.4978.360 | 36 |
| 3.2856.360 | 33 | 3.2861.360 | 33 | 3.4928.380 | 36 | 3.4978.380 | 36 |
| 3.2856.380 | 33 | 3.2861.380 | 33 | 3.4928.400 | 36 | 3.4978.400 | 36 |
| 3.2856.400 | 33 | 3.2861.400 | 33 | 3.4928.420 | 36 | 3.4978.420 | 36 |
| 3.2856.420 | 33 | 3.2861.420 | 33 | 3.4929.340 | 36 | 3.4979.340 | 36 |
| 3.2856.440 | 33 | 3.2861.440 | 33 | 3.4929.360 | 36 | 3.4979.360 | 36 |

| Catalogue no. Nr katalogowy | Page Strona | Catalogue no. Nr katalogowy | Page Strona | Catalogue no. Nr katalogowy | Page Strona | Catalogue no. Nr katalogowy | Page Strona |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|
| 3.4979.380 | 36 | 3.5151.105 | 18 | 3.5160.028 | 22 | 3.5170.030 | 9, 20, 27 |
| 3.4979.400 | 36 | 3.5151.110 | 18 | 3.5160.030 | 9, 16, 18, 20, 22 | 3.5170.035 | 9, 20, 27 |
| 3.4979.420 | 36 | 3.5151.115 | 18 | 3.5160.035 | 9, 16, 18, 20, 22 | 3.5170.040 | 9, 20, 27 |
| 3.5103.340 | 8 | 3.5151.120 | 18 | 3.5160.040 | 9, 16, 18, 20, 22 | 3.5170.045 | 9, 20, 27 |
| 3.5103.360 | 8 | 3.5155.020 | 24 | 3.5160.045 | 9, 16, 18, 20, 22 | 3.5170.050 | 9, 20, 27 |
| 3.5103.380 | 8 | 3.5155.022 | 24 | 3.5160.050 | 9, 16, 18, 20, 22 | 3.5170.055 | 9, 20, 27 |
| 3.5103.400 | 8 | 3.5155.024 | 24 | 3.5160.055 | 9, 16, 18, 20, 22 | 3.5170.060 | 9, 20, 27 |
| 3.5103.420 | 8 | 3.5155.026 | 24 | 3.5160.060 | 9, 16, 18, 20, 22 | 3.5170.065 | 9, 20, 27 |
| 3.5103.440 | 8 | 3.5155.028 | 24 | 3.5160.065 | 9, 16, 18, 20, 22 | 3.5170.070 | 9, 20, 27 |
| 3.5103.460 | 8 | 3.5155.030 | 24 | 3.5160.070 | 9, 16, 18, 20, 22 | 3.5170.075 | 9, 20, 27 |
| 3.5104.340 | 8 | 3.5155.032 | 24 | 3.5160.075 | 9, 16, 18, 20, 22 | 3.5170.080 | 9, 20, 27 |
| 3.5104.360 | 8 | 3.5155.034 | 24 | 3.5160.080 | 9, 16, 18, 20, 22 | 3.5170.085 | 9 |
| 3.5104.380 | 8 | 3.5155.036 | 24 | 3.5160.085 | 9, 16, 18, 20, 22 | 3.5170.090 | 9 |
| 3.5104.400 | 8 | 3.5155.038 | 24 | 3.5160.090 | 9, 16, 18, 20, 22 | 3.5172.000 | 18 |
| 3.5104.420 | 8 | 3.5155.040 | 24 | 3.5161.003 | 16 | 3.5173.020 | 27 |
| 3.5104.440 | 8 | 3.5155.042 | 24 | 3.5161.006 | 18, 21, 22 | 3.5173.025 | 27 |
| 3.5104.460 | 8 | 3.5155.045 | 24 | 3.5161.100 | 20 | 3.5173.030 | 27 |
| 3.5105.340 | 8 | 3.5155.050 | 24 | 3.5161.105 | 20 | 3.5173.035 | 27 |
| 3.5105.360 | 8 | 3.5155.055 | 24 | 3.5161.110 | 20 | 3.5173.040 | 27 |
| 3.5105.380 | 8 | 3.5155.060 | 24 | 3.5161.115 | 20 | 3.5173.045 | 27 |
| 3.5105.400 | 8 | 3.5156.020 | 24 | 3.5161.200 | 27 | 3.5173.050 | 27 |
| 3.5105.420 | 8 | 3.5156.022 | 24 | 3.5161.202 | 27 | 3.5177.180 | 7 |
| 3.5105.440 | 8 | 3.5156.024 | 24 | 3.5161.205 | 27 | 3.5177.200 | 7 |
| 3.5105.460 | 8 | 3.5156.026 | 24 | 3.5161.600 | 16 | 3.5178.180 | 7 |
| 3.5106.340 | 8 | 3.5156.028 | 24 | 3.5161.605 | 16 | 3.5178.200 | 7 |
| 3.5106.360 | 8 | 3.5156.030 | 24 | 3.5161.610 | 16 | 3.5179.180 | 7 |
| 3.5106.380 | 8 | 3.5156.032 | 24 | 3.5161.615 | 16 | 3.5179.200 | 7 |
| 3.5106.400 | 8 | 3.5156.034 | 24 | 3.5161.700 | 9 | 3.5180.180 | 7 |
| 3.5106.420 | 8 | 3.5156.036 | 24 | 3.5161.705 | 9 | 3.5180.200 | 7 |
| 3.5106.440 | 8 | 3.5156.038 | 24 | 3.5161.710 | 9 | 3.5321.000 | 28 |
| 3.5106.460 | 8 | 3.5156.040 | 24 | 3.5161.715 | 9 | 3.5321.002 | 28 |
| 3.5107.340 | 8 | 3.5156.042 | 24 | 3.5161.800 | 24 | 3.5321.003 | 28 |
| 3.5107.360 | 8 | 3.5156.045 | 24 | 3.5161.805 | 24 | 3.5322.000 | 29 |
| 3.5107.380 | 8 | 3.5156.050 | 24 | 3.5161.810 | 24 | 3.5322.002 | 29 |
| 3.5107.400 | 8 | 3.5156.055 | 24 | 3.5161.815 | 24 | 3.5322.003 | 30 |
| 3.5107.420 | 8 | 3.5156.060 | 24 | 3.5161.820 | 24 | 3.5324.000 | 30 |
| 3.5107.440 | 8 | 3.5158.050 | 18 | 3.5162.000 | 9 | 3.5324.002 | 31 |
| 3.5107.460 | 8 | 3.5158.060 | 18 | 3.5162.002 | 20 | 3.5324.003 | 31 |
| 3.5108.340 | 8 | 3.5158.070 | 18 | 3.5162.004 | 27 | 3.5332.012 | 32 |
| 3.5108.360 | 8 | 3.5158.080 | 18 | 3.5162.006 | 21, 22 | 3.5332.014 | 32 |
| 3.5108.380 | 8 | 3.5158.090 | 18 | 3.5168.050 | 9 | 3.5332.016 | 32 |
| 3.5108.400 | 8 | 3.5159.026 | 22 | 3.5168.055 | 9 | 3.5332.018 | 32 |
| 3.5108.420 | 8 | 3.5159.028 | 22 | 3.5168.060 | 9 | 3.5332.020 | 32 |
| 3.5108.440 | 8 | 3.5159.030 | 9, 13, 20, 22 | 3.5168.065 | 9 | 3.5332.022 | 32 |
| 3.5108.460 | 8 | 3.5159.035 | 9, 13, 20, 22 | 3.5168.070 | 9 | 3.5332.024 | 32 |
| 3.5109.340 | 8 | 3.5159.040 | 9, 13, 20, 22 | 3.5168.075 | 9 | 3.5332.026 | 32 |
| 3.5109.360 | 8 | 3.5159.045 | 9, 13, 20, 22 | 3.5168.080 | 9 | 3.5332.028 | 32 |
| 3.5109.380 | 8 | 3.5159.050 | 9, 13, 20, 22 | 3.5168.085 | 9 | 3.5332.030 | 32 |
| 3.5109.400 | 8 | 3.5159.055 | 9, 13, 20, 22 | 3.5168.090 | 9 | 3.5332.032 | 32 |
| 3.5109.420 | 8 | 3.5159.060 | 9, 13, 20, 22 | 3.5168.095 | 9 | 3.5332.034 | 32 |
| 3.5109.440 | 8 | 3.5159.065 | 9, 13, 20, 22 | 3.5168.100 | 9 | 3.5332.036 | 32 |
| 3.5109.460 | 8 | 3.5159.070 | 9, 13, 20, 22 | 3.5168.105 | 9 | 3.5332.038 | 32 |
| 3.5110.340 | 8 | 3.5159.075 | 9, 13, 20, 22 | 3.5168.110 | 9 | 3.5332.040 | 32 |
| 3.5110.360 | 8 | 3.5159.080 | 9, 13, 20, 22 | 3.5168.115 | 9 | 3.5332.042 | 32 |
| 3.5110.380 | 8 | 3.5159.085 | 9, 13, 20, 22 | 3.5168.120 | 9 | 3.5332.044 | 32 |
| 3.5110.400 | 8 | 3.5159.090 | 9, 13, 20, 22 | 3.5169.025 | 20, 27 | 3.5332.046 | 32 |
| 3.5110.420 | 8 | 3.5159.530 | 16, 18 | 3.5169.030 | 9, 20, 27 | 3.5332.048 | 32 |
| 3.5110.440 | 8 | 3.5159.535 | 16, 18 | 3.5169.035 | 9, 20, 27 | 3.5332.050 | 32 |
| 3.5110.460 | 8 | 3.5159.540 | 16, 18 | 3.5169.040 | 9, 20, 27 | 3.5602.180 | 17 |
| 3.5151.050 | 18 | 3.5159.545 | 16, 18 | 3.5169.045 | 9, 20, 27 | 3.5602.200 | 17 |
| 3.5151.055 | 18 | 3.5159.550 | 16, 18 | 3.5169.050 | 9, 20, 27 | 3.5602.220 | 17 |
| 3.5151.060 | 18 | 3.5159.555 | 16, 18 | 3.5169.055 | 9, 20, 27 | 3.5602.240 | 17 |
| 3.5151.065 | 18 | 3.5159.560 | 16, 18 | 3.5169.060 | 9, 20, 27 | 3.5602.260 | 17 |
| 3.5151.070 | 18 | 3.5159.565 | 16, 18 | 3.5169.065 | 9, 20, 27 | 3.5602.280 | 17 |
| 3.5151.075 | 18 | 3.5159.570 | 16, 18 | 3.5169.070 | 9, 20, 27 | 3.5602.300 | 17 |
| 3.5151.080 | 18 | 3.5159.575 | 16, 18 | 3.5169.075 | 9, 20, 27 | 3.5602.320 | 17 |
| 3.5151.085 | 18 | 3.5159.580 | 16, 18 | 3.5169.080 | 9, 20, 27 | 3.5602.340 | 17 |
| 3.5151.090 | 18 | 3.5159.585 | 18 | 3.5169.085 | 9 | 3.5602.360 | 17 |
| 3.5151.095 | 18 | 3.5159.590 | 18 | 3.5169.090 | 9 | 3.5602.380 | 17 |
| 3.5151.100 | 18 | 3.5160.026 | 22 | 3.5170.025 | 20, 27 | 3.5602.400 | 17 |

| Catalogue no. Nr katalogowy | Page Strona | Catalogue no. Nr katalogowy | Page Strona | Catalogue no. Nr katalogowy | Page Strona | Catalogue no. Nr katalogowy | Page Strona |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| 3.5602.420 | 17 | 3.5682.240 | 21 | 3.5764.420 | 15 | 3.6300.000 | 13 |
| 3.5603.180 | 17 | 3.5682.260 | 21 | 3.5765.340 | 15 | 3.6319.180 | 10 |
| 3.5603.200 | 17 | 3.5682.280 | 21 | 3.5765.360 | 15 | 3.6319.200 | 10 |
| 3.5603.220 | 17 | 3.5682.300 | 21 | 3.5765.380 | 15 | 3.6319.220 | 10 |
| 3.5603.240 | 17 | 3.5682.320 | 21 | 3.5765.400 | 15 | 3.6319.240 | 10 |
| 3.5603.260 | 17 | 3.5683.180 | 21 | 3.5765.420 | 15 | 3.6319.260 | 10 |
| 3.5603.280 | 17 | 3.5683.200 | 21 | 3.5766.340 | 15 | 3.6319.280 | 10 |
| 3.5603.300 | 17 | 3.5683.220 | 21 | 3.5766.360 | 15 | 3.6319.300 | 10 |
| 3.5603.320 | 17 | 3.5683.240 | 21 | 3.5766.380 | 15 | 3.6319.320 | 10 |
| 3.5603.340 | 17 | 3.5683.260 | 21 | 3.5766.400 | 15 | 3.6319.340 | 10 |
| 3.5603.360 | 17 | 3.5683.280 | 21 | 3.5766.420 | 15 | 3.6319.360 | 10 |
| 3.5603.380 | 17 | 3.5683.300 | 21 | 3.5785.340 | 15 | 3.6319.380 | 10 |
| 3.5603.400 | 17 | 3.5683.320 | 21 | 3.5785.360 | 15 | 3.6319.400 | 10 |
| 3.5603.420 | 17 | 3.5684.180 | 21 | 3.5785.380 | 15 | 3.6319.420 | 10 |
| 3.5604.180 | 17 | 3.5684.200 | 21 | 3.5785.400 | 15 | 3.6319.440 | 10 |
| 3.5604.200 | 17 | 3.5684.220 | 21 | 3.5785.420 | 15 | 3.6319.460 | 10 |
| 3.5604.220 | 17 | 3.5684.240 | 21 | 3.5786.340 | 15 | 3.6319.480 | 10 |
| 3.5604.240 | 17 | 3.5684.260 | 21 | 3.5786.360 | 15 | 3.6320.180 | 10 |
| 3.5604.260 | 17 | 3.5684.280 | 21 | 3.5786.380 | 15 | 3.6320.200 | 10 |
| 3.5604.280 | 17 | 3.5684.300 | 21 | 3.5786.400 | 15 | 3.6320.220 | 10 |
| 3.5604.300 | 17 | 3.5684.320 | 21 | 3.5786.420 | 15 | 3.6320.240 | 10 |
| 3.5604.320 | 17 | 3.5737.340 | 15 | 3.5787.340 | 15 | 3.6320.260 | 10 |
| 3.5604.340 | 17 | 3.5737.360 | 15 | 3.5787.360 | 15 | 3.6320.280 | 10 |
| 3.5604.360 | 17 | 3.5737.380 | 15 | 3.5787.380 | 15 | 3.6320.300 | 10 |
| 3.5604.380 | 17 | 3.5737.400 | 15 | 3.5787.400 | 15 | 3.6320.320 | 10 |
| 3.5604.400 | 17 | 3.5737.420 | 15 | 3.5787.420 | 15 | 3.6320.340 | 10 |
| 3.5604.420 | 17 | 3.5738.340 | 15 | 3.5788.340 | 15 | 3.6320.360 | 10 |
| 3.5639.180 | 14 | 3.5738.360 | 15 | 3.5788.360 | 15 | 3.6320.380 | 10 |
| 3.5639.200 | 14 | 3.5738.380 | 15 | 3.5788.380 | 15 | 3.6320.400 | 10 |
| 3.5640.180 | 14 | 3.5738.400 | 15 | 3.5788.400 | 15 | 3.6320.420 | 10 |
| 3.5641.180 | 14 | 3.5738.420 | 15 | 3.5788.420 | 15 | 3.6320.440 | 10 |
| 3.5651.180 | 14 | 3.5739.340 | 15 | 3.5789.340 | 15 | 3.6320.460 | 10 |
| 3.5651.200 | 14 | 3.5739.360 | 15 | 3.5789.360 | 15 | 3.6320.480 | 10 |
| 3.5652.180 | 14 | 3.5739.380 | 15 | 3.5789.380 | 15 | 3.6321.180 | 10 |
| 3.5652.200 | 14 | 3.5739.400 | 15 | 3.5789.400 | 15 | 3.6321.200 | 10 |
| 3.5653.180 | 14 | 3.5739.420 | 15 | 3.5789.420 | 15 | 3.6321.220 | 10 |
| 3.5653.200 | 14 | 3.5740.340 | 15 | 3.5790.340 | 15 | 3.6321.240 | 10 |
| 3.5663.180 | 14 | 3.5740.360 | 15 | 3.5790.360 | 15 | 3.6321.260 | 10 |
| 3.5663.200 | 14 | 3.5740.380 | 15 | 3.5790.380 | 15 | 3.6321.280 | 10 |
| 3.5664.180 | 14 | 3.5740.400 | 15 | 3.5790.400 | 15 | 3.6321.300 | 10 |
| 3.5664.200 | 14 | 3.5740.420 | 15 | 3.5790.420 | 15 | 3.6321.320 | 10 |
| 3.5665.180 | 14 | 3.5741.340 | 15 | 3.5804.080 | 16 | 3.6321.340 | 10 |
| 3.5665.200 | 14 | 3.5741.360 | 15 | 3.5804.085 | 16 | 3.6321.360 | 10 |
| 3.5679.180 | 21 | 3.5741.380 | 15 | 3.5804.090 | 16 | 3.6321.380 | 10 |
| 3.5679.200 | 21 | 3.5741.400 | 15 | 3.5804.095 | 16 | 3.6321.400 | 10 |
| 3.5679.220 | 21 | 3.5741.420 | 15 | 3.5804.100 | 16 | 3.6321.420 | 10 |
| 3.5679.240 | 21 | 3.5742.340 | 15 | 3.5804.105 | 16 | 3.6321.440 | 10 |
| 3.5679.260 | 21 | 3.5742.360 | 15 | 3.5804.110 | 16 | 3.6321.460 | 10 |
| 3.5679.280 | 21 | 3.5742.380 | 15 | 3.5804.115 | 16 | 3.6321.480 | 10 |
| 3.5679.300 | 21 | 3.5742.400 | 15 | 3.5804.120 | 16 | 3.6322.180 | 10 |
| 3.5679.320 | 21 | 3.5742.420 | 15 | 3.5805.070 | 16 | 3.6322.200 | 10 |
| 3.5680.180 | 21 | 3.5761.340 | 15 | 3.5805.075 | 16 | 3.6322.220 | 10 |
| 3.5680.200 | 21 | 3.5761.360 | 15 | 3.5805.080 | 16 | 3.6322.240 | 10 |
| 3.5680.220 | 21 | 3.5761.380 | 15 | 3.5805.085 | 16 | 3.6322.260 | 10 |
| 3.5680.240 | 21 | 3.5761.400 | 15 | 3.5805.090 | 16 | 3.6322.280 | 10 |
| 3.5680.260 | 21 | 3.5761.420 | 15 | 3.5805.095 | 16 | 3.6322.300 | 10 |
| 3.5680.280 | 21 | 3.5762.340 | 15 | 3.5805.100 | 16 | 3.6322.320 | 10 |
| 3.5680.300 | 21 | 3.5762.360 | 15 | 3.5805.105 | 16 | 3.6322.340 | 10 |
| 3.5680.320 | 21 | 3.5762.380 | 15 | 3.5805.110 | 16 | 3.6322.360 | 10 |
| 3.5681.180 | 21 | 3.5762.400 | 15 | 3.5808.000 | 16 | 3.6322.380 | 10 |
| 3.5681.200 | 21 | 3.5762.420 | 15 | 3.5961.080 | 16 | 3.6322.400 | 10 |
| 3.5681.220 | 21 | 3.5763.340 | 15 | 3.5961.085 | 16 | 3.6322.420 | 10 |
| 3.5681.240 | 21 | 3.5763.360 | 15 | 3.5961.090 | 16 | 3.6322.440 | 10 |
| 3.5681.260 | 21 | 3.5763.380 | 15 | 3.5961.095 | 16 | 3.6322.460 | 10 |
| 3.5681.280 | 21 | 3.5763.400 | 15 | 3.5961.100 | 16 | 3.6322.480 | 10 |
| 3.5681.300 | 21 | 3.5763.420 | 15 | 3.5961.105 | 16 | 3.6323.180 | 10 |
| 3.5681.320 | 21 | 3.5764.340 | 15 | 3.5961.110 | 16 | 3.6323.200 | 10 |
| 3.5682.180 | 21 | 3.5764.360 | 15 | 3.5961.115 | 16 | 3.6323.220 | 10 |
| 3.5682.200 | 21 | 3.5764.380 | 15 | 3.5961.120 | 16 | 3.6323.240 | 10 |
| 3.5682.220 | 21 | 3.5764.400 | 15 | 3.5962.000 | 16 | 3.6323.260 | 10 |

| Catalogue no. Nr katalogowy | Page Strona | Catalogue no. Nr katalogowy | Page Strona | Catalogue no. Nr katalogowy | Page Strona | Catalogue no. Nr katalogowy | Page Strona |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| 3.6323.280 | 10 | 3.6345.400 | 11 | 40.3925.000 | 57 | 40.4547.110 | 56 |
| 3.6323.300 | 10 | 3.6345.420 | 11 | 40.3926.000 | 57 | 40.4547.200 | 55 |
| 3.6323.320 | 10 | 3.6345.440 | 11 | 40.3927.000 | 57 | 40.4547.210 | 56 |
| 3.6323.340 | 10 | 3.6345.460 | 11 | 40.3928.000 | 57 | 40.4547.300 | 55 |
| 3.6323.360 | 10 | 3.6345.480 | 11 | 40.3929.000 | 57 | 40.4547.310 | 56 |
| 3.6323.380 | 10 | 3.6367.020 | 12 | 40.3929.001 | 57, 58 | 40.4547.400 | 55 |
| 3.6323.400 | 10 | 3.6367.025 | 12 | 40.3929.580 | 58 | 40.4547.500 | 55 |
| 3.6323.420 | 10 | 3.6367.030 | 12 | 40.3930.000 | 57 | 40.4547.510 | 56 |
| 3.6323.440 | 10 | 3.6367.040 | 12 | 40.4541.000 | 55 | 40.4548.000 | 55 |
| 3.6323.460 | 10 | 3.6367.050 | 12 | 40.4541.100 | 55 | 40.4548.100 | 55 |
| 3.6323.480 | 10 | 3.6367.060 | 12 | 40.4541.110 | 56 | 40.4548.110 | 56 |
| 3.6324.180 | 10 | 3.6367.070 | 12 | 40.4541.200 | 55 | 40.4548.200 | 55 |
| 3.6324.200 | 10 | 3.6367.080 | 12 | 40.4541.210 | 56 | 40.4548.210 | 56 |
| 3.6324.220 | 10 | 3.6367.090 | 12 | 40.4541.300 | 55 | 40.4548.300 | 55 |
| 3.6324.240 | 10 | 3.6367.100 | 12 | 40.4541.310 | 56 | 40.4548.310 | 56 |
| 3.6324.260 | 10 | 3.6367.110 | 12 | 40.4541.400 | 55 | 40.4548.400 | 55 |
| 3.6324.280 | 10 | 3.6367.120 | 12 | 40.4541.500 | 55 | 40.4548.500 | 55 |
| 3.6324.300 | 10 | 3.6367.130 | 12 | 40.4541.510 | 56 | 40.4548.510 | 56 |
| 3.6324.320 | 10 | 3.6367.140 | 12 | 40.4542.000 | 55 | 40.4681.100 | 15, 36 |
| 3.6324.340 | 10 | 3.6367.150 | 12 | 40.4542.100 | 55 | 40.4686.200 | 34, 39, 41, 43, 46 |
| 3.6324.360 | 10 | 3.6367.160 | 12 | 40.4542.110 | 56 | 40.4687.200 | 35 |
| 3.6324.380 | 10 | 3.6367.170 | 12 | 40.4542.200 | 55 | 40.4747.500 | 57 |
| 3.6324.400 | 10 | 3.6367.180 | 12 | 40.4542.210 | 56 | 40.4749.580 | 58 |
| 3.6324.420 | 10 | 3.6379.060 | 13 | 40.4542.300 | 55 | 40.4749.600 | 57, 58 |
| 3.6324.440 | 10 | 3.6379.080 | 13 | 40.4542.310 | 56 | 40.5007.100 | 40 |
| 3.6324.460 | 10 | 3.6379.100 | 13 | 40.4542.400 | 55 | 40.5058.200 | 9, 13, 18, 20, 22, 27, 34 |
| 3.6324.480 | 10 | 3.6379.120 | 13 | 40.4542.500 | 55 | 40.5103.000 | 55 |
| 3.6343.180 | 11 | 3.6379.140 | 13 | 40.4542.510 | 56 | 40.5103.100 | 55 |
| 3.6343.200 | 11 | 3.6380.020S | 12 | 40.4543.000 | 55 | 40.5103.110 | 56 |
| 3.6343.220 | 11 | 3.6380.025S | 12 | 40.4543.100 | 55 | 40.5103.200 | 55 |
| 3.6343.240 | 11 | 3.6380.030S | 12 | 40.4543.110 | 56 | 40.5103.210 | 56 |
| 3.6343.260 | 11 | 3.6380.040S | 12 | 40.4543.200 | 55 | 40.5103.300 | 55 |
| 3.6343.280 | 11 | 3.6380.050S | 12 | 40.4543.210 | 56 | 40.5103.310 | 56 |
| 3.6343.300 | 11 | 3.6380.060S | 12 | 40.4543.300 | 55 | 40.5103.400 | 55 |
| 3.6343.320 | 11 | 3.6380.070S | 12 | 40.4543.310 | 56 | 40.5103.500 | 55 |
| 3.6343.340 | 11 | 3.6380.080S | 12 | 40.4543.400 | 55 | 40.5103.510 | 56 |
| 3.6343.360 | 11 | 3.6380.090S | 12 | 40.4543.500 | 55 | 40.5104.000 | 55 |
| 3.6343.380 | 11 | 3.6380.100S | 12 | 40.4543.510 | 56 | 40.5104.100 | 55 |
| 3.6343.400 | 11 | 3.6385.045 | 23 | 40.4544.000 | 55 | 40.5104.110 | 56 |
| 3.6343.420 | 11 | 3.6385.055 | 23 | 40.4544.100 | 55 | 40.5104.200 | 55 |
| 3.6343.440 | 11 | 3.6385.070 | 23 | 40.4544.110 | 56 | 40.5104.210 | 56 |
| 3.6343.460 | 11 | 3.6386.045 | 23 | 40.4544.200 | 55 | 40.5104.300 | 55 |
| 3.6343.480 | 11 | 3.6386.055 | 23 | 40.4544.210 | 56 | 40.5104.310 | 56 |
| 3.6344.180 | 11 | 3.6389.045 | 23 | 40.4544.300 | 55 | 40.5104.400 | 55 |
| 3.6344.200 | 11 | 3.6389.055 | 23 | 40.4544.310 | 56 | 40.5104.500 | 55 |
| 3.6344.220 | 11 | 3.6389.070 | 23 | 40.4544.400 | 55 | 40.5104.510 | 56 |
| 3.6344.240 | 11 | 3.6390.045 | 23 | 40.4544.500 | 55 | 40.5105.000 | 55 |
| 3.6344.260 | 11 | 3.6390.055 | 23 | 40.4544.510 | 56 | 40.5105.100 | 55 |
| 3.6344.280 | 11 | 3.6390.070 | 23 | 40.4545.000 | 55 | 40.5105.110 | 56 |
| 3.6344.300 | 11 | 4.5235.008 | 32 | 40.4545.100 | 55 | 40.5105.200 | 55 |
| 3.6344.320 | 11 | 4.5235.010 | 32 | 40.4545.110 | 56 | 40.5105.210 | 56 |
| 3.6344.340 | 11 | 4.5235.012 | 32 | 40.4545.200 | 55 | 40.5105.300 | 55 |
| 3.6344.360 | 11 | 4.5235.014 | 32 | 40.4545.210 | 56 | 40.5105.310 | 56 |
| 3.6344.380 | 11 | 4.5235.016 | 32 | 40.4545.300 | 55 | 40.5105.400 | 55 |
| 3.6344.400 | 11 | 4.5235.018 | 32 | 40.4545.310 | 56 | 40.5105.500 | 55 |
| 3.6344.420 | 11 | 4.5235.020 | 32 | 40.4545.400 | 55 | 40.5105.510 | 56 |
| 3.6344.440 | 11 | 4.5235.022 | 32 | 40.4545.500 | 55 | 40.5106.000 | 55 |
| 3.6344.460 | 11 | 4.5235.024 | 32 | 40.4545.510 | 56 | 40.5106.100 | 55 |
| 3.6344.480 | 11 | 4.5235.026 | 32 | 40.4546.000 | 55 | 40.5106.110 | 56 |
| 3.6345.180 | 11 | 4.5235.028 | 32 | 40.4546.100 | 55 | 40.5106.200 | 55 |
| 3.6345.200 | 11 | 4.5235.030 | 32 | 40.4546.110 | 56 | 40.5106.210 | 56 |
| 3.6345.220 | 11 | 4.5235.032 | 32 | 40.4546.200 | 55 | 40.5106.300 | 55 |
| 3.6345.240 | 11 | 4.5235.034 | 32 | 40.4546.210 | 56 | 40.5106.310 | 56 |
| 3.6345.260 | 11 | 4.5235.036 | 32 | 40.4546.300 | 55 | 40.5106.400 | 55 |
| 3.6345.280 | 11 | 4.5235.038 | 32 | 40.4546.310 | 56 | 40.5106.500 | 55 |
| 3.6345.300 | 11 | 15.0421.600 | 9 | 40.4546.400 | 55 | 40.5106.510 | 56 |
| 3.6345.320 | 11 | 15.0428.601 | 24 | 40.4546.500 | 55 | 40.5107.000 | 55 |
| 3.6345.340 | 11 | 15.0429.600 | 32 | 40.4546.510 | 56 | 40.5107.100 | 55 |
| 3.6345.360 | 11 | 40.1350.000 | 57 | 40.4547.000 | 55 | 40.5107.110 | 56 |
| 3.6345.380 | 11 | 40.3924.001 | 57 | 40.4547.100 | 55 | 40.5107.200 | 55 |

| Catalogue no. Nr katalogowy | Page Strona | Catalogue no. Nr katalogowy | Page Strona | Catalogue no. Nr katalogowy | Page Strona |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|
| 40.5107.210 | 56 | 40.5114.210 | 56 | 40.8836.000 | 58 |
| 40.5107.300 | 55 | 40.5114.300 | 55 | 40.8837.000 | 58 |
| 40.5107.310 | 56 | 40.5114.310 | 56 | 40.8838.000 | 58 |
| 40.5107.400 | 55 | 40.5114.400 | 55 | 40.8839.000 | 58 |
| 40.5107.500 | 55 | 40.5114.500 | 55 | 40.8840.000 | 58 |
| 40.5107.510 | 56 | 40.5114.510 | 56 | 40.8841.000 | 58 |
| 40.5108.000 | 55 | 40.5115.000 | 55 | 40.8842.000 | 58 |
| 40.5108.100 | 55 | 40.5115.100 | 55 | 40.8843.000 | 58 |
| 40.5108.110 | 56 | 40.5115.110 | 56 | 40.8844.000 | 58 |
| 40.5108.200 | 55 | 40.5115.200 | 55 | 40.8845.000 | 58 |
| 40.5108.210 | 56 | 40.5115.210 | 56 | 40.8846.000 | 58 |
| 40.5108.300 | 55 | 40.5115.300 | 55 | 40.8847.000 | 58 |
| 40.5108.310 | 56 | 40.5115.310 | 56 | 40.8848.000 | 58 |
| 40.5108.400 | 55 | 40.5115.400 | 55 | 40.8849.000 | 58 |
| 40.5108.500 | 55 | 40.5115.500 | 55 | 40.8850.000 | 58 |
| 40.5108.510 | 56 | 40.5115.510 | 56 | 40.8851.000 | 58 |
| 40.5109.000 | 55 | 40.5116.000 | 55 | 40.8852.000 | 58 |
| 40.5109.100 | 55 | 40.5116.100 | 55 | 40.8853.000 | 58 |
| 40.5109.110 | 56 | 40.5116.110 | 56 | 40.8854.000 | 58 |
| 40.5109.200 | 55 | 40.5116.200 | 55 | | |
| 40.5109.210 | 56 | 40.5116.210 | 56 | | |
| 40.5109.300 | 55 | 40.5116.300 | 55 | | |
| 40.5109.310 | 56 | 40.5116.310 | 56 | | |
| 40.5109.400 | 55 | 40.5116.400 | 55 | | |
| 40.5109.500 | 55 | 40.5116.500 | 55 | | |
| 40.5109.510 | 56 | 40.5116.510 | 56 | | |
| 40.5110.000 | 55 | 40.5117.000 | 55 | | |
| 40.5110.100 | 55 | 40.5117.100 | 55 | | |
| 40.5110.110 | 56 | 40.5117.110 | 56 | | |
| 40.5110.200 | 55 | 40.5117.200 | 55 | | |
| 40.5110.210 | 56 | 40.5117.210 | 56 | | |
| 40.5110.300 | 55 | 40.5117.300 | 55 | | |
| 40.5110.310 | 56 | 40.5117.310 | 56 | | |
| 40.5110.400 | 55 | 40.5117.400 | 55 | | |
| 40.5110.500 | 55 | 40.5117.500 | 55 | | |
| 40.5110.510 | 56 | 40.5117.510 | 56 | | |
| 40.5111.000 | 55 | 40.5118.000 | 55 | | |
| 40.5111.100 | 55 | 40.5118.100 | 55 | | |
| 40.5111.110 | 56 | 40.5118.110 | 56 | | |
| 40.5111.200 | 55 | 40.5118.200 | 55 | | |
| 40.5111.210 | 56 | 40.5118.210 | 56 | | |
| 40.5111.300 | 55 | 40.5118.300 | 55 | | |
| 40.5111.310 | 56 | 40.5118.310 | 56 | | |
| 40.5111.400 | 55 | 40.5118.400 | 55 | | |
| 40.5111.500 | 55 | 40.5118.500 | 55 | | |
| 40.5111.510 | 56 | 40.5118.510 | 56 | | |
| 40.5112.000 | 55 | 40.5119.000 | 55 | | |
| 40.5112.100 | 55 | 40.5119.100 | 55 | | |
| 40.5112.110 | 56 | 40.5119.110 | 56 | | |
| 40.5112.200 | 55 | 40.5119.200 | 55 | | |
| 40.5112.210 | 56 | 40.5119.210 | 56 | | |
| 40.5112.300 | 55 | 40.5119.300 | 55 | | |
| 40.5112.310 | 56 | 40.5119.310 | 56 | | |
| 40.5112.400 | 55 | 40.5119.400 | 55 | | |
| 40.5112.500 | 55 | 40.5119.500 | 55 | | |
| 40.5112.510 | 56 | 40.5119.510 | 56 | | |
| 40.5113.000 | 55 | 40.5750.000 | 19, 21, 38 | | |
| 40.5113.100 | 55 | 40.5751.000 | 25, 26, 44, 45 | | |
| 40.5113.110 | 56 | 40.5753.000 | 25, 33, 42, 44, 45 | | |
| 40.5113.200 | 55 | 40.6328.000 | 16 | | |
| 40.5113.210 | 56 | 40.6513.000 | 59 | | |
| 40.5113.300 | 55 | 40.6514.000 | 59 | | |
| 40.5113.310 | 56 | 40.8538.000 | 49, 57, 58 | | |
| 40.5113.400 | 55 | 40.8832.000 | 58 | | |
| 40.5113.500 | 55 | 40.8833.100 | 58 | | |
| 40.5113.510 | 56 | 40.8833.200 | 58 | | |
| 40.5114.000 | 55 | 40.8833.300 | 58 | | |
| 40.5114.100 | 55 | 40.8833.500 | 58 | | |
| 40.5114.110 | 56 | 40.8834.000 | 58 | | |
| 40.5114.200 | 55 | 40.8835.000 | 58 | | |

ChM sp. z o.o.

Lewickie 3b

16-061 Juchnowiec Kościelny

Poland

tel. +48 85 86 86 100

fax +48 85 86 86 101

chm@chm.eu

www.chm.eu

